wau

CATALOGUE

КҮТІМ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ 7

AI NEW 9
AKARI 15
ATAMA 21
ELAX 2.0 27
EMI 31
HAZUMI LIGHT 35
HIGE 39
HIGE PRO 43
KARU 47
KINU 53
KIO 57
LED HAND MASK 65
LED MASK 71
LED MASK 2.0 75
LED MASK 3.0 81
LED NECK 2.0 91
LED PATCHES 97
LED SET 101
MAMI 109
MEI1 115
MIGA 119
MIGA BLACK 123
MIGA NEW 129
MIGA PRO 135
MIO2 141
MIRA 145
MORI BLACK 153

MORI 2.0 157
NEO 161
REN 167
SARA 171
UMI 177
VIA GOLD 181
YUKI 187
YUTO + 193
Массаж сызықтарының сызбасы 196

Аксессуарлар 197

RENGA 199

WAU

ТЕРІ КҮТІМІ 201

AQUA PURIFYING REGENCY CREAM 203
BODY MOISTURE MASSAGE GEL 207
CAFFEINE BRIGHTENING EYE CREAM 211
CLEANSING BALM 215
COLD & TONED BODY MILK 219
COLD & TONED BODY SCRUB 223
DEEP MOISTURE BODY CREAM 227
IRRIGATOR RINSE + MOUTHWASH 231
MILKY ESSENCE TONER 235
MOISTURE MASSAGE GEL 239
PEPTIDE GOLD-LIFT SERUM 243
PORE CLEANSING GEL 247
THERMAL PROTECTION 249

TRICHO SOLUTION HAIR MASK 253
TRICHO SOLUTION HAIR TONIC 257
TRICHO SOLUTION SCALP GEL 261
UV SHIELD SPF 50+ CREAM 265
VITAMIN C BRIGHTENING SERUM 269

PETIT RA TEPI KYTIMI 273

ANTI-AGING CARE MTS SERUM 275
ANTI-AGING CARE STEM CELL 279
LIPO JEUNE 283
O2 DETOX CLEANSING GEL 287
PAD CYPRESS TONIC 291
PAD TIGHTENING PEPTIDE ESSENCE 295
SOS BODY FIT 299
SPICULE EYE CREAM 303

Биологиялық белсенді қоспалар 307

A + E COMPLEX 309
ALPHA LIPOIC ACID 313
ARTHRO ACTIVE 315
B-COMPLEX 319
BIOTIN 323
CHLOROPHYLL 325
CHROMIUM PICOLINATE 327
COENZYME Q10 — 100 MG 331
GINSENG 333
GLUCOSAMINE 337
IRON CHELATE 339
IRON CHELATE BISGLYCINATE 343
KELP SEA IODINE 347
KRILL OIL 351
L-CARNITINE 355
LIPOSOMAL VITAMIN C 357
MAGNESIUM CHELATE + B6 359
MAGNESIUM 4.0 363
MEN’S FORMULA 367
NMN 371
OMEGA-3 + VITAMIN D3 375
OMEGA-3 90% 379
OMEGA-3 60% 383
PROBIOTIC COMPLEX 387
VITAMIN C 391
VITAMIN D3 393
VITAMIN D3 SPRAY 395
WOMEN’S FORMULA 397
ZINC PICOLINATE 401
COLLAGEN 403



ҚҰРЫЛҒЫЛАР



AI NEW - КӨЗ АЙНАЛАСЫНДАҒЫ ТЕРІГЕ АРНАЛҒАН МАССАЖЕР

Көз айналасындағы тері күтімі

Әжімдерді тегістейді

Ісіну мен қара шеңберлерді азайтады

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: көз астындағы қара шеңберлер, мимикалық әжімдер, қартаюдың алғашқы белгілері, ісіну, өңсіз тері, көз астындағы қапшықтар, көздің сыртқы бұрыштарындағы ұсақ әжімдер.

МАТЕРИАЛЫ: ABS пластигі.

САЛМАҒЫ: 94 g.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:

EMS - бұлшықеттерді миостимуляциялауға арналған электр тогы. Ол тері қабаттарына терең еніп, бұлшықет қабатына жетеді. Бұлшықеттердің жиырылуын ынталандыру арқылы EMS теріні тартып, лифтинг әсерін береді, коллаген мен эластиннің түзілуін арттырады, терінің серпімділігі мен созылғыштығын жақсартады, ісінуді азайтады.

RF - терінің терең қабатын (дерманы) шамамен 40-55 °C-қа дейін қыздыратын радиожиілікті энергия. Бұл коллаген түзілуін ынталандырып, терінің серпімділігін арттырады. Кейбір жағдайларда жылу май жасушаларының зат алмасуын да жеделдетуі мүмкін, мысалы, иек астында. Үйде қолданылатын құрылғыларда қауіпсіз пайдалану үшін тері бетінің температурасы әдетте 38-45 °C болады.

Қызыл LED жарығы қан айналымын жақсартады, қабынуға қарсы әсер береді, ісіну мен ауырсынуды басады, пигментацияны ағартады, барлық тері түріне жарайды. Басқа жарық түрлерінен тереңірек еніп, коллаген түзетін фибробласттарға әсер етеді. Осылайша терінің жасаруына және қартаю белгілерімен күресуге көмектеседі.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:
1. Құрылғыны ыңғайлы сақтауға және зарядтауға арналған тұғыр-базасы бар.
2. 1 батырмамен басқарылады, ұзақ басу арқылы қосылады, сондықтан тасымалдау кезінде өздігінен қосылмайды.
3. 2 режим: EMS + қызыл LED жарығы; RF + қызыл LED жарығы.
4. Индикатор түстері: қызыл - RF, көк - EMS.
5. Жұмыс беті көз айналасын өңдеуге бейімделген арнайы бұрышпен орналасқан.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ:
1. Құрылғыны қосу үшін қосу/өшіру батырмасын басып тұрыңыз.
2. Құрылғыда 2 жұмыс режимі бар: «RF + қызыл LED жарығы» және «EMS + қызыл LED жарығы». Қосу батырмасымен режимді таңдаңыз. Қызыл индикатор - RF + қызыл LED жарығы; көк индикатор - EMS + қызыл LED жарығы.
3. Құрылғыны өшіру үшін қосу/өшіру батырмасын басып тұрыңыз.
4. Құрылғы автоматты түрде өшу функциясымен жабдықталған (10 минут үздіксіз қолданғаннан кейін).

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:

RF РЕЖИМІ + ҚЫЗЫЛ LED ЖАРЫҒЫ
1. Қосу батырмасын басып тұрып, құрылғыны қосыңыз. Содан кейін RF + қызыл LED жарығы режимін таңдаңыз (қызыл индикатор).
2. Ток өткізетін массаж гелін жағып, құрылғының жұмыс бетін теріге тигізіңіз. Көз ұясы сүйегінің бойындағы массаж сызықтарымен көздің ішкі бұрышынан сыртқы бұрышына қарай және сыртқы бұрышынан тарайтын сәулелер бойымен баяу жылжытып, массаж жасаңыз. Әр 2 минут сайын келесі көзге ауысыңыз. Ескерту: құрылғы шығаратын радиотолқындар тері дермасын қыздырады. Қолдану кезінде жұмыс бетін үнемі жылжытып отырыңыз. Күйіп қалмау үшін терінің бір жерінде кідірмеңіз. Арнайы дыбыстық белгі әр 10 секунд сайын құрылғыны жылжыту керектігін еске салады.

EMS РЕЖИМІ + ҚЫЗЫЛ LED ЖАРЫҒЫ
1. Қосу батырмасын басып тұрып, құрылғыны қосыңыз. Содан кейін EMS + қызыл LED жарығы режимін таңдаңыз (көк индикатор).
2. Ток өткізетін массаж гелін жағып, құрылғының жұмыс бетін теріге тигізіңіз. Көз ұясы сүйегінің немесе қас доғасының бойындағы массаж сызықтарымен көздің ішкі бұрышынан сыртқы бұрышына қарай баяу жылжытып, массаж жасаңыз. Әр 2 минут сайын келесі көзге ауысыңыз.

ПРОЦЕДУРАНЫҢ ЖИІЛІГІ МЕН ҰЗАҚТЫҒЫ:

ТЕРІ ТҮРІ / МӘСЕЛЕ	1-АПТА	2-АПТА	3-АПТА	4-АПТА	СОДАН КЕЙІН
КӨЗ АСТЫНДАҒЫ ІСІНУ / ҚАРА ШЕҢБЕРЛЕР	Кешке, ұйықтар алдында. EMS: 5-7 минут (әр көзге 3-3.5 минут). RF: 5-7 минут (әр көзге 3-3.5 минут). Күнара.	Кешке, ұйықтар алдында. EMS: 5-7 минут (әр көзге 3-3.5 минут). RF: 5-7 минут (әр көзге 3-3.5 минут). Күнара.	1 апта үзіліс (кемінде 5 күн).	Қайталаңыз.	2 апталық курс. 1 апта үзіліс. 2 апталық курсты қайталаңыз. Осы циклді жалғастырыңыз.
ҚҰРҒАҚ / ТОНУСЫ ТӨМЕН ТЕРІ	Таңертең. RF: 7 минут (әр көзге 3.5 минут). EMS: 2-3 минут (әр көзге 1.5 минут). Әр 3 күнде бір рет.	Таңертең. RF: 7 минут (әр көзге 3.5 минут), әр 3 күнде бір рет. EMS: 2-3 минут (әр көзге 1.5 минут), аптасына 3 реттен асырмаңыз.	Таңертең. RF: 7 минут (әр көзге 3.5 минут), күн сайын. EMS: 2-3 минут (әр көзге 1.5 минут). Режимдерді бөлек қолдануға болады. Аптасына 3 реттен асырмаңыз.	1 апта үзіліс.	4 апталық курсты 2 ай бойы қайталаңыз. 1 ай үзіліс жасаңыз. 4 апталық курсты 2 ай бойы қайта қайталаңыз.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Медициналық қарсы көрсетілімдеріңіз болса, қолданар алдында дерматологпен кеңесіңіз.
2. Жарыққа сезімтал болсаңыз, құрылғыны қолданбаңыз.
3. Теріде жарықтар немесе ашық жаралар, тері аурулары немесе ауыр безеу, күнге күю, тері инфекциялары және т.б. болса, құрылғыны қолданбаңыз.
4. Құрылғыны жоғарғы немесе төменгі қабаққа, көз алмасына не көздің шырышты қабығына қолданбаңыз.
5. Құрылғыны меңдерге, сүйелдерге, теріге кіріп өскен түктерге немесе тітіркенген теріге қолданбаңыз.
6. Құрылғыны басқа адамдармен ортақ пайдаланбаңыз: бұл бактериялардың айқаспалы жұғуына және қауіпті инфекциялардың дамуына әкелуі мүмкін.

ЕСКЕРТУЛЕР:
1. Зарядтау кабелін суламаңыз. Құрылғыны суға батырмаңыз.
2. Құрылғыны сулану қаупі бар жерлерде, мысалы, жуынатын бөлмеде, душта немесе бассейн жанында зарядтамаңыз.
3. Құрылғыны отқа тастамаңыз.
4. Құрылғыны тек жинақтағы зарядтау кабелімен зарядтаңыз.
5. Жарақат алмау үшін аксессуарлар немесе зарядтау кабелі зақымдалған болса, құрылғыны қолдануды тоқтатыңыз.
6. Қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін зақымдалған зарядтау кабелін түпнұсқа кабельге ауыстырыңыз.
7. Аккумулятордың қызмет мерзімін ұзарту үшін құрылғыны кемінде әр 2 ай сайын толық зарядтаңыз.
8. Бұл құрылғы 12 жасқа толмаған балаларға, сондай-ақ дене, сезу немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі не тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдарға арналмаған. Бұл топтағы адамдар құрылғыны тек бақылаумен пайдалана алады.
9. Сыртқы зақымдары байқалса, құрылғыны қолданбаңыз. Оны өзіңіз бөлшектеуге немесе жөндеуге тырыспаңыз: бұл көздің не терінің ауыр жарақатына, электр тогының соғуына және өлімге әкелуі мүмкін.

10. Құрылғыны осы нұсқаулыққа сәйкес тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз.
11. Құрылғыны 5-35 °C температурада зарядтау, қолдану және сақтау ұсынылады.
12. Соңғы 2 апта ішінде косметологиялық процедуралар жасатсаңыз, құрылғыны қолданбаңыз. Мысалы, химиялық немесе механикалық пилинг, лазерлік тегістеу, фракциялық лазермен өңдеу, мезотерапия, филлер енгізу немесе бет пішінін түзететін басқа процедуралар.

ЖИНАҚ ҚҰРАМЫ: (1) массажер, (2) зарядтау тұғыры, (3) зарядтауға арналған USB-C кабелі, (4) сақтауға арналған қап, (5) майлық, (6) нұсқаулық.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

ЗАРЯДТАУ УАҚЫТЫ: 2 h

ЖҰМЫС УАҚЫТЫ: 40 min

АҚЫЛДЫ ТАЙМЕР: 10 min

RF ЖИІЛІГІ: 1MHz

EMS ЖИІЛІГІ: 20 kHz

EMS ТОК КҮШІ: 166 mA

ҚЫЗЫЛ LED ЖАРЫҒЫНЫҢ ТОЛҚЫН ҰЗЫНДЫҒЫ: 630 nm

ТОЛҚЫН ПІШІНІ: екі фазалы симметриялы

СУДАН ҚОРҒАНЫСЫ: IPX4



AKARI - КӨЗ АЙНАЛАСЫНЫҢ КҮТІМІНЕ АРНАЛҒАН МАССАЖЕР

Көз айналасындағы теріні көтереді

Әжімдерді азайтады

Ісінуді азайтады

Қара шеңберлерді ағартады

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: мимикалық әжімдер, көз айналасындағы қатпарлар, қабақ терісінің серпімділігін жоғалтуы мен босаңсуы, қара шеңберлер, таңертеңгі ісіну, көз астындағы қапшықтар, экран алдында ұзақ жұмыс істегеннен кейінгі бұлшықет керілуі мен көздің шаршауы.

МАТЕРИАЛДАРЫ: ABS пластигі, PC пластигі, мырыш қорытпасы (электродтар).

САЛМАҒЫ: 137 g (құрылғы), 82 g (зарядтау базасы).

ФУНКЦИЯЛАРЫ:

RF-лифтинг (40-43 °C) терінің терең қабаттарына еніп, тіндерді 40-43 °C-қа дейін жұмсақ қыздырады. Соның нәтижесінде қолданыстағы коллаген талшықтары бірден жиырылып, фибробласттар жаңа коллаген мен эластинді белсенді өндіре бастайды. Көз айналасындағы тері бірден тартылып, тығызданады, ал тұрақты қолданғанда мимикалық әжімдер тегістеледі.

EMS (ЭЛЕКТРЛІК МИОСТИМУЛЯЦИЯ) көз айналасына әлсіз импульстермен (7.52-8.56 mA) әсер етіп, көздің айналма бұлшықетінің ырғақты жиырылып, босаңсуын туғызады. Бұл қабақтың бұлшықет қаңқасын нығайтады, көздің сыртқы бұрыштарын көтеріп, көз айналасындағы теріге тонус пен серпімділікті қайтарады.

Фототерапия (LED) - терінің белгілі бір тереңдігіне еніп, жасушаларға сіңетін әртүрлі ұзындықтағы жарық толқындарымен әсер ету әдісі. Ол табиғи жаңару процестерін іске қосады.

Қызыл спектр (620-630 nm) терінің жасаруы мен қалпына келуін іске қосып, көз айналасына балғындық пен табиғи жарқырауды қайтарады.

Сары спектр (587-592 nm) сезімтал теріні тыныштандырады, лимфа дренажын белсендіреді және іркіліп қалған сұйықтықты шығаруға көмектеседі. Нәтижесінде ісіну азайып, көз астындағы қара шеңберлер ағарады, тері құрылымы тегістеледі.

Салқындату режимі (15 ± 5 °C) беткі тамырлар мен тесіктерді бірден тарылтып, жылдам лимфа дренажы мен сергітетін әсер береді. Суық таңертеңгі ісінуді және көз астындағы қапшықтарды азайтып, теріні тыныштандырады.

ДІРІЛ (11000 айн./мин.) - компьютерде жұмыс істегеннен немесе кітап оқығаннан кейін көздің айналма бұлшықетінің түйілуі мен керілуін басатын жұмсақ микромассаж. Процедура қан айналымы мен лимфа ағынын белсендіреді, күтім косметикасының теріге сіңуін жақсартады.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:
1. EMS қарқындылығының 3 деңгейі теріңіздің сезімталдығына сай жеке күтім бағдарламасын таңдауға мүмкіндік береді.
2. Жад функциясы: құрылғы соңғы таңдалған EMS қарқындылығы мен режимін автоматты түрде сақтайды.
3. Алдын ала орнатылған 3 режимде әртүрлі әсер ету тәсілдері бірін-бірі толықтырып, күшейтіп, айқын нәтиже береді.
4. Ақылды таймер процедураның нақты уақытын бақылайды және теріге шамадан тыс әсер ету мен қызып кетудің алдын алу үшін құрылғыны автоматты түрде өшіреді.
5. Көз айналасындағы барлық мәселені шешу үшін бір ықшам құрылғыда 5 технология біріктірілген: RF-лифтинг, EMS-стимуляция, салқындату, дірілді массаж және LED жарығы (қызыл және сары).
6. Зарядтау базасы құрылғыны үстелде әдемі тік сақтауға және сымсыз ыңғайлы зарядтауға мүмкіндік береді.
7. Қарапайым әрі түсінікті басқару: саусаққа ыңғайлы орналасқан небәрі 2 батырма.
8. Жіксіз электродтар: теріні жарақаттамай, гигиеналық әрі жұмсақ сырғуға арналған толықтай тегіс бет.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ:
1. Қосу/өшіру: қуат батырмасын 1.5 секунд басып тұрыңыз (қосылғанда қысқа дыбыстық белгі естіледі). Әдепкіде құрылғы 1-режимде іске қосылады.
2. Режимдерді ауыстыру: режимдерді кезекпен таңдау үшін қуат батырмасын қысқа басыңыз: 1-режим: RF + EMS + қызыл LED жарығы. 2-режим: EMS + діріл (LED-тер өшірулі). 3-режим: EMS + салқындату + сары LED жарығы.
3. EMS қарқындылығын реттеу: басқару батырмасын қысқа басыңыз
деңгейді таңдау үшін:
Әлсіз (1-деңгей): батырманың оң бөлігі жанады. Орташа (2-деңгей): батырманың оң және төменгі бөліктері жанады. Күшті (3-деңгей): батырманың сол, оң және төменгі бөліктері жанады.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Сезімталдық сынағы (алғаш қолданар алдында міндетті):
Білектің ішкі жағына ток өткізетін гель жағып, өшірулі құрылғының жұмыс бетін тигізіңіз.
2. Құрылғыны қосып, 1-режимде толық 10 минуттық сеанс өткізіңіз. Қатты күйдіру сезімі болса, сынақты тоқтатыңыз. 6 сағаттан кейін теріні бағалаңыз. Қызару мен қышу болмаса, құрылғы сізге жарайды. Процедураны орындау: бет пен көз айналасын тазалаңыз. Контакт линза тағатын болсаңыз, сеанс алдында шешіңіз.
3. Гель жағу: көз айналасына арнайы ток өткізетін жанасу гелін немесе су негізіндегі ылғалдандыратын сарысуды молынан жағыңыз. Құрамында майлар мен қышқылдар (AHA, BHA, PHA, ретинол, жоғары концентрациялы С дәрумені) болмауы керек.

4. Массаж жасау: массажерді қосып, режимді таңдаңыз да, оны баяу жылжыта бастаңыз массаж сызықтарының бойымен:
• Жоғарғы қабақ: ішкі бұрыштан сыртқы бұрышқа қарай, қастың астындағы көз ұясы сүйегінің бойымен ғана жылжытыңыз.
• Төменгі қабақ: көздің ішкі бұрышынан сыртқы бұрышына қарай көз ұясы сүйегінің бойымен баяу жылжытыңыз.
Самай: жұмсақ айналмалы массаж. Маңызды: процедура кезінде құрылғыны үнемі қозғалыста ұстаңыз. Қызып кету мен күйікке жол бермеу үшін бір жерде ұстамаңыз! Сеансты 10 минуттан асырмаңыз.
5. Аяқтау: қабаққа әдеттегі күтім кремін жағыңыз. Құрылғыны дымқыл, түксіз майлықпен тазалаңыз.

ҚОЛДАНУ ЖИІЛІГІ МЕН ҰЗАҚТЫҒЫ:

ТЕРІ ТҮРІ / МӘСЕЛЕ	ТӘУЛІК УАҚЫТЫ	ҰЗАҚТЫҒЫ МЕН РЕТІ	ЖИІЛІГІ
ТАҢЕРТЕҢГІ ІСІНУ / ІСІК / ҚАРА ШЕҢБЕРЛЕР	Таңертең	3-режим: EMS + салқындату + сары LED жарығы (ісінуді азайту және жарқырау беру). Ұзақтығы: 3 минут.	Аптасына 3-4 рет
МИМИКАЛЫҚ ӘЖІМДЕР / ҚАТПАРЛАР / ҚАБАҚ СЕРПІМДІЛІГІНІҢ ТӨМЕНДЕУІ	Кешке	Режим 1: "RF + EMS + қызыл LED жарығы" (қартаюға қарсы көтеру) Ұзақтығы: 10 минутқа дейін	Аптасына 3-4 рет
БҰЛШЫҚЕТ КЕРІЛУІ ЖӘНЕ КӨЗДІҢ ШАРШАУЫ	Кешке немесе қажетіне қарай	2-режим: «EMS + діріл» (босаңсыту және лимфа дренажы). Ұзақтығы: 10 минутқа дейін.	Қажетіне қарай, әдетте аптасына 3-4 рет.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Көз алмасына, жоғарғы және төменгі қозғалмалы қабаққа, ауыздың, мұрынның немесе жыныс мүшелерінің шырышты қабықтарына тікелей қолдануға тыйым салынады.
2. Жүрек аурулары, кардиостимулятордың немесе басқа имплантацияланған электрондық медициналық құрылғының болуы.
3. Өңделетін аймақта металл имплантардың, штифтердің, алтын жіптердің болуы.
4. Көзге жақында жасалған операциялар немесе көз айналасындағы медициналық-эстетикалық процедуралар.
5. Өңделетін аймақта жаралар, сыдырылу, жарықтар, экзема, дерматит, ауыр безеу, күйік (соның ішінде күнге күю) немесе инфекциялардың болуы.
6. Металдарға немесе электрлік әсерге аллергия, терінің температураны және жанасуды сезуінің бұзылуы.
7. Қалқанша без аурулары (құрылғыны қалқанша бездің үстіне тікелей қолдануға тыйым салынады) немесе оны емдеуге арналған гормондық препараттарды қабылдау.
8. Жүктілік (дәрігермен кеңескеннен кейін ғана қолдану).
9. Бала емізу, етеккір кезеңі, купероз (телеангиэктазия): сақтықпен қолданыңыз.

10. 12 жасқа толмағандар (тек ересектердің бақылауымен қолдануға рұқсат етіледі).
11. Косметологиялық процедуралардан кейін тері белсенді жазылу сатысында болса, қолданбаңыз (соңғы екі аптада жасалған пилинг, лазерлік тегістеу, мезотерапия, филлер енгізу).
12. Бет аймағында тіс импланттары, брекеттер немесе металл протездер болса, сезімдеріңізді бақылаңыз. Жайсыздық немесе ауызда металл дәмі пайда болса, процедураны тоқтатыңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ МЕН ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ:
1. Ылғалдан қорғау: зарядтау кабелін, базаны және түйіспелерді толық құрғақ ұстаңыз. Оларды суға батырмаңыз, құрылғыны ылғалды ортада (жуынатын бөлмеде) зарядтамаңыз. Құрылғының ылғалдан қорғаныс дәрежесі - IPX22 (тік тамшылардан қорғау), бірақ оны кран астында жууға қатаң тыйым салынады.
2. Электр қауіпсіздігі: массажерді зарядтау кезінде қолдануға тыйым салынады. Зарядтау кезінде базаның желіге үздіксіз қосылу уақыты 24 сағаттан аспауы тиіс.
3. Ұқыпты тазалау: құрылғыны тек өшіріп тазалаңыз. Металл ысқыштарды, абразивтерді, агрессивті немесе жанғыш сұйықтықтарды (спирт, бензин, еріткіштер, ацетон) қолдануға тыйым салынады.
4. Құрылғыны феннің ыстық режимімен кептіруге тыйым салынады.
5. Сақтау: күн сәулесінен қорғалған құрғақ, салқын жерде, бөлме температурасында сақтаңыз. Ұзақ уақыт қолданбай сақтағанда, аккумулятор тозбауы үшін құрылғыны кемінде әр 3 ай сайын зарядтаңыз.
6. Құрылғыны отқа тастамаңыз, құлатпаңыз және соққылардан қорғаңыз.

ЖИНАҚ ҚҰРАМЫ: (1) AKARI массажері, (2) зарядтау базасы, (3) Type-C зарядтау кабелі, (4) сақтау қабы, (5) пайдалану нұсқаулығы, (6) майлық.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

ӨЛШЕМІ (Б × Е × Т): құрылғы - 155×26×28 mm, зарядтау базасы - 62×55×59 mm

ҚУАТ КӨЗІ: литий-полимерлі аккумулятор

АККУМУЛЯТОР СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ: 1000 mAh

НОМИНАЛДЫ ЖҰМЫС КЕРНЕУІ: 3,7 V

НОМИНАЛДЫ ҚОРЕК КЕРНЕУІ: 5 V

ҚУАТЫ: 11 W

АҚЫЛДЫ ТАЙМЕР: RF + EMS + қызыл LED жарығы - 10 минут; EMS + діріл - 10 минут; EMS + салқындату + сары LED жарығы - 3 минут

ЗАРЯДТАУ УАҚЫТЫ: ≤ 3 h

ЕҢ ҰЗАҚ ЖҰМЫС УАҚЫТЫ (ТОЛЫҚ ЗАРЯДТАН КЕЙІН): ≥ 40 min

EMS ҚАРҚЫНДЫЛЫҒЫ:
1-деңгей - 7.52 mA; 2-деңгей - 7.92 mA; 3-деңгей - 8.56 mA

СӘУЛЕЛЕНУ ҚАРҚЫНДЫЛЫҒЫ:
Қызыл LED жарығы - 24.22 mW/cm2; сары LED жарығы - 14.47 mW/cm2

ДІРІЛ ЖЫЛДАМДЫҒЫ: минутына 11000 айналым

САЛҚЫНДАТУ ТЕМПЕРАТУРАСЫ: 15+/-5 °C

СУДАН ҚОРҒАНЫСЫ: IPX22



АТАМА - ШАШ ӨСУІ МЕН БАС ТЕРІСІНІҢ КҮТІМІНЕ АРНАЛҒАН МАССАЖЕР

Шаш түбірлерін нығайтады

Шаштың өсуі

Шаштың қалыңдығы

Шаш сапасын жақсартады

Қабынуға қарсы әсер етеді

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: шаштың түсуі, жұқа шаш, құрғақ әрі сынғыш шаш, бас терісінің аурулары.

МАТЕРИАЛЫ: пластик.

САЛМАҒЫ: 213,5 g.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:

EMS - тіндерге терең енетін төмен жиілікті токпен электрлік ынталандыру. Ол бұлшықеттердің жиырылуы мен тамырлардың кеңеюін туғызады, қан және лимфа ағынын жақсартады, зат алмасуды және бас терісінің оттегімен қоректенуін ынталандырады. Соның нәтижесінде тесіктер тазаланып, «ұйқыдағы» шаш фолликулдары оянады, жаңа шаштың өсуі басталады, шаш сапасы жақсарады. EMS май бездерінің жұмысын қалыпқа келтіріп, шаштың майлануы мен терінің қышуын да азайтуы мүмкін.

Діріл: баста көптеген жүйке ұштары бар, оларды дірілді массажбен ынталандыру күйзелісті азайтады. Діріл қан айналымы мен зат алмасуды да жақсартады, сондықтан жасушалар көбірек қоректік заттар мен оттегі алады. Соның нәтижесінде шаш фолликулдары белсендірек жұмыс істеп, шаштың өсуі жеделдейді.

Фототерапия (қызыл және көк LED жарығы): LED-тер қажетті толқын ұзындығын шығарады. Теріге терең еніп, жасуша ішіндегі энергия процестерін іске қосады. Мысалы, қызыл LED жарығы (630 және 650 nm) белсенді шаш өсуі аяқталу кезеңіне өтетін фолликулдарды қайта белсендіреді. Көк LED жарығы (460 nm) эпидермис деңгейінде жұмыс істеп, бактерияларды жояды, қабынуды азайтады және бас терісінде безеу түзілуін тоқтатады.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:
1. Ыңғайлы сабы бар тарақ пішініндегі массажер. Өзіңізге ұзақ уақыт бойы ыңғайлы массаж жасай аласыз.
2. ATAMA құрылғысының судан қорғаныс дәрежесі - IPX6. Қолданғаннан кейін күтім жасау ыңғайлы: құрылғыны ағын сумен шайыңыз.

3. Арнайы силикон массаж тістері жұмсақ әрі иілгіш, 360 градусқа айналады және құрылғы өшірулі кезде де жайлы массаж жасайды.
4. Жеке реттелетін 3 режим: EMS (электрлік миостимуляция), LED (фототерапия), діріл. Режимдерді қалауыңызша біріктіруге, кез келгенін толық өшіруге, қажетті ток пен жарық қарқындылығын, діріл түрін таңдауға болады.
5. Түсінікті басқару: әр режимге құрылғы сабындағы жеке батырма сәйкес келеді. Массажды үзбей-ақ режимдерді ауыстыра аласыз.
6. LED режимінде ең тиімді 2 фототерапия жарығы ұсынылған. Қызыл режимге толқын ұзындығы 630 nm қызыл LED жарығы (диодтар тарақтың периметрінде) және 650 nm төмен деңгейлі лазер жарығы (диодтар массаж бетінің ортасында) кіреді. Осы аралықтағы толқындар шаш түсуінің алдын алады. 460 nm көк LED жарығы (диодтар тек тарақ периметрінде, ортасында көк жанбайды) бас терісінің беткі мәселелерін өңдеуге қолданылады.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ:
1. Құрылғыны қосу үшін қосу/өшіру батырмасын басыңыз.
2. Режимдерді баптау
• Қосу/өшіру батырмасы (қуат/EMS): 1.2 секунд басып тұру құрылғыны қосады; 1 дыбыстық белгі естіліп, EMS 1-деңгейде іске қосылады және 1 индикатор жанады. Қысқа басу EMS режимінің 2-деңгейін қосады, 2 индикатор жанады. Келесі қысқа басу 3-деңгейді қосады, 3 индикатор жанады. Тағы басқанда EMS толық өшіп, үш индикатор бірге жыпылықтайды. Жұмыс істеп тұрған құрылғының батырмасын 1.2 секунд ұзақ басқанда 2 дыбыстық белгі естіліп, құрылғы өшеді.
Толқын батырмасы (дірілді басқару): алғаш қысқа басқанда тұрақты діріл режимі қосылады. Екінші басқанда пульсациялы діріл режимі қосылады. Үшінші басқанда діріл режимі өшеді. Режим ауысқанда қысқа дыбыстық белгі естіледі.
Күн батырмасы (жарықты басқару): алғаш қысқа басқанда лазерлік терапия режимі (қызыл LED жарығы) қосылады. Екінші басқанда түс көкке ауысады. Үшінші басқанда LED режимі өшеді. Ауысу қысқа дыбыстық белгімен сүйемелденеді.
3. 10 минут үздіксіз қолданғаннан кейін құрылғы күту режиміне өтпей, автоматты түрде өшеді.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:

БАСТЫҢ ТӨБЕ АЙМАҒЫНА МАССАЖ ЖАСАУ:
1. Төбе аймағында сағат тілімен айналмалы қозғалыстар жасаңыз.
2. Бір аймақтың массажы 1-2 минутқа созылуы тиіс.

БАСТЫҢ БАСҚА АЙМАҚТАРЫНА МАССАЖ ЖАСАУ:
1. Шаш тарағандай, шаштың өсу бағытымен беттен желкеге қарай жылжытыңыз.
2. Сондай-ақ шиыршық немесе ирек қозғалыстар жасауға болады.
3. Бір аймақтағы барлық қозғалыстарды 3-5 рет қайталаңыз.
4. Ұсынылатын жалпы массаж ұзақтығы - 10-15 минут.

ҚОЛДАНУ ЖИІЛІГІ МЕН ҰЗАҚТЫҒЫ:

ТЕРІ ТҮРІ / МӘСЕЛЕ	ТӘУЛІК УАҚЫТЫ	ҰЗАҚТЫҒЫ МЕН РЕТІ	ЖИІЛІГІ	ПРОЦЕДУРАЛАР КУРСЫ
МАЙЛЫ БАС ТЕРІСІ	Таңертең, шаш жуғаннан кейін, дымқыл шашқа	EMS: 1-деңгей - 5 минут; 2-деңгей - 3 минут; 3-деңгей (ең жоғары) - 2 минут. Барлық үш деңгейді біртіндеп арттырып, кезекпен қолданыңыз. LED: көк LED - 5 минут; қызыл LED - 2 минут. Бір уақытта емес, осы ретпен қолданыңыз.	1-2-апталар: аптасына 3 рет. 3-апта: аптасына 5 рет. 4-апта: үзіліс.	2 ай. 1 ай үзіліс жасап, 2 айлық курсты қайталаңыз. Бағдарламаның жалпы ең қысқа ұзақтығы - 6 ай. Жылына екі курс.

ТЕРІ ТҮРІ / МӘСЕЛЕ	АЛҒАШҚЫ 10 КҮН	КЕЛЕСІ 10 КҮН	КЕЛЕСІ 2-3 АЙ	КЕЛЕСІ АЙ	СОДАН КЕЙІН
ШАШТЫҢ ТҮСІ / СИРЕУІ	Діріл: 10 минут; алдында қалауыңыз бойынша қоректік сарысу жағыңыз. Қызыл LED: 5 минут. Бір уақытта емес, осы ретпен қолданыңыз. Күн сайын.	Діріл: 10 минут; алдында қалауыңыз бойынша қоректік сарысу жағыңыз. Қызыл LED: 5 минут. Бір уақытта емес, осы ретпен қолданыңыз. Күнара.	Діріл: 10 минут; алдында қалауыңыз бойынша қоректік сарысу жағыңыз. EMS, төмен және орташа деңгей: 2-5 минут. Қызыл LED: 7 минут. Бір уақытта емес, осы ретпен қолданыңыз. Аптасына 3-4 рет.	Үзіліс.	10-10-3 бағдарламасын 5-6 ай бойы қайталаңыз. 1 ай үзіліс жасаңыз. Қолдау режимі: 1 ай қолданғаннан кейін 3 ай үзіліс.

ТЕРІ ТҮРІ / МӘСЕЛЕ	ТӘУЛІК УАҚЫТЫ	ҰЗАҚТЫҒЫ МЕН РЕТІ	ЖИІЛІГІ	ПРОЦЕДУРАЛАР КУРСЫ
ҚАЙЫЗҒАҚ / ҚАБЫРШАҚТАНУ (бас терісінің аурулары болмаған жағдайда)	Тәуліктің кез келген уақытында, шаш жуғаннан кейін, дымқыл шашқа	LED: көк LED - 3 минут; қызыл LED - 7 минут. Діріл: 3 минут. Бір уақытта емес, осы ретпен қолданыңыз. БӨЛЕК, шаш жууға тәуелсіз: EMS, орташа деңгей - 3-4 минут.	LED: күн сайын. Діріл: аптасына 3 рет. EMS: аптасына 2 рет.	LED + діріл: 4 апта, содан кейін 1 апта үзіліс. 1 ай бойы қайталаңыз. Әрі қарай қайталау қажет емес, себебі курс мәселе шешілгенге дейін жалғасады. EMS: 4 апта, содан кейін 1 апта үзіліс. 1 ай бойы қайталаңыз.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
Сақтықпен қолданыңыз:
• алкогольден мас күйде, етеккір және бала емізу кезеңдерінде;
• телеангиэктазия болғанда;
• уақытша пломба болғанда немесе тіс емдеу кезінде;
• металға аллергия болғанда;
• дене қызуы жоғарылағанда және гипертония кезінде;
• бас терісіне пластикалық операция жасалғанда, тері қабынғанда және қышығанда.

ЕСКЕРТУЛЕР:
1. Металл протездер орналасқан жерлердің жанында қолданбаңыз (көз алмасы, ішкі құлақ, сүйек және буын аймақтары).
2. Көктамыр немесе артерия патологиялары бар жерлерде, сондай-ақ тромбофлебит немесе қан ұюына қатысты мәселелер болғанда қолдануға тыйым салынады.
3. Механикалық әсерден қорғаңыз.
4. Құрылғыны тек пайдалану нұсқаулығына сәйкес қолданыңыз.
5. Өнімді бөлшектеуге, техникалық қызмет көрсетуге және жаңғыртуға тыйым салынады.
6. Құрылғыны құрғақ әрі таза жерде сақтаңыз.
7. Құрылғыны қоршаған орта температурасы жоғары немесе төмен жерлерде, сондай-ақ ашық от көздерінің жанында сақтамаңыз.
8. Зарядтау аяқталғаннан кейін ашаны розеткадан суырыңыз.
9. Құрылғыны балалардан алыс ұстаңыз.

ЖИНАҚ ҚҰРАМЫ: (1) массажер, (2) сақтау қабы, (3) майлық,
4. зарядтауға арналған USB-C кабелі, 5) нұсқаулық.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

ЗАРЯДТАУ УАҚЫТЫ: 3 h

ЖҰМЫС УАҚЫТЫ: 2 h

АҚЫЛДЫ ТАЙМЕР: 10 min

РЕЖИМДЕР:
1. EMS: 1-деңгей - 31 mA, 2-деңгей - 43 mA, 3-деңгей - 78 mA
2. Фототерапия: қызыл LED жарығы (630 nm), лазер жарығы (650 nm), көк LED жарығы (460 nm)
3. Діріл - минутына 6500 айналым

EMS ЖИІЛІГІ: 9,51 kHz

ТОЛҚЫН ПІШІНІ: екі фазалы симметриялы толқын

СУДАН ҚОРҒАНЫСЫ: IPX6



ELAX 2.0 - КӨЗГЕ АРНАЛҒАН БОСАҢСЫТАТЫН МАССАЖ МАСКАСЫ

Көз шаршауын басады

Бас ауруын азайтады

Ұйқысыздықта көмектеседі

Босаңсыту

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: жалпы шаршау және көздің шаршауы, бас ауруы, бас сақинасы, ұйықтап кетудің қиындауы, компьютерде ұзақ жұмыс істеу.

МАТЕРИАЛДАРЫ: модал, лайкра.

САЛМАҒЫ: 111 g.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
ЖЫЛУ қан айналымын жақсартып, көздің керілуін басады. ДІРІЛ көз айналасындағы бұлшықеттерді тиімді босаңсытады, лимфаның қалыпты келуі мен ағуын қалпына келтіруге көмектеседі, жалпы шаршау мен көздің керілуін азайтады. САЛҚЫН КОМПРЕСС тамырларды тарылтып, көз айналасы мен бетсүйектегі ісінуді азайтады. Суық әсері қан ағынын азайтып, артық сұйықтықтың ағуына ықпал етеді. 3D маска көз бен кірпікке қысым түсірмейді, бетке тығыз жанасып, жарықтан қорғайды. Сондықтан оны ұйқы маскасы ретінде де қолдануға болады.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:
1. Қолданудың 4 нұсқасы: қыздыру, діріл, қыздыру + діріл, салқын компреске арналған төсем.
2. Маска жеңіл, қолданғанда көзге қысым түсірмейді.
3. Ыңғайлы температураны таңдауға арналған 3 қыздыру деңгейі және оңтайлы массаж күшін реттеуге арналған 3 діріл деңгейі бар.
4. Масканың анатомиялық 3D пішінінде пайдаланушыға барынша ыңғайлы болу үшін көзге арналған ойық және мұрын мен кеңсірікке арналған ойықтар бар.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ:
1. Басқару пультін маскаға жалғаңыз. Назар аударыңыз: маска мен пульттің қосылысы әлсіз болғанда заряд индикаторы ақ түспен жанады.
2. Дірілді ауыстыру немесе температура батырмасын 2 секунд басып тұрып, массажерді қосыңыз. Заряд деңгейінің жарық индикаторы жанады.
3. Діріл мен қыздыру режимдері бір-бірінен тәуелсіз жұмыс істейді. Қажетті режимді таңдаңыз.
4. Діріл режимінің 3 деңгейі бар. Массажер 1 дыбыстық белгі беріп, төмен діріл деңгейінде іске қосылады. Деңгей ауысқанда 2 дыбыстық белгі 2-деңгейді, 3 белгі 3-деңгейді білдіреді.

5. Қыздыру режимінің 3 температура деңгейі бар. Массажер 1 дыбыстық белгі беріп, төмен қыздыру деңгейінде іске қосылады. Деңгей ауысқанда 2 дыбыстық белгі орташа қыздыру деңгейін, 3 белгі ең жоғары деңгейді білдіреді.
6. Массажерде ақылды таймер бар: құрылғы 15 минут жұмыс істегеннен кейін өшеді. Діріл мен қыздыру режимдері тәуелсіз жұмыс істейді, әрқайсысының таймері бөлек жүреді. Діріл деңгейін немесе температураны ауыстырғанда таймер қайта басталмайды.
7. Құрылғыны өшіру үшін діріл немесе қыздыру режимінің қосу/өшіру батырмасын 2 секунд басып тұрыңыз.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Басқару пультін маскаға жалғаңыз.
2. Масканы көзіңізге киіп, қосыңыз.
3. Дірілді, қыздыруды немесе екеуін бірге қосыңыз.
4. Температура мен қыздыру деңгейін реттеңіз.
5. 15 минут массаждан ләззат алыңыз.
6. Салқын компресс қолданғыңыз келсе, төсемді алдын ала тоңазытқышқа 10 минутқа салыңыз. Құрылғыны қоспай, төсемді маскаға орналастырыңыз.

ҚОЛДАНУ ЖИІЛІГІ:
Күн сайын қолдануға болады.

ҚОЛДАНУ ҰЗАҚТЫҒЫ:
Шектелмеген.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Терісі жылуды сезбейтін адамдар, дене қызуы жоғары немесе суық тиген адамдар құрылғыны қолданар алдында дәрігермен кеңесуі тиіс.
2. Құрылғыны қолдану ұсынылмайды:
• тромбоз, ауыр аневризма, жедел көктамыр аневризмасы, дерматиттің кез келген түрі немесе тері инфекциялары болғанда, себебі құрылғы жағдайды нашарлатуы мүмкін;
• өз еркін білдіре алмайтын немесе өнімді өздігінен қолдана алмайтын адамдарға;
• 14 жасқа толмаған балаларға.
3. Құсу, құрысу немесе басқа дене реакциялары пайда болса, өнімді қолдануды тоқтатыңыз.

ЕСКЕРТУЛЕР:
1. Өнімді балалар мен сәбилердің қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
2. Өнім 12 жастан асқан адамдарға арналған.
3. Басқару пультін, зарядтау кабелі мен зарядтау ұясын құрғақ ұстаңыз.
4. Маска бетіне парфюм, дезодорант сияқты химиялық сұйықтықтарды шашпаңыз.
5. Зақымдалмауы үшін көз маскасы мен зарядтау кабелін бүкпеңіз, тартпаңыз және байламаңыз.
6. Көз аурулары немесе аллергиясы бар, ыстық компреске жедел реакциясы болатын адамдарға қолданар алдында дәрігермен кеңесу ұсынылады.

ЖИНАҚ ҚҰРАМЫ: (1) маска, (2) салқын компреске арналған төсем, (3) USB-Type C зарядтау кабелі, (4) сақтау қабы, (5) нұсқаулық.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:
ЗАРЯДТАУ УАҚЫТЫ: 1 сағат

ЖҰМЫС УАҚЫТЫ: Жоғары температура режимінде 75 минут, орташа температура режимінде 60 минут, төмен температура режимінде 45 минут

АҚЫЛДЫ ТАЙМЕР: 15 min
ДІРІЛ ЖЫЛДАМДЫҒЫ: Төмен деңгей - минутына 3000 айналым; орташа деңгей - минутына 4000 айналым; жоғары деңгей - минутына 5000 айналым

ТЕМПЕРАТУРА РЕЖИМДЕРІ: • Төмен температура - 40-45 °C; орташа температура - 45-50 °C; жоғары температура - 50-55 °C

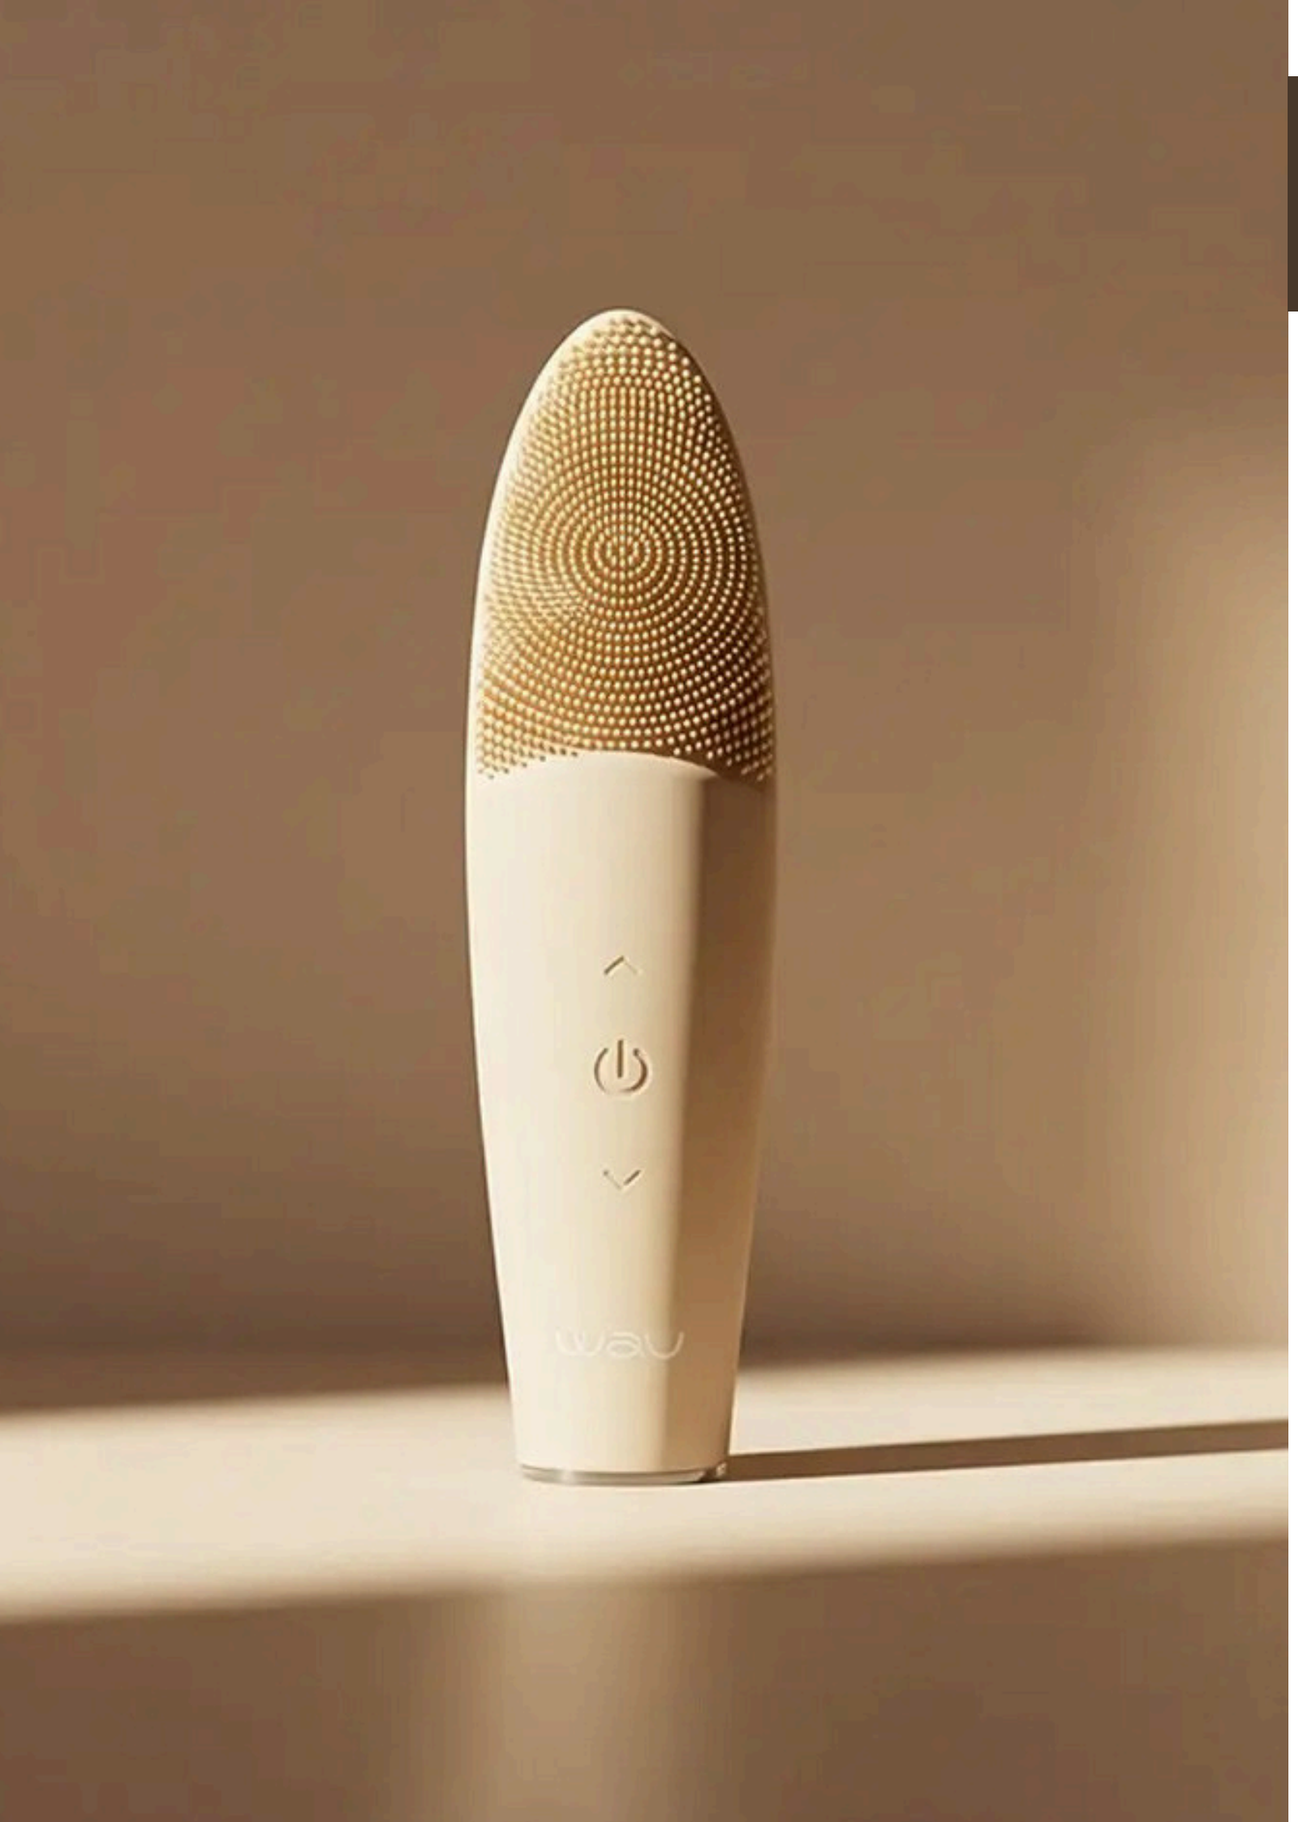

ЕМІ - БЕТТІ ТАЗАЛАУҒА ЖӘНЕ МАССАЖҒА АРНАЛҒАН СИЛИКОН ЩЕТКА

Теріні тазартады

Лифтинг әсері

Ісінуді азайтады

Бет реңін жақсартады

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: бітелген, кеңейген тері тесіктері, тері майының көп болуы, ісіну.

МАТЕРИАЛЫ: силикон.

САЛМАҒЫ: 97 g.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
Массажер жоғары жиілікті (дыбыстық) тербеліс қағидасымен жұмыс істейді; қуатын өзіңіз реттей аласыз. ДЫБЫС ТОЛҚЫНЫ (жоғары жиілікті діріл) қылшықтарды жылдам тербетіп, сыпыру қозғалыстарын жасатады. Осылайша щетка бет терісін тазартады, ал жинақталатын әсері тері реңін тегістеп, тесіктерді тазартады.

Діріл және бедерлі қырлары бар жағы жұмсақ массаж жасап, қан айналымын қалпына келтіруге, ұсақ әжімдерді тегістеуге мүмкіндік береді.

Жылыту режимі тері тесіктерін ашып, терең тазартуға мүмкіндік береді. Жылу қан айналымын белсендіреді, терідегі зат алмасуды жеделдетеді және косметиканың пайдалы құрамдастарының сіңуіне ықпал етеді.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:
1. Саусақ фалангасына ұқсас ерекше пішіні мен иілгіш серпімді басы беттің барлық аймағын кір мен макияждан мұқият, тиімді әрі еркін тазартуға мүмкіндік береді.
2. Щетка тағамдық силиконнан жасалған, сондықтан онымен тазалау жұмсақ өтеді және ең сезімтал теріге де жарайды.
3. Сорғышы бар магниттік-индукциялық зарядтау базасы массаж щеткасын жуынатын бөлмедегі айнаға немесе қабырғаға ыңғайлы орналастыруға мүмкіндік беріп, сақтау мен зарядтауды жеңілдетеді.
4. Реттелетін 8 діріл деңгейі.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ:
1. Құрылғыны қосу үшін қосу/өшіру батырмасын ұзақ басыңыз.
2. Щетканың 2 режимі бар: қыздырумен үздіксіз діріл және толқынды діріл. Алғаш қосқанда қыздырумен реттелетін діріл режимі автоматты түрде іске қосылады.

3. Қыздырумен үздіксіз діріл режимінде 8 діріл деңгейі қолжетімді. Деңгейді жылдамдықты арттыру/азайту батырмаларымен реттеңіз.
4. Толқынды діріл режиміне ауысу үшін қосу/өшіру батырмасын қайта басыңыз.
5. Қосу/өшіру батырмасын тағы басу құрылғыны өшіреді.
6. Щетканың жад функциясы бар: қайта қосылғанда соңғы қолданылған режимде жұмыс істей бастайды.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:

НЕГІЗГІ ТАЗАЛАУ ҮШІН
1. Бетіңізді сумен сулаңыз.
2. Бет жуу құралын щеткаға жағыңыз.
3. Құрылғының қыздырумен үздіксіз діріл режимін қосыңыз.
4. Щетканы білегіңізге тигізіп, көбіктендіріңіз.
5. Щетка басын бетіңізге тигізіп, тазарту үшін массаж жасаңыз. Массаж сызықтарымен төменнен (иектен) жоғары (маңдайдағы шаш өсу сызығына) қарай жылжытыңыз.
6. Аяқтағаннан кейін бет пен щеткадағы косметика қалдықтарын сумен жуыңыз.

Т-АЙМАҚТЫ ТЕРЕҢ ТАЗАЛАУ ҮШІН
1. Бетіңізді сумен сулаңыз.
2. Бет жуу құралын щеткаға жағыңыз.
3. Құрылғының толқынды діріл режимін қосыңыз.
4. Щетканы білегіңізге тигізіп, көбіктендіріңіз.
5. Щетка басын бетіңізге тигізіп, Т-аймаққа массаж жасаңыз. Массаж сызықтарымен төменнен (иектен) жоғары (маңдайдағы шаш өсу сызығына) қарай жылжытыңыз.
6. Аяқтағаннан кейін бет пен щеткадағы косметика қалдықтарын сумен жуыңыз.

МАССАЖ ҮШІН
1. Бетіңізге крем, сарысу немесе гель сияқты косметикалық құрал жағыңыз (ылғалдандыратын құралды таңдау маңызды).
2. Құрылғыны қосып, өзіңізге ыңғайлы режимді таңдаңыз.
3. Щетканың артқы жағымен бетке массаж жасаңыз: массаж сызықтарымен төменнен (иектен) жоғары (маңдайдағы шаш өсу сызығына) қарай жылжытыңыз.

ҚОЛДАНУ ЖИІЛІГІ МЕН ҰЗАҚТЫҒЫ:

ТЕРІ ТҮРІ / МӘСЕЛЕ	ТӘУЛІК УАҚЫТЫ	ҰЗАҚТЫҒЫ МЕН РЕТІ	ЖИІЛІГІ	ПРОЦЕДУРАЛАР КУРСЫ
БЕЗЕУ / ҚАБЫНУ	Таңертең қолданған жөн	Толқынды діріл: 5 минут. Қыздыруды қолданбаңыз.	Күн сайын	Тұрақты түрде
ҚҰРҒАҚ ТЕРІ / ТОНУСТЫҢ ТӨМЕНДЕУІ	Таңертең	Қыздырумен үздіксіз діріл: 3-5 минут, тек ұрт пен иекке. Толқынды діріл: 3-5 минут. Екі режимді бір сеанста қолдануға болады, бірақ қыздырумен үздіксіз дірілге тек күнара рұқсат етіледі. Екі режимді бірге күн сайын қолданбаңыз.	Қыздырумен үздіксіз діріл: күнара. Толқынды діріл: күн сайын.	Тұрақты түрде

ТЕРІ ТҮРІ / МӘСЕЛЕ	ТӘУЛІК УАҚЫТЫ	ҰЗАҚТЫҒЫ МЕН РЕТІ	ЖИІЛІГІ	ПРОЦЕДУРАЛАР КУРСЫ
ҚАРА НҮКТЕЛЕР (қабыну болмағанда)	Тәуліктің кез келген уақытында	Қыздырумен үздіксіз діріл: 5-7 минут. Т-аймақ: маңдай, мұрын және иек.	Күн сайын	Тұрақты түрде
ҚЫЗДЫРУМЕН МАССАЖ (қабыну болмағанда)	Тәуліктің кез келген уақытында	Қыздырумен үздіксіз діріл: 5-7 минут.	Аптасына 2-3 рет	Тұрақты түрде

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Тері қатты ісінгенде, операциядан кейін бірден, күнге күйгенде немесе тері зақымдалғанда құрылғыны қолданбаңыз.
2. Көз айналасында қатты қабыну немесе ісіну бар адамдарға құрылғыны қолдану ұсынылмайды.
3. Құрылғыны оңай еритін тазартқышпен, силикон негізіндегі кремдермен, түйіршіктері бар құралдармен (скрабтармен) немесе пилинг құралдарымен қолданбаңыз.
4. Щетканы жеке пайдалану ұсынылады.

ЕСКЕРТУЛЕР:
1. Құрылғыны қолданар алдында сағатты, көзілдірікті, жасанды кірпіктер мен контакт линзаларды шешіңіз.
2. Құрылғы зақымдалған болса, қолданбаңыз.
3. Құрылғыны терінің бір аймағында тым ұзақ қолданбаңыз.
4. Құрылғыны жоғары температурадан алыс ұстаңыз.
5. Құрылғыны суға толық батырмаңыз.

ЖИНАҚ ҚҰРАМЫ: (1) щетка, (2) зарядтау базасы, (3) DC-USB зарядтау кабелі, (4) нұсқаулық.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

ЗАРЯДТАУ УАҚЫТЫ: 5 h

ЖҰМЫС УАҚЫТЫ: 60 min

АҚЫЛДЫ ТАЙМЕР: 5 min

ҚЫЗДЫРУ ТЕМПЕРАТУРАСЫ: 55 ± 5 °C

ДІРІЛ: минутына 7500 айналым

СУДАН ҚОРҒАНЫСЫ: IPX7



HAZUMI LIGHT - ПЕРКУССИЯЛЫ МАССАЖЕР

Бұлшықет керілуін басады

Қан айналымын жақсартады

Бұлшықет тонусын жақсартады

Целлюлитке қарсы әсер

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: қарқынды дене жүктемесінен кейінгі ауырсыну, керілу және бұлшықет шаршауы.

МАТЕРИАЛДАРЫ: ABS пластигі, резеңке.

САЛМАҒЫ: 230 g.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
Перкуссиялы массажер соққылы-ілгерілемелі діріл жасайды: таңдалған жылдамдыққа байланысты жиілігі мен қарқындылығы өзгеретін жылдам қысқа импульстер шығарады. Соққы күшінен пайда болатын діріл толқыны дененің жұмсақ тіндеріне бірнеше сантиметрге дейінгі тереңдікке енеді. Перкуссия импульстері бұлшықеттерді босаңсытады, қабынған бұлшықеттерден лимфа сұйықтығы мен көктамыр қанының ағуына көмектеседі, жабысуларды ыдыратады, ауырсыну мен керілуді азайтады, осы дене бөлігінің қозғалыс ауқымын арттырып, бұлшықеттерді жұмсақ созады. Соның нәтижесінде бұлшықеттер мен дәнекер тіндер тезірек қалпына келеді.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:
1. HAZUMI Light - HAZUMI-ге қарағанда ықшам әрі жеңіл шағын массажер, сондықтан массаж жасау одан да ыңғайлы.
2. Жинақта барлық бұлшықет топтарын өңдеуге арналған 4 ауыстырмалы саптама бар.
3. Қарқындылықтың 5 деңгейі әртүрлі бұлшықет топтары мен саптамалар үшін соққылардың ең ыңғайлы жылдамдығын таңдауға мүмкіндік береді.
4. Ақылды таймер (10 минут) массаж кезінде босаңсуға мүмкіндік береді: процедура уақыты аяқталғанда құрылғы автоматты түрде өшеді.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ:
1. Құрылғының зарядталғанына көз жеткізіңіз.
2. Қажетті массаж саптамасын құрылғыға орнатыңыз.
3. Қуат батырмасын ұзақ басып, құрылғыны іске қосыңыз.
4. Массаж тапаншасы қосылғанда қарқындылықтың 1-деңгейі автоматты түрде орнатылады.
5. Қарқындылық деңгейін ауыстыру үшін батырманы қысқа басыңыз. Құрылғыда барлығы 5 жылдамдық бар. Біріншісінде 1 индикатор жанады. Қарқындылық әр көтерілген сайын тағы бір индикатор қосылады; 5-жылдамдықта барлық 5 индикатор жанады.

6. Массажерді өшіру үшін қуат батырмасын басып тұрыңыз.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Денеңіздің қай аймағын өңдегіңіз келетініне қарай 4 саптаманың 1-еуін орнатыңыз.
• Дөңгелек саптама ірі бұлшықет топтарына, санға, балтыр бұлшықеттеріне, бөксе мен ішке массаж жасауға ұсынылады.
• U пішінді саптама иыққа, білекке және омыртқаға массаж жасауға арналған.
• Конус тәрізді саптама (оқ) сіңірлерге, табанға, алақанға, қолға және триггерлік нүктелерге терең массаж жасауға арналған.
Жалпақ саптама бүкіл денеге массаж жасауға, жұмсақ тіндер мен сезімтал бұлшықет топтарын босаңсытуға және қалпына келтіруге қолданылады.
2. Қуат батырмасын қысқа басып, 5 қарқындылық деңгейінің 1-еуін таңдаңыз.
1-деңгей: бұл жылдамдық массаж басында бұлшықеттерді қыздыруға көмектеседі және оларды белсендіруге қолданылады.
• 2-деңгей. Осы қарқындылықта тереңдегі және қолжетімділігі қиын бұлшықеттер мен фасцияларды (қозғалысымызды қамтамасыз ететін бұлшықеттердің дәнекер қабығын) өңдеу басталады.
• 3-деңгей. Бұл жиіліктегі діріл бұлшықет тонусын, қозғалысын және тіннің икемділігін арттырады. Керілген және қысылған бұлшықеттер жиырылу, қалыпты тонуста болу және дұрыс жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіреді.
• 4-деңгей. Бұл әсер деңгейі бұлшықеттер мен фасциялардағы керілу мен ауырсынуды басады, босаңсытады, қан айналымын қалыпқа келтіріп, тіндерді оттегімен қанықтырады.
• 5-деңгей. Минутына 3000 айналым нүктелі массаж жасауға, бұлшықеттің қатты керілуі мен түйілуін өңдеуге мүмкіндік береді. Массаж мамандары құрылғыны ең жоғары жылдамдықта қолдануды ұсынбайды. Күшті әсер бұлшықеттері дамыған пайдаланушыларға - кәсіби ауыр атлеттерге, бодибилдерлер мен пауэрлифтерлерге жарайды.
3. Массаж тапаншасын денеңізге тигізіңіз. Саптамасы бұлшықеттің үстіндегі теріге жеңіл жанасатындай орналастырыңыз.
4. Құрылғыны денеге тигізу қысымы мен күшін реттеңіз. Массажерді денеге қатты басу немесе ұзақ күшпен қысу ұсынылмайды.
5. Саптаманы дене немесе бұлшықет бойымен жоғары-төмен баяу жылжытыңыз. Ауырсынатын нүктелерде сәл ұзағырақ кідіруге болады.
6. Бір аймаққа әсер ету уақыты қажетті нәтижеге байланысты. Керілуді басып, бұлшықеттерді сергітуге 15-60 секунд жеткілікті. Жергілікті қысылуды босату үшін сол нүктеде 30 секунд кідіріңіз.
7. Жалпы массаж уақыты - 10 минут, одан кейін массажер автоматты түрде тоқтайды.

ҚОЛДАНУ ЖИІЛІГІ:
Күн сайын қолдануға болады.

ҚОЛДАНУ ҰЗАҚТЫҒЫ:
Шектелмеген.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Массаж тапаншасын мойынның алдыңғы және бүйір беттеріне қолдануға тыйым салынады (ұйқы артерияларын зақымдау қаупі бар).
2. Массажерді бетке, бас және жүрек аймағына қолдануға тыйым салынады.
3. Қабыну процестері, сүйек сынуы, бұлшықет немесе байлам созылуы кезінде массажерді қолдану ұсынылмайды.

ЕСКЕРТУЛЕР:
1. Құрылғыны ылғалды ортада қолданбаңыз.
2. Өнімді ванна немесе душ қабылдау кезінде қолданбаңыз.

ЖИНАҚ ҚҰРАМЫ: (1) перкуссиялы массажер, (2) U пішінді саптама, (3) дөңгелек саптама,
4. конус тәрізді саптама, 5) жалпақ саптама, 6) USB-C зарядтау кабелі,
7. бау, 8) сақтау қабы, 9) нұсқаулық.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:
ЗАРЯДТАУ УАҚЫТЫ: 2 сағат. ЖҰМЫС УАҚЫТЫ: қолдану қысымы мен таңдалған деңгейге байланысты.
• 1-деңгейде 4 сағатқа дейін
5-деңгейде 2.5 сағатқа дейін. Ақылды таймер: 10 минут
ДІРІЛ ЖЫЛДАМДЫҒЫ:
• 1-деңгей - минутына 1800 айналым
2-деңгей - минутына 2100 айналым
• 3-деңгей - минутына 2400 айналым
4-деңгей - минутына 2700 айналым
• 5-деңгей - минутына 3000 айналым



HIGE - ЫҚШАМ ЭЛЕКТР ҰСТАРА

Сақал күтімі | Таза қырыну | Қажетсіз түктерді кетіреді

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: беттегі артық түк.

МАТЕРИАЛЫ: металл.

САЛМАҒЫ: 140 g.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
HIGE - 2 қырыну басы бар роторлы ұстара. Басы - астында жүздері айналатын тесікті диск. Электр қозғалтқышы жүздерді шеңбер бойымен айналдырады. Қырыну кезінде түктер тесіктерге түседі де, тордың астында минутына 2600-2900 тербеліс жылдамдығымен айналатын жүздер қылдарды толық кеседі. Ұстараның бұл түрі ең тиімді деп саналады, бірақ сезімтал теріні тітіркендіруі мүмкін.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:
1. Ықшам: электр ұстараның салмағы небәрі 140 g, оңтайлы өлшемі - 66×52×28 mm.
2. Ұстараны розеткаға қосудың қажеті жоқ. HIGE - аккумуляторлы ұстара. Бір зарядпен 55 минутқа дейін дербес жұмыс істейді.
3. IPX7 ылғалдан қорғанысы арқасында HIGE құрғақ және ылғалды қырынуға жарайды.
4. HIGE 2 қозғалмалы баспен жабдықталған. Олар қозғалыс кезінде бет пішінін қайталап, жүздерді дұрыс бұрышқа бағыттайды және қолжетімділігі қиын жерлерді тиімдірек қыруға көмектеседі.
5. Шағын дисплей ұстараны басқаруды оңай әрі ыңғайлы етеді:
Дисплейде қолдану уақыты, заряд деңгейі, жұмыс режимі және құлыптау күйі көрсетіледі.
6. Құлыптау функциясы бар. Ұстара жүк, сөмке немесе қалта ішінде қосылып кетпейтініне сенімді бола аласыз.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ:
1. Ұстараны қосу: қосу/өшіру батырмасын қысқа басыңыз. Басқаннан кейін дисплейдегі барлық индикатор төменнен жоғары қарай кезекпен жанады. 0.2 секундтан кейін барлығы бір уақытта өшеді де, дисплейде ағымдағы заряд деңгейімен қалған жұмыс уақыты ғана көрсетіледі. Мысалы: 58 минут қалды.
2. Құрылғыда 2 жұмыс режимі бар: төмен және жоғары жылдамдық. Ауыстыру үшін қосу/өшіру батырмасын 1 секунд басып тұрыңыз. Төмен жылдамдықтан жоғары жылдамдыққа ауысқанда

дисплейдің төменгі сол жақ бұрышында жылдамдық индикаторы пайда болады. Жоғары жылдамдықтан төменге ауысқанда индикатор өшеді. Құрылғының жад функциясы бар: қосылғанда соңғы қолдануды аяқтаған жылдамдықта жұмыс істейді.
3. Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда қосу/өшіру батырмасын қысқа басу оны үзіліске қояды. Дисплейде осы сеанстағы жұмыс уақыты көрсетіледі. Мысалы: 15 секунд қолданылды.
4. Өшіру: құрылғыны өшіру үшін қосу/өшіру батырмасын 1 секундтан артық басып тұрыңыз.
5. Кездейсоқ қосылудан қорғау: тасымалдау кезіндегі құлып қосу/өшіру батырмасы байқаусыз басылғанда ұстараның жүк ішінде қосылып кетуіне жол бермейді. Іске қосу үшін өшірулі құрылғының қосу/өшіру батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз. Дисплейде 1-2-3 сандары кезекпен көрсетіліп, төменгі оң жақтағы құлып белгісі 3 рет жыпылықтайды. Содан кейін құрылғы өшіп, құлыптау режиміне өтеді. Ашу үшін қосу/өшіру батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз. Дисплейде 3-2-1 сандары кезекпен көрсетіліп, құлып белгісі 3 рет жыпылықтайды. Құлып ашылып, құрылғы соңғы қолдануда сақталған жылдамдықта жұмыс істейді. Құлыптаулы күйде зарядтауға болады; зарядтау аяқталғанда құлып ашылады.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Қосу/өшіру батырмасын қысқа басып, құрылғыны қосыңыз.
2. Беттегі түк өсетін аймақтарда орташа қысыммен баяу айналмалы қозғалыстар жасаңыз (құрғақ қырыну тиімдірек деп саналады).
3. Жақ, мойын және декольте сияқты қолжетімділігі қиын жерлерді қырғанда түктің өсу бағытына қарсы жылжыту ұсынылады.
4. Процедура аяқталған соң құрылғыны өшіріп, тазалаңыз.
5. Алғашқы бірнеше қолдануда терінің аздап тітіркенуі қалыпты болып саналады.

ҚОЛДАНУ ЖИІЛІГІ:
Тері құрылғыға мүмкіндігінше тез бейімделуі үшін ұстараны 3 апта бойы тұрақты (аптасына кемінде 3 рет) қолдану ұсынылады.

ҚОЛДАНУ ҰЗАҚТЫҒЫ:
Жүздер жинағының қызмет мерзімі - 2 жыл. Бірақ қырыну сапасы төмендемеуі үшін оларды әр 6 ай сайын ауыстыруды ұсынамыз.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
Электр ұстараны зақымдалған немесе тітіркенген теріге, ашық жарасы бар аймақтарға қолданбаңыз.

ЕСКЕРТУЛЕР:
1. Дұрыс қолданбау қырыну басын зақымдауы мүмкін. Ұстараны тым қатты баспаңыз. Бұл ұстара тек бетті қыруға арналған. Бас шашына немесе дененің басқа бөліктеріне қолданбаңыз.

2. Қолданар алдында ұстара басының бүтіндігін тексеріңіз:
зақымдалған болса, құрылғыны қолданбаңыз.
3. Батареяны ауыстыру үшін корпусты бөлшектемеңіз. Өнімді өз бетіңізше өзгертпеңіз немесе жөндемеңіз.
4. Зарядтау кабелін адаптерге қосқанда немесе ажыратқанда кабельден тартпаңыз. Кабель зақымдалмауы үшін оны өнімнің сыртына орамаңыз.
5. Құрылғыны ұзақ уақыт қараусыз қалдырмаңыз. Зарядтау уақыты 24 сағаттан аспауы тиіс. Жарақаттанбау үшін зарядтау кезінде өнімді су көздерінен алыс ұстаңыз.
6. Өнімнің ішінде аккумулятор бар: құрылғыны отқа тастамаңыз, жоғары температурада зарядтамаңыз, қолданбаңыз және сақтамаңыз. Ұстараны 5-35 °C температурада зарядтаңыз, қолданыңыз және сақтаңыз.
7. Өнімнің ішіне бөгде заттарды салмаңыз.
8. Ұстара бір адамның жеке қолдануына арналған.
9. Ұстарамен саяхаттасаңыз, тасымалдау кезінде құлыптау режимі қосылғанына көз жеткізіңіз.
10. Толық әрекет қабілеттілігі жоқ адамдар өнімді бақылаумен қолдануы тиіс.

ЖИНАҚ ҚҰРАМЫ: 1) электр ұстара, 2) зарядтауға арналған USB-C кабелі, 3) нұсқаулық,
4. жүздерді майлауға арналған май құтысы, 5) құрылғыны тазалау щеткасы,
6. сақтауға арналған былғары қап.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

ЗАРЯДТАУ УАҚЫТЫ: 66 min

ЖҰМЫС УАҚЫТЫ: 60 min

АҚЫЛДЫ ТАЙМЕР: жоқ

ЖҮЗДЕРДІҢ АЙНАЛУ ЖЫЛДАМДЫҒЫ: Төмен - минутына 2600 ± 200 айналым; жоғары - минутына 2900 ± 200 айналым

СУДАН ҚОРҒАНЫСЫ: IPX7



HIGE PRO - 6 ФУНКЦИЯ 1 ҚҰРЫЛҒЫДА БІРІКТІРІЛГЕН ТРИММЕР

Үйде шаш пен сақалға күтім жасау

Бет пен денедегі қажетсіз түктерді кетіреді

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: түк ұзындығын реттеу, қажетсіз түктер.

МАТЕРИАЛДАРЫ: металл, тот баспайтын болат, пластик.

САЛМАҒЫ: 200 g.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
HIGE Pro - жеке күтімге арналған әмбебап құрылғы. Жинақтағы 6 саптама қырыну мен шаш қиюдың барлық түрін оңай орындауға мүмкіндік береді. Негізгі жұмыс қағидасы: түкті бір жүз емес, қозғалмайтын (төменгі) және қозғалмалы (жоғарғы) екі элементтің өзара әрекеті кеседі. Төменгі жүз қозғалмай, теріге тығыз жанасады. Оның тістері түктерді бағыттап, ұстап, тік қалыпта ұстайды. Жоғарғы жүз айналмалы қозғалтқыштың эксцентригіне қосылған. Ол төменгі жүздің бетімен оңға-солға жылдам қозғалады. Жоғарғы жүздің өткір қыры түкті төменгі жүздің өткір қырына қысып кеседі.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:
1. Қырынудың әртүрлі түрлеріне арналған 6 саптама бар.
2. Қырқу ұзындығын реттеуге арналған 4 тарақ-саптама бар.
3. Құрылғы мен барлық негізгі саптамаларға арналған ыңғайлы тұғыр бар.
4. Айналу жылдамдығы минутына 7000 айналым болатын кәсіби жүздер.
5. Ылғалдан қорғаныс дәрежесі - IPX6 (құрылғыны дымқыл теріге қолдануға болады).
6. Ұстараны розеткаға қосудың қажеті жоқ. HIGE Pro - аккумуляторлы ұстара. Аккумулятор 200 минут жұмыс істейді, сондықтан жиі зарядтамай ұзақ қолдануға болады.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ:
1. Құрылғыны қосу немесе өшіру үшін қосу/өшіру батырмасын қысқа басыңыз. Қосылғанда дисплейдегі сызық бірқалыпты қозғалып, кейін тұрақты жанады.
2. Саптамаларды ауыстыру
• Металл саптамалар магниттік тетікпен бекітіледі. Саптаманы корпусқа бекіту үшін бекіту орнына жақындатыңыз: магниттер оны ұстап қалады. Алу үшін саптаманы жоғары тартып, корпустан ажыратыңыз.

• Тарақ-саптамалар қырқу ұзындығын реттеу үшін стандартты саптаманың үстіне орнатылады. Орнату үшін тарақты металл саптаманың жоғарғы бөлігіне іліп, төменгі бөлігін шертілгенше басыңыз: ол металл бетке тығыз жанасуы тиіс. Алу үшін тарақтың төменгі жағындағы тілшікті жоғары тартыңыз. Ескерту: саптаманы ауыстырмас бұрын құрылғының өшірулі екеніне көз жеткізіңіз. Кездейсоқ қосып алмау үшін саптаманы ауыстырғанда қолыңызды қосу/өшіру батырмасынан алыс ұстап, корпусты ұстаңыз.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
Жинақта әртүрлі қажеттілікке арналған 6 саптама бар:
1. Шаш қию (бұған 2 саптама жарайды):
шаш қиюға арналған стандартты саптама және дене түгін қыруға арналған саптама. Құрылғыға тарақ-саптаманы бекітіңіз. Триммерді алғаш қолдансаңыз, ең ұзын саптамадан (12 mm) бастаңыз. Құрылғыны қосып, саптаманың жалпақ бөлігін теріге тигізіңіз. Шаш бойымен баяу жылжытыңыз. Қажет болса, әртүрлі бағытта қайталаңыз. Ескерту: тараққа шаш жиналса, құрылғыны өшіріп, саптаманы тазалаңыз.
2. Сақал/мұрт қыру: саптаманы сақал/мұрт сызығының шетіне қойып, теріге абайлап түсіріңіз. Бет пен мойынның қажетті аймақтарын әртүрлі бағытта жылжытып тегістеңіз. Ескерту: сақал/мұрттың шетін немесе желке сызығын қалыптастырғанда тарақ-саптаманы алып тастаңыз. Айқын сызық жасау үшін сақал мен мұрт жиегіне арналған арнайы саптаманы да қолдануға болады.
3. Торлы қырыну саптамасымен қыру: саптама бетке 45 градус бұрышпен жеңіл тиетіндей ұстаңыз. Қысқа жанасулармен қырыныңыз. Бос қолыңызбен теріні керіңіз: бұл түктерді тік тұрғызып, қырынуды жеңілдетеді. Ескерту: бұл саптама сақал/мұрттың айналасындағы жекелеген аймақтарға арналған. Бетті толық қыруға арналмаған.
4. Мұрын мен құлақ түгін қырқуға арналған саптамамен қыру: орнатқаннан кейін саптаманы құлаққа немесе танауға абайлап енгізіңіз. Құрылғыны құлақтан немесе танаудан абайлап шығарып, қайта енгізіңіз. Қыру кезінде саптаманы айналдырыңыз. Ескерту: саптаманы тым терең енгізбеңіз (6 mm-ден асырмаңыз).
5. Өрнектеп қыру саптамасы: сызықтар мен өрнектер жасауға қолданылады. Орнатқаннан кейін саптаманы өрнектің басталатын жеріне қойып, ұстараны қосыңыз да, өрнекті қалыптастырыңыз. Саптаманы тым қатты баспаңыз. Ескерту: жақсы нәтиже үшін алдын ала дайындалған трафаретті қолданыңыз.

ҚОЛДАНУ ЖИІЛІГІ:
Күн сайын қолдануға болады.

ҚОЛДАНУ ҰЗАҚТЫҒЫ:
Шектелмеген.

ЕСКЕРТУЛЕР:
1. Зарядталып жатқан құрылғыны ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
2. Зарядтау кабелін жылу көздерінен алыс ұстаңыз.
3. Зарядтау кабеліне су тигізбеңіз.
4. Ашаны розеткаға дымқыл қолмен қоспаңыз және суырмаңыз.
5. Зақымдалған зарядтау кабелін қолданбаңыз.
6. Құрылғыны 15-35 °C температурада зарядтаңыз, қолданыңыз және сақтаңыз.
7. Тазалағанда құрылғыны әрдайым өшіріңіз.
8. Өнімді балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ЖИНАҚ ҚҰРАМЫ: (1) триммер, (2) стандартты шаш қию саптамасы,
3. дене түгін қыру саптамасы, 4) таза қырынуға арналған торлы саптама,
5. сақал мен мұрт саптамасы, 6) мұрын мен құлақ түгінің саптамасы,
7. өрнектеп қыру саптамасы, 8) 3/6/9/12 mm өлшемді 4 тарақ-саптама, 9) USB-C зарядтау кабелі, 10) май құтысы, 11) тазалау щеткасы, 12) тұғыр, 13) тарақ.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

ЗАРЯДТАУ УАҚЫТЫ: 2 h

ЖҰМЫС УАҚЫТЫ: 200 min

АҚЫЛДЫ ТАЙМЕР: жоқ

ЖҮЗДЕРДІҢ АЙНАЛУ ЖЫЛДАМДЫҒЫ: минутына 7000 айналым

СУДАН ҚОРҒАНЫСЫ: IPX6



KARU - ШАШҚА АРНАЛҒАН МУЛЬТИСТАЙЛЕР

Жылдам кептіру

Тиімді сәндеу

Үлпілдеуді бақылау

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: дымқыл шаш, табиғи кепкеннен кейін пішінін жоғалтқан шаш үлгісі, шаштың шамадан тыс үлпілдеуі және электрленуі.

МАТЕРИАЛДАРЫ: алюминий қорытпасы, пластик.

САЛМАҒЫ: 318 g.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:

Ауа ағынының 3 жылдамдығы мен 4 температура деңгейі өзіңізге ыңғайлы кептіру режимін таңдауға мүмкіндік береді. Суық ауа режимі шаш үлгісін оңай бекітуге көмектеседі.

Жұмсақ кептіруге, шашты тегістеуге, көлем мен бұйра жасауға арналған ТӨРТ САПТАМА арқылы күн сайын үйде кәсіби шаш үлгісін жасай аласыз.

COANDA әсері шашқа зиян келтірмей, артық қимылсыз ерекше шаш үлгілерін жасауға мүмкіндік береді: шаш бұрымы стайлерге өзі тартылады.

Иондау функциясы ауаны теріс иондармен қанықтырып, статикалық электрді жояды.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:

1. KARU стайлерінің қуаты - 1200 W. Мұндай қуатты стайлерді кәсіби деп санауға болады. Осы техникалық көрсеткіш шашты күштірек ауа ағынымен кептіруге және құрылғының жылдамырақ қызуына мүмкіндік береді.
2. Қылшақсыз қозғалтқыш (BLDC) шу мен дірілді азайтады.
3. Coanda әсері - шашты саптамаға тартып орайтын құйын ағындарын туғызатын аэродинамикалық құбылыс. KARU стайлері Coanda әсерін сапалы жаңғырту үшін бірегей патенттелген технологияны қолданады. Саптама бөліктері бірінің үстіне бірі түспейді және қиылыспайды. Бұл шаш бұрымын саптама бойына біркелкі таратуға мүмкіндік береді, сондықтан барлық шашқа жылу бірдей әсер етіп, бұйра қалыптасады және пішінін ұзақ сақтайды.
4. Бастың екі жағындағы шашты сәндеуге 1 саптама жеткілікті. Бұйра жасау және шашты тегістеу саптамаларына ауа ағынын ауыстырғыш орнатылған. Саптаманы ауыстыру қажет емес: ағын бағытын өзгерту үшін оның жоғарғы ұшын ауаны бағыттағыңыз келетін жаққа бұраңыз.

5. Температураны бақылау. KARU стайлерінің қыздыру элементінде NTC температура датчигі бар. Температура 80 °C-тан асып, ауа шығатын немесе кіретін саңылаулар бітелсе, қыздыру деңгейі автоматты түрде 35%-ға төмендейді. Температура ең төменгі 73 °C-қа түскенде қыздыру элементі қалыпты жұмыс режиміне оралады. Бұл технология шашты қызып кету мен шамадан тыс құрғаудан қорғайды.
6. KARU стайлерінің иондау функциясы бар (иондар ион генераторында түзіледі). Ол шашты тегістеп, үлпілдеуі мен электрленуін жояды.
7. Құрылғының жад функциясы бар: қосылғанда стайлер алдыңғы қолдануды аяқтаған режимде жұмыс істей бастайды.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ:
1. Саптаманы орнату/алу: бекіту үшін саптаманы орнату ұясындағы ойықтарға абайлап енгізіп, сағат тілімен сәл бұрап, шертілгенше бекітіңіз. Алу үшін құрылғының артындағы батырманы төмен тартып, сол күйде ұстап тұрып, саптаманы сағат тіліне қарсы сәл бұрап ажыратыңыз.
2. Құрылғыны қосу: қажетті саптаманы корпусқа бекітіп, стайлерді розеткаға қосыңыз да, қосу/өшіру батырмасын жоғары жылжытыңыз. Құрылғының жад функциясы бар: қосылғанда алдыңғы қолдануды аяқтаған режимде жұмыс істей бастайды.
3. Ауа ағынының жылдамдығын таңдау
Құрылғыда 3 жылдамдық режимі бар:
Төмен жылдамдық (көк көрсеткіш): 75000 ± 5000 айн/мин;
Орташа жылдамдық (ашық жасыл индикатор): 85000 ± 5000 айн/мин;
Жоғары жылдамдық (ашық жасыл индикатор): 105000 ± 5000 rpm. Ауа ағыны жылдамдығын таңдау батырмасымен ауыстырылады. Әдепкіде төмен жылдамдықта іске қосылады. Ауысу реті: төмен → орташа → жоғары → орташа → төмен.
4. Температураны таңдау
Құрылғыда 4 температура режимі бар:
Жоғары температура (қызыл индикатор): 95 °C ± 10 °C;
Орташа температура (сары индикатор): 80 °C ± 10 °C;
Төмен температура (жасыл индикатор): 60 °C ± 10 °C;
• Суық ауа (индикатор өшеді): 25 °C ± 10 °C. Режимдер температураны таңдау батырмасымен ауыстырылады. Әдепкіде құрылғы төмен температура режимінде іске қосылады. Ауысу реті: төмен температура → орташа температура → жоғары температура → орташа температура → төмен температура → суық ауа.
5. Шашты сәндеп болған соң қосу/өшіру батырмасын төмен жылжытып, құрылғыны өшіріңіз. Толық суығанша күтіп, саптаманы алыңыз және ашаны розеткадан суырыңыз.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
Жинақта 4 саптама бар:

Сәндеу алдында шашты алдын ала кептіруге қолданылады. Әрі қарай сәндеу үшін шашты толық кептірмеңіз: ол сәл дымқыл қалуы тиіс. Қыздыру кезінде зақымдалудан қорғау үшін жылудан қорғайтын құрал жағып, ауа ағынын шаш түбірінен ұшына қарай бағыттап, әдеттегідей кептіріңіз.

БРАШИНГ-САПТАМА түбір маңында көлем мен толқын жасауға қолданылады. Шаш шатаспауы үшін бұрымды брашингке бұйралағышқа немесе бигудиге орағандай орамаңыз. Шашты бұрымдарға бөліңіз. Брашингті түбірге барынша жақындатып, үстіне бұрымды түсіріңіз. Көлем жасау үшін осы қалыпта 5-7 секунд ұстаңыз. Толқын жасау үшін саптаманы бұрым бойымен түбірден ұшына қарай сырғытыңыз. Шаш ұштары сырғып шыға бастағанда брашингті өз осінен бірнеше рет айналдырыңыз. Қажетті нәтижеге дейін қайталаңыз.

Диаметрі 38 mm цилиндрлік саптама бұйра жасауға қолданылады. Бұйра бағытын таңдау үшін ауа ағынының бағытын өзгертуге болады: саптаманың жоғарғы ұшын қажетті жаққа бұраңыз. Шашты бұрымдарға бөліңіз. Саптаманы бір бұрымның ұшына жақындатыңыз. Coanda әсерінің арқасында стайлер шашты өзі тартып, саптамаға орайды. Ұштары оралғаннан кейін стайлерді айналдырмай, біртіндеп шаш түбіріне қарай жылжытыңыз. Жоғарғы қалыпта шамамен 15 секунд ұстап, бұйраланған бұрымды саптамадан абайлап босатыңыз.

ШАШТЫ ТЕГІСТЕУ САПТАМАСЫ үлпілдеген шашты тегістеуге қолданылады. Ыңғайлы сәндеу үшін ауа ағынының бағытын өзгертуге болады: жоғарғы ұшын қажетті жаққа бұраңыз. Шашты әдеттегідей кептіріп, саптаманы түбірге қойыңыз. Шаш ауа шығатын тесіктері бар бетке жатуы тиіс. Ауа ағынының бағытын реттеңіз. Шаш тарағандай, түбірден ұшына қарай бүкіл ұзындық бойымен жылжытыңыз.

ҚОЛДАНУ ЖИІЛІГІ:
Күн сайын қолдануға болады.

ҚОЛДАНУ ҰЗАҚТЫҒЫ:
Шектелмеген.

ЕСКЕРТУЛЕР:
1. Сәндеу кезінде стайлер бөліктері қызатынын ескеріңіз. Шашқа жанғыш құралдарды қолданбаңыз және құрылғыны бас терісіне, бетке, құлақ пен мойынға тым жақындатпаңыз.
2. Қаптаманы ашқаннан кейін стайлердің бүтін, суреттегідей барлық бөлшектері бар және зақымсыз екеніне көз жеткізіңіз. Қолданар алдында барлық жапсырмалар мен заттаңбаларды алып тастаңыз.

3. Құрылғы ваннада немесе душта қолдануға жарамайды. Стайлерге су, басқа сұйықтықтар, шашыраған су және бу тимеуі тиіс.
4. Құрылғыны жуынатын бөлмеде қолдансаңыз, қолданғаннан кейін бірден ашаны розеткадан суырыңыз. Су жақын болуы өшірулі құрылғы үшін де қауіпті.
5. Құрылғыны дымқыл қолмен қолданбаңыз. Ылғалдың, ауа райының (жаңбыр, күн және т.б.) немесе шектен тыс температураның әсеріне ұшыратпаңыз.
6. Ашаны розеткадан суыру үшін қуат сымынан немесе құрылғының өзінен тартпаңыз. Құрылғыны қуат сымынан тартпаңыз не көтермеңіз. Сым зақымдалса, сервистік орталықта ауыстыру қажет.
7. Желіге қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында және қолданылмай тұрғанда құрылғыны әрдайым желіден ажыратыңыз.
8. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. 8 жастағы және одан үлкен балалар тек ересектердің бақылауымен қолдана алады.
9. Құрылғы ақаулы болса немесе дұрыс жұмыс істемесе, қолдануды дереу тоқтатыңыз. Жөндеу үшін сервистік орталыққа хабарласыңыз.
10. Стайлер құлаған болса немесе сыртқы зақымдары байқалса, қолданбаңыз.
11. Құрылғыны жануарларға, париктерге немесе синтетикалық материалдан жасалған шашқа қолданбаңыз.
12. Құрылғыны тек түпнұсқа аксессуарлармен қолданыңыз.

ЖИНАҚ ҚҰРАМЫ: (1) стайлер, (2) фен саптамасы, (3) брашинг-саптама, (4) бұйралауға арналған саптама,
5. шашты тегістеу саптамасы, 6) сақтау қабы, 7) шаш қыстырғыш (2 дана),
8. нұсқаулық.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

ҚОЗҒАЛТҚЫШ ЖЫЛДАМДЫҒЫ: минутына 105000 ± 5000 айналым

Жылдамдығы: секундына 13 литр

АУА АҒЫНЫНЫҢ ЖЫЛДАМДЫҒЫ:
Төмен жылдамдық: минутына 75000 ± 5000 айналым
• Орташа жылдамдық: минутына 85000 ± 5000 айналым
Жоғары жылдамдық - минутына 105000 ± 5000 айналым

ТЕМПЕРАТУРА РЕЖИМДЕРІ: • Жоғары температура - 95 °C ± 10 °C; орташа температура - 80 °C ± 10 °C; төмен температура - 60 °C ± 10 °C; суық ауа - 25 °C ± 10 °C



KINU - СЫМСЫЗ ШАШ ТҮЗЕТКІШ

Шашты түзетеді

Шашты сәндеп, пішін береді

Жұмсақ әсер

Үлпілдеуді бақылау

Шаштың сау жылтырын сақтайды

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ:

ҚОЛДАНУҒА ҚАТЫСТЫ: үйден тыс жерде шаш сәндеудегі қиындықтар, жоғары температура мен пластиналардың біркелкі қызбауынан шаштың зақымдалуы, құрғақтық пен сынғыштық қаупі, сымды құрылғылардың қолайсыздығы, әр шаш түріне сай температураны реттеу мүмкіндігінің болмауы, әртүрлі шаш үлгілерін жасаудың қиындығы, қызып кету қаупі, стандартты түзеткіштердің көлемді әрі ауыр болуы, тасымалдау мен сақтаудың қиындығы.

Шаш түріне қатысты: кеуекті, қатты, бұйра, толқынды, сәндеуге қиын, көнбейтін шаш.

МАТЕРИАЛДАРЫ: ABS пластигі, PC пластигі.

САЛМАҒЫ: 380 g (түзеткіш), 243 g (зарядтау станциясы).

ФУНКЦИЯЛАРЫ:

Шашты түзету: қызған пластиналар шаштың кератиндік байланыстарын жұмсартады. Бұрым пластиналардың арасына қысылып түзетіледі; байланыстар жаңа, түзу қалыпта суиды.

Шашты сәндеу: жылы пластиналар шашты қажетті бағытқа жатқызады. Жылу шашты икемдірек етеді, ал суығанда шаш құрылымындағы сутектік байланыстардың уақытша өзгеруі арқасында пішіні бекітіледі.

Шашты үлгілеу: бұйра, толқын немесе көлем қыздыру мен механикалық әсердің (айналдыру, тарту, бұрымды иілту) үйлесімі арқылы жасалады. Шаш қызған пластинаның немесе құрал қозғалысының пішінін қабылдап, суығаннан кейін бекітіледі.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:

1. Сымсыз.
2. Екі жолмен зарядталады: Type-C кабелімен және зарядтау базасы арқылы.
3. 4 температура режимі.
4. Шашқа жұмсақ әсер ететін керамикалық пластиналар.
5. Қыздыруды бақылау.
6. Қауіпсіз тасымалдауға арналған аккумуляторды құлыптау функциясы.
7. Соңғы баптауларды есте сақтау функциясы.
8. Көптеген аксессуарлары бар кеңейтілген жинақ.
9. Сандық дисплей.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ:
1. Құлыпты ашу: қолданар алдында құлып ауыстырғышын жоғары, «құлып ашық» күйіне жылжытыңыз. Ескерту: құлыптаулы құрылғыны қосу мүмкін емес.
2. Қосу: қуат батырмасын 2 секунд басып тұрыңыз. Құрылғының қосылғанын білдіретін динамикалық жарық жанады.
3. Өшіру: қуат батырмасын 2 секунд басып тұрыңыз.
4. Қауіпсіздік пен зарядты үнемдеу үшін 30 минут әрекетсіз тұрғаннан кейін құрылғы автоматты түрде өшеді.
5. Температураны «+» және «−» батырмаларымен реттеңіз. Төрт қыздыру деңгейі бар: 150, 180, 200 және 220 градус. Шашыңыздың түрі мен күйіне сай температураны таңдаңыз. Қыздыру кезінде таңдалған деңгей жыпылықтайды. Белгіленген температураға жеткенде индикатор жыпылықтауын тоқтатып, тұрақты жанады.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Шашыңыздың таза, құрғақ және мұқият таралғанына көз жеткізіңіз. Түзеткішті су немесе дымқыл шашқа қолдану ұсынылмайды.
2. Құрылғыны қосу: ауыстырғышты «Unlock» күйіне жылжытып, түзеткіштің құлпын ашыңыз. Динамикалық жарық жанғанша қуат батырмасын 2 секунд басып тұрыңыз.
3. Температураны таңдау
Тиісті температураны + / − батырмаларымен таңдаңыз:
Жұқа, зақымдалған немесе ағартылған шашқа - 150 градус
Қалыпты шашқа - 180-200 градус
Қалың, қатты немесе бұйра шашқа - 220 градус. Қыздыру кезінде температура индикаторы жыпылықтайды, ал белгіленген температураға жеткенде тұрақты жанады.
4. Шашты түзету
• Шашты шағын бұрымдарға бөліңіз.
Бұрымды керамикалық пластиналардың арасына салып, оларды жабыңыз.
• Түзеткішті түбірден ұшына қарай абайлап жылжытыңыз.
Шаш қызып кетпеуі үшін бір жерде 3 секундтан артық кідірмеңіз.
5. Шашты бұйралау
Шағын бұрымды керамикалық пластиналардың арасына қысыңыз.
• Бұрымды қажетті бағытқа бұйралау үшін түзеткішті өз осінен айналдырыңыз.
Бұрымды бұралған қалыпта бірнеше секунд ұстап, құрылғыны түбірден ұшына қарай баяу жылжытыңыз.
• Бұйраларды жасағаннан кейін бұрымдарды абайлап босатыңыз. Қажет болса, шаш үлгісін лакпен бекітіңіз.

6. Сәндеуді аяқтағаннан кейін құрылғыны өшіру үшін қуат батырмасын 2 секунд басып тұрыңыз. Қажет болса, қайта зарядтау үшін зарядтау базасына қойыңыз.

ЕСКЕРТУЛЕР:
1. Қолданар алдында пайдалану нұсқаулығын мұқият оқыңыз.
2. Электр тогы соқпауы үшін құрылғыны су немесе дымқыл шашқа және суға жақын жерде (мысалы, жуынатын бөлмеде немесе шұңғылша жанында) қолданбаңыз.
3. Жұмыс кезінде қызған керамикалық пластиналарға тимеңіз: күйіп қалуыңыз мүмкін.
4. Қосулы құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
5. Құрылғы зақымдалған болса немесе корпусында, сымында не зарядтау базасында көрінетін ақаулар болса, қолданбаңыз.
6. Құрылғы мен зарядтау құралын балалардан және үй жануарларынан алыс ұстаңыз.
7. Құрылғыны жанғыш материалдардың жанында қолданбаңыз.
8. Құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Барлық жөндеу жұмысын тек білікті маман орындауы тиіс.
9. Ақау пайда болса, құрылғыны қуат көзінен дереу ажыратыңыз.
10. Өндіруші ұсынған түпнұсқа аксессуарлар мен зарядтау құралдарын ғана қолданыңыз.
11. Зарядтау кезінде түйіспелер мен базаның іші таза әрі құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
12. Құрылғыны суға батырмаңыз және ағын сумен жумаңыз.
13. Қолданғаннан кейін және тазалау алдында құрылғыны өшіріңіз.

ЖИНАҚ ҚҰРАМЫ: 1) сымсыз шаш түзеткіш, 2) зарядтау базасы,
3. Туре-С зарядтау кабелі, (4) қорғаныш силикон қалпақша, (5) шаш резеңкесі,
6. тазалау майлығы, (7) ыстыққа төзімді төсеніш, 8) қыстырғыштар (2 дана), 9) нұсқаулық, 10) қаптар.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

Пластиналардың жабыны: керамика

ӨЛШЕМДЕРІ: 303×38×42 mm (түзеткіш), 105×105×159 mm (зарядтау станциясы)

ҚУАТЫ: 47 W

КЕРНЕУІ: 7,2 V

ТЕМПЕРАТУРА РЕЖИМДЕРІ: 150 °C, 180 °C, 200 °C, 220 °C

ЖҰМЫС УАҚЫТЫ (ТОЛЫҚ ЗАРЯДТАН КЕЙІН): 40 минут

ЗАРЯДТАУ УАҚЫТЫ: 1,5-2 h

ҚЫЗДЫРУ ПЛАСТИНАСЫНЫҢ ӨЛШЕМІ: 25×100 mm



KIO - ДЕНЕГЕ АРНАЛҒАН EMS МАССАЖЕРІ

Дене пішінін түзету

Терінің босаңсуы мен целлюлитке қарсы әсер етеді

Дене терісінің серпімділігі мен созылғыштығын сақтайды

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: артық салмақ (жергілікті май жиналуы), целлюлит, ісіну, салбыраған және босаңсыған тері, созылу іздері, қартаюдың көрінетін белгілері, пигментация.

МАТЕРИАЛЫ: ABS пластигі.

САЛМАҒЫ: Корпус - 128 g; EMS саптамасы бар корпус - 224 g; RF саптамасы бар корпус - 221 g.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
KIO дене массажерінің функциялары арнайы саптамаларға сәйкес бөлінген: EMS және RF&LED.

EMS, НЕМЕСЕ ЭЛЕКТРЛІК МИОСТИМУЛЯЦИЯ - белгілі сипаттамалары бар импульстік токпен бұлшықеттер мен жүйке ұштарын ынталандыру процедурасы. EMS ағзаның өз электр импульстерін қайталайды: олар электродтар арқылы жүйке және бұлшықет талшықтарына жетіп, жиырылуына ықпал етеді. Тері нығайып, серпімділігі артады. Электр тогының бұлшықет тініне әсері оны жиырылтып қана қоймай, жергілікті қан айналымы мен лимфа дренажын жақсартады. Бұл тіндердің қоректенуін күшейтіп, зат алмасу өнімдерін тез шығаруға: майларды ыдыратуға және ағзадан токсиндерді кетіруге көмектеседі. Бұл дене пішінін түзетудің және целлюлитпен күресудің негізгі қозғаушы күші болып саналады. EMS массажерін тұрақты қолдану қан мен лимфа айналымын жақсарту арқылы көктамыр бұзылыстарының алдын алып, ісінуді басады.

RF-ЛИФТИНГ - жоғары жиілікті токпен тіндердің терең қабаттарын қыздыру процедурасы. Электр импульсі эпидермисті айналып өтіп, дерма мен теріасты майының температурасын көтереді, бұл коллаген синтезіне әкеледі. Қан айналымы жақсарып, май жасушаларының зат алмасуы жеделдейді. Нәтижесінде терінің қасиеттері айтарлықтай жақсарады: серпімділігі, созылғыштығы мен тургоры артып, тері анық тартылады. Радиожиілікті импульстер май тінінің көлемін азайтуы мүмкін, бірақ RF-лифтингтің негізгі қызметі - теріні тарту.

Фототерапияда әр түс көрінетін жарық спектрінің белгілі толқын ұзындығына сәйкес келеді. Әртүрлі тереңдікке әсер еткен жарық тері рецепторларына сіңіп, жасуша ішіндегі табиғи процестер мен белгілі реакцияны іске қосады. Толқын ұзындығы ең үлкен қызыл LED жарығы (KIO құрылғысында 630 ± 20 nm) берілген жарық түрлерінен тереңірек енеді. Фибробласттарға әсер етіп, коллаген түзілуін және терінің қалпына келуін ынталандырады. Қызыл LED терапиясы терінің серпімділігі мен созылғыштығын арттырады, тартады, әжім мен пигментация сияқты сыртқы қартаю белгілерін азайтады.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:

1. Ықшам эргономикалық пішіні құрылғыны қолға ыңғайлы ұстауға мүмкіндік береді.
2. Массажер 3 тиімді технологияны біріктіреді: EMS, RF, LED.
3. Жинақта әр режимге арналған 2 арнайы магниттік саптама бар:
4 ірі шар тәрізді металл электроды бар EMS саптамасы және ұсақ шарлар мен сақиналар пішініндегі электродтары, сондай-ақ жарықдиодтары бар RF&LED саптамасы.
4. Үлкейтілген жұмыс беті дененің едәуір үлкен аймақтарына бірден әсер етуге мүмкіндік береді.
5. 1 батырмамен басқару: қосу/өшіру және қарқындылықты ауыстыру.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ:

1. Дене массажерінде 2 магниттік саптама бар: ірі шарлары бар саптама EMS режиміне, сақинасы мен ұсақ шарлары бар саптама RF&LED режиміне арналған. Саптаманы корпустағы ойыққа енгізіп орнатыңыз.
2. Саптаманы орнатқаннан кейін қосу/өшіру батырмасын 2 секунд басып тұрып, массажерді қосыңыз. Таңдалған саптамаға қарай EMS немесе RF&LED режимі іске қосылып, әсер қарқындылығының индикаторы жанады.
3. EMS және RF&LED режимдерінің әрқайсысында 3 қарқындылық деңгейі бар. Деңгейді ауыстыру үшін қарқындылық батырмасын қайта басыңыз. Күш артқан сайын жарық индикаторы біртіндеп толады. Ең жоғары деңгейге жеткеннен кейін қайта басқанда құрылғы автоматты түрде ең төмен деңгейге ауысады. Ескерту: RF&LED режимінде тек RF қарқындылығы өзгереді, LED тұрақты қалады.
4. Массажерде ақылды таймер бар: құрылғы 5 минут жұмыс істегеннен кейін өшеді.
5. Құрылғыны өшіру үшін қосу/өшіру батырмасын 2 секунд басып тұрыңыз.
6. Саптаманы алу үшін құрылғыны бір қолыңызбен ұстаңыз. Екінші қолыңызбен массаж басының бүйіріндегі «құлақшаларын» ұстап, саптаманы өзіңізге қарай күшпен тартып, корпустан шығарыңыз.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:

ЖАЛПЫ ҰСЫНЫМДАР:

1. Массажерді таза теріге қолданыңыз: денеден артық май мен барлық кірді кетіріңіз.
2. Массаж кезінде жанасу гелі немесе күтім құралы сіңіп кетсе, массажердің еркін сырғуын және әсердің тиімділігін қамтамасыз ету үшін қайта жағыңыз. Дененің басқа бөлігіне ауысқанда жұмыс істейтін аймақтың терісіне жанасу гелін жағыңыз

массаж алдында.
3. KIO массажерінде қозғалыс датчигі бар. Қолданғанда құрылғыны міндетті түрде тері бойымен жылжытыңыз. Бір жерде ұзақ уақыт қозғалтпай ұстасаңыз, ол жұмысын тоқтатады. Қозғалыс қайта басталғанда құрылғы қайта жұмыс істейді.
4. Бір аймақта ұзақ уақыт қайталама қозғалыстар жасамаңыз және массажерді бір жерде қозғалтпай ұстамаңыз. Ауырсыну шегі мен тері сезімталдығы әр адамда әртүрлі: құрылғыны бір аймақта қозғалтпай ұстау жеңіл күйікке әкелуі мүмкін. Қолдану кезінде бір жерде 2-3 секундтан артық кідірмеңіз.
5. Терінің сезімталдығы мен құрылғы әсерінің тиімділігі адамға және әсер ету аймағына қарай өзгеретін жеке ерекшеліктерге жатады.

EMS РЕЖИМІ:

1. Теріге ток өткізетін жанасу гелін немесе су негізіндегі гель тәрізді күтім құралын жағыңыз. Бұл ең жоғары нәтиже үшін токтың жақсы өтуін қамтамасыз етеді.
2. Қолданғыңыз келетін режимге сай саптаманы орнатыңыз.
3. Құрылғыны қосыңыз. Алғаш қолданғанда EMS қарқындылығының бастапқы деңгейін таңдаңыз.
4. Белге массаж жасау үшін құрылғыны бүйірлерге қойып, шеттен ортаға қарай 5 минут жылжытыңыз.
5. Аяққа массаж жасау үшін құрылғыны сан/балтыр бойымен жоғары қарай 5 минут жылжытыңыз.
6. Қолға массаж жасау үшін құрылғыны тоқпан жілік аймағында шынтақтан иық буынына қарай 5 минут жылжытыңыз.
7. Ішке массаж жасау үшін кіндік аймағын айналып өтіп, құрылғыны жоғары-төмен ирек бағытта 5 минут жылжытыңыз.
8. Массаж кезінде электрод бетінің теріге толық жанасуын қамтамасыз ету үшін жеткілікті қысым жасаңыз.
9. Процедурадан кейін құрылғыны өшіріп, саптаманы алып тазалаңыз. Жанасу гелін немесе күтім құралын теріде толық сіңгенше қалдырып, содан кейін теріні тазалаңыз.

RF РЕЖИМІ:

1. Теріге ток өткізетін жанасу гелін немесе су негізіндегі гель тәрізді күтім құралын жағыңыз. Бұл ең жоғары нәтиже үшін токтың жақсы өтуін қамтамасыз етеді.
2. Қолданғыңыз келетін режимге сай саптаманы орнатыңыз.
3. Құрылғыны қосыңыз. Алғаш қолданғанда RF&LED қарқындылығының бастапқы деңгейін таңдаңыз.
4. Әсер ету аймағын таңдап, төмендегі массаж қозғалыстарын орындаңыз. RF функциясы коллаген жаңаруын және теріасты майының зат алмасуын ынталандыру үшін теріні қыздыруға негізделген. Жылу жеткіліксіз сезілсе, сырғу жылдамдығын азайтыңыз; керісінше тым ыстық болса, температура жайлы сезілгенше қозғалысты жылдамдатыңыз.
5. Терінің құрылымы бағытында сырғытып, 5 минут жылжытыңыз.
6. Көлденең бағытта 5 минут сырғытыңыз.
7. Сағат тілімен айналмалы қозғалыстарды 5 минут жасаңыз.
8. Сағат тіліне қарсы айналмалы қозғалыстарды 5 минут қайталаңыз.

9. Процедурадан кейін құрылғыны өшіріп, саптаманы алып тазалаңыз. Жанасу гелін немесе күтім құралын теріде толық сіңгенше қалдырып, содан кейін теріні тазалаңыз.

ТЕРІ ТҮРІ / МӘСЕЛЕ	ТӘУЛІК УАҚЫТЫ	ҰЗАҚТЫҒЫ МЕН РЕТІ	ЖИІЛІГІ	ПРОЦЕДУРАЛАР КУРСЫ
ІСІНУ / ЛИМФА АҒЫНЫНЫҢ НАШАРЛАУЫ / БҰЛШЫҚЕТ ӘЛСІЗДІГІ	Таңертең	EMS: іш пен бел - 10-15 минут; сан мен бөксе - 15-20 минут. Жалпы сеанс: 40 минутқа дейін. Ең төмен қарқындылықтан бастап, жайлылық пен тері күйіне қарай біртіндеп арттырыңыз. Бұлшықет жиырылуы сезілуі тиіс, бірақ ауыртпауы керек.	Бастапқы курс: 6-8 апта бойы аптасына 3-4 рет. Қолдау режимі: аптасына 1-2 рет.	Бастапқы курс: 6-8 апта. Содан кейін терінің қалпына келуіне және тұрақты ынталандыруға үйреніп кетпеуіне мүмкіндік беру үшін 1-2 ай үзіліс жасаңыз. Қолдау режимі: тұрақты түрде.
ТЕРІНІ ТАРТУ / СОЗЫЛУ ІЗДЕРІН ТЕГІСТЕУ	Кешке	RF және LED: іш пен бел - 10-15 минут; сан мен бөксе - 15-20 минут. Жалпы сеанс: 40 минутқа дейін. RF қарқындылығын жайлылық шегінде арттырыңыз. Тері жылуды сезінуі тиіс, бірақ қызып кетпеуі керек.	Бастапқы курс: 6-8 апта бойы аптасына 2-3 рет. Қолдау режимі: аптасына бір рет; әр 10-14 күнде бір рет қолдануға да болады.	
КЕШЕНДІ ПРОЦЕДУРА	Таңертең EMS, кешке RF және LED немесе түстен кейін кешенді сеанс	EMS + RF және LED. Іш пен бел: EMS 10-15 минут, RF және LED 10-15 минут. Сан: әр аяққа EMS 10-15 минут, RF және LED 15-20 минут. Бөксе: EMS 15 минут, RF және LED 15 минут. Кешенді сеанста әр аймаққа әртүрлі режим қолданыңыз: сан мен бөксеге EMS, іш пен белге RF және LED.	EMS: аптасына 3 рет. RF және LED: аптасына екі рет.	

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:

1. Құрылғыны қолдануға тыйым салынады:
• аритмиясы немесе басқа жүрек аурулары бар, кардиостимулятор орнатылған адамдарға;
• құрылғы қолданылатын аймақта тұрақты металл имплланттары немесе пирсингі бар адамдарға;
• аллергиясы бар, сондай-ақ диабет, қызыл жегі, порфирия, іркілісті жүрек ауруы, қан ұюының бұзылыстары немесе аутоиммундық аурулары (мысалы, АИТВ немесе ЖИТС) бар адамдарға;
• терісінде анықталмаған зақымдар бар адамдарға;
• сәулелік терапия немесе химиотерапия алып жүрген адамдарға. Құрылғы семіздіктен немесе жүктіліктен болған созылу іздеріне қолдануға жарайды. Бірақ тыртықтарды емдеуге қолданылмайды;
• терісі қазір немесе жақында альфа-гидроксиқышқылдармен (AHA), бета-гидроксиқышқылдармен (BHA), жергілікті изотретиноинмен немесе азелаин қышқылымен өңделген адамдарға;
• соңғы 6 айда Roaccutane препаратының кез келген түрін қабылдаған адамдарға;
• фотосезімталдықты арттыратын немесе дәрігер тағайындаған басқа дәрілерді қабылдайтын адамдарға. Массажерді қолданар алдында дәрі нұсқаулығын оқыңыз. Егер дәрі фотоаллергиялық немесе фотоуытты реакция туғызуы мүмкін деп көрсетілсе немесе күн сәулесінен сақтану ұсынылса, бұл құрылғыны қолданбаңыз;
• антикоагулянттарды, соның ішінде жоғары дозалы аспиринді қабылдайтын адамдарға. Массажерді ем аяқталғаннан кейін тек бір апта өткен соң қолдану ұсынылады.
2. Құрылғыны бетке, мойынға, кеудеге, жыныс мүшелерінің аймағына және соңғы 3 айда пластикалық операция жасалған дене аймақтарына қолданбаңыз.
3. Теріңіз жарыққа сезімтал, бөртпе мен аллергиялық реакцияларға бейім болса, LED терапия режимін қолданбаңыз.
4. Массажер қолданылатын аймақта инфекция, экзема, күйік, шаш фолликулдарының қабынуы, ашық жара, көгеру, қарапайым герпес, тері зақымдары немесе гематома болса, LED терапиясын қолданбаңыз.
5. Массажердің жарығын көзге бағыттамаңыз және жарық көзіне қарамаңыз.
6. Құрылғыны бөлшектеуге, жөндеуге немесе өзгертуге тырыспаңыз. Осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа мақсатта қолданбаңыз.

ЕСКЕРТУЛЕР:

1. Балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз.
2. Құрылғыны осы ұсынымдарға сай ұқыпты қолданыңыз. Нұсқауларды сақтамау жағымсыз салдарға әкелуі мүмкін.
3. Құрылғыны жанғыш косметикамен қолданбаңыз.
4. Құрылғыны көз айналасына қолданбаңыз.
5. Қолданар алдында зақымдарын тексеріңіз. Массажер дұрыс жұмыс істемесе, сынған немесе зақымдалған болса, қолданбаңыз.
6. Алғаш қолданудан 24 сағат бұрын сезімталдық сынағын жасаңыз. Күтім құралы да, массажер де тері реакциясын туғызбайтынына көз жеткізу үшін білектің ішкі жағына аз мөлшерде жанасу гелін жағыңыз.

7. USB-C зарядтау кабелі мен зарядтау ұясын құрғақ ұстаңыз. Құрылғыны зарядтау кезінде қолданбаңыз.
8. Жанасу гелін немесе күтім құралын таңдағанда сақ болыңыз: косметика құрамындағы майлар мен қышқылдар құрылғы жабынын зақымдауы мүмкін.
9. Қолданар алдында дәрігермен кеңесіңіз. Жайсыздық немесе жағымсыз реакция сезілсе, сондай-ақ аллергия, тері ауруы, дерматит және т.б. болғанда қолдануды тоқтатыңыз.

ЖИНАҚ ҚҰРАМЫ: (1) құрылғы корпусы, (2) EMS саптамасы, (3) RF&LED саптамасы, 4. зарядтау кабелі, 5) сақтау қабы, 6) нұсқаулық.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

ЗАРЯДТАУ УАҚЫТЫ: 3 h

ЖҰМЫС УАҚЫТЫ: 60 min

АҚЫЛДЫ ТАЙМЕР: 5 min

ТОК КҮШІ: RF+LED: • 1-деңгей: 975 ± 50 mA; • 2-деңгей: 990 ± 50 mA; • 3-деңгей: 1005 ± 50 mA. EMS: • 1-деңгей: 30 ± 10 mA; • 2-деңгей: 41 ± 10 mA; • 3-деңгей: 52 ± 10 mA. ЖИІЛІГІ: • RF режимі: 2 MHz ± 0.2 MHz; • EMS режимі (ауыспалы жиілік циклі): 78.5 Hz ± 10%, 18.5 Hz ± 10%.

ТОЛҚЫН ПІШІНІ: тікбұрышты толқын

СУДАН ҚОРҒАНЫСЫ: IPX6



LED HAND MASK - ҚОЛҒА АРНАЛҒАН ФОТОТЕРАПИЯ МАСКАСЫ

4 жарық спектрі

Әжімдерді тегістейді

Пигментацияны азайтады

Тері майлылығын теңестіреді

Серпімділікті жақсартады

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: қол терісінің жасқа байланысты өзгерістері, серпімділігін жоғалтуы мен босаңсуы, жасқа байланысты пигментация, мәселелі тері (безеу, қабыну).

МАТЕРИАЛДАРЫ: силикон, ABS пластигі.

САЛМАҒЫ: 326 g.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:

Фототерапия (LED) - терінің белгілі бір тереңдігіне еніп, жасушаларға сіңетін әртүрлі ұзындықтағы жарық толқындарымен әсер ету әдісі. Ол табиғи жаңару процестерін іске қосады.

Қызыл LED жарығы (630 nm) жасушалық зат алмасуды ынталандырады, терең қалпына келуге көмектеседі, құрылымды жақсартып, пигменттік дақтарды ағартады.

Көк LED жарығы (415 nm) майлы терінің теңгерімін қалыпқа келтіреді, жұмсақ тазартады және тыныштандырады.

Жақын инфрақызыл (NIR) (830 nm) тіндердің терең қабаттарына енеді, жасушалардың жаңаруын жеделдетеді, серпімділікті арттырып, қол терісін тартады.

Аралас (қызыл + көк) (630 + 415 nm) екі спектрдің күшін біріктіріп, қуатты жасартатын, тазартатын және қалпына келтіретін әсер береді.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:
1. Автоматты және қолмен басқару: түстер өздігінен ауысатын дайын 15 минуттық автоматты циклді немесе бір жарық түрімен әсер ететін 1 қолмен басқару режимін 10 минутқа таңдауға болады.
2. Ақылды таймер: сеанстан кейін құрылғы автоматты түрде өшеді (автоматты режимде 15 минут, қолмен басқаруда 10 минут), бұл қауіпсіз қолдануды қамтамасыз етеді.
3. 106 LED: қол басының, білек пен білезіктің бүкіл бетіне қуатты әрі біркелкі әсер етеді.
4. Эргономика және қауіпсіздік: маска тағамдық силиконнан жасалған және жабысқақ бекіткіші бар ыңғайлы баулармен қолға оңай бекітіледі.
5. Сымсыз басқару: сыйымдылығы 1500 mAh аккумулятор розеткаға қосылмай 40 минутқа дейін үздіксіз күтім жасауға мүмкіндік береді.
6. Жақын инфрақызыл (NIR) спектр кәдімгі косметика мен стандартты фототерапия жете алмайтын дерманың ең терең қабаттарында жасару процестерін іске қосуға мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ:
1. Маскаға бекіту бауларын орнатыңыз: оң және сол бауды масканың бүйіріндегі тиісті тесіктерге енгізіп, жабысқақ бекіткішпен бекітіңіз.
2. Масканы қолыңызға киіп, сол бауды оң баудың үстіне бекітіңіз.
3. Пульттегі қосу/өшіру батырмасын қысқа басыңыз. Маска автоматты түрде қолмен басқару режимінде қызыл LED жарығымен қосылады.
4. Режим ауыстыру батырмасымен (AUTO/MANUAL) қажетті режимді таңдаңыз: автоматты немесе қолмен басқару. Таңдалған режимнің жанында A немесе M жарықдиоды жанады.
5. Қолмен басқару режимі (M): қуат батырмасын қысқа басып, қажетті жарықты таңдаңыз (1 - қызыл, 2 - көк, 3 - жақын инфрақызыл, 4 - аралас). Ақылды таймер 10 минутқа орнатылған.
6. Автоматты режим (A): режимдер өздігінен ауысады: қызыл - 5 минут, көк - 4 минут, жақын инфрақызыл - 3 минут, аралас - 3 минут. Сеанстың жалпы уақыты - 15 минут.
7. Құрылғыны мәжбүрлеп өшіру үшін қуат батырмасын басып тұрыңыз.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Сезімталдық сынағы. Маңызды: алғашқы процедура алдында сезімталдық сынағын жасау қажет. Құрылғыны білектің ішкі жағына орналастырыңыз. Масканы қосып, кемінде 10 минуттық сеанс өткізіңіз. Ыстық немесе жайсыздық сезілсе, қолдануды дереу тоқтатыңыз. Сынақтан кейін кемінде 6 сағат күтіңіз. Тері қызарса және/немесе қышыса, құрылғы сізге жарамайды.
2. Сезімталдық сынағынан кейін қол терісін тазалаңыз, күтім құралдарын жақпаңыз.
3. Масканы қолыңызға киіп, бауларын бекітіңіз.
4. Қажетті режимді (автоматты немесе қолмен басқару) таңдап, процедураны өткізіңіз.
5. Таймер белгілеген қолдану уақытынан асыру ұсынылмайды.
6. Нәтижені бекіту үшін сеанстан кейін күтім және ылғалдандыру құралдарын жағу ұсынылады.

ҚОЛДАНУ ЖИІЛІГІ МЕН ҰЗАҚТЫҒЫ:
Көрінетін нәтижеге жету үшін LED HAND MASK маскасын кемінде 4 апта қолдану ұсынылады. 1-апта: әр 3 күн сайын 10-15 минут. 2 және 3-апталар: әр 2 күн сайын 10-15 минут. 4-апта: күн сайын 10-15 минут.

«Терең жасарту және лифтинг» хаттамасы

РЕЖИМ	КЕЗЕҢ	УАҚЫТ	ЖАРЫҚ	НЕГІЗДЕМЕ
ҚОЛМЕН БАСҚАРУ	1-сеанс	10 min	Жақын инфрақызыл (NIR)	Тіндерді терең жылытады, жасушалық метаболизмді жылдамдатады және дерманы жаңартуға дайындайды.
	2-сеанс	10 min	Қызыл LED жарығы.	Коллаген түзілуін қуатты ынталандырады

Әрі қарай сеанстарды LED HAND MASK қолдану жиілігі мен ұзақтығына сай кезектестіріңіз.

Детокс және бактерияға қарсы күтім хаттамасы

РЕЖИМ	КЕЗЕҢ	УАҚЫТ	ЖАРЫҚ	НЕГІЗДЕМЕ
ҚОЛМЕН БАСҚАРУ	1-сеанс	10 min	Көк LED жарығы.	Бактериялық ортаны жояды, майлылықты қалыпқа келтіріп, тітіркенген аймақтарды тыныштандырады
	2-сеанс	10 min	Аралас жарық	Коллаген түзілуін қуатты ынталандырады

Әрі қарай сеанстарды LED HAND MASK қолдану жиілігі мен ұзақтығына сай кезектестіріңіз.

«Әмбебап жасарту» хаттамасы. Артық баптаусыз автоматты режимді қолданыңыз: ол теріні коллаген өндіруден терең инфрақызыл ынталандыруға дейінгі барлық кезеңнен өзі өткізеді.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Жарыққа жоғары сезімталдық: жарыққа аса сезімталдық туғызатын аурулар (мысалы, қызыл жегі, фотодерматоз) кезінде құрылғыны қолдануға тыйым салынады.
2. Дәрілер мен косметика: фотосезімталдықты арттыратын дәрілерді қабылдасаңыз немесе құралдарды (ретиноидтар, кейбір антибиотиктер, цитрус эфир майлары) жақсаңыз, масканы қолданбаңыз.
3. Тері зақымдары: ашық жара, ойық жара, терең жарық, жаңа операция тігістері немесе қатты қабыну белгілері бар аймақтарға масканы қолданбаңыз.
4. Жүктілік және бала емізу: осы кезеңдерде масканы міндетті түрде дәрігермен кеңескеннен кейін ғана қолдануға болады.
5. Процедураны көтере алмау: білекке жасалатын міндетті алдын ала сынақтан кейін тері қызарса немесе қыши бастаса, құрылғы сізге жарамайды.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ:
1. Міндетті сынақ: алғашқы қолдану алдында әрдайым білектің ішкі жағында сезімталдық сынағын жасаңыз.
2. Жағдайдың нашарлауы: сеанс кезінде ыстық, жайсыздық немесе жалпы жағдайдың нашарлауын сезсеңіз, қолдануды дереу тоқтатыңыз.
3. Көруді қорғау: құрылғы жұмыс істеп тұрғанда жанып тұрған LED-терге тікелей қарамаңыз.
4. Электр қауіпсіздігі: масканы зарядтау кезінде қолдануға қатаң тыйым салынады. Процедура алдында қуат кабелін міндетті түрде ажыратыңыз.
5. Ылғалдан қорғау: құрылғы судан қорғалмаған. Оны жуынатын бөлмеде немесе су жанында қолдануға, дымқыл қолмен ұстауға, суға батыруға немесе ағын сумен жууға тыйым салынады.
6. Ұқыпты ұстау: масканы тым қатты бүкпеңіз, қыспаңыз, үстіне ауыр зат қоймаңыз. Бұл ішкі иілгіш микросхемалар мен LED-терді зақымдауы мүмкін.
7. Температура: масканы жылытқыш, ашық от жанында, тікелей күн астында немесе ыстық күнде көлік ішінде қолданбаңыз және сақтамаңыз.
8. Тазалау: масканы толық өшіріп, электр желісінен ажыратқаннан кейін ғана тазалауға болады.
9. Жөндеу және өзгерту: зақымдалған масканы қолдануға, құрылғыны өзіңіз бөлшектеуге немесе өзгертуге тыйым салынады. Бұл электр тогының соғуына және кепілдіктің жойылуына әкеледі.

10. Мақсаты: масканы тек мақсаты бойынша және нұсқаулыққа сәйкес қолданыңыз.

ЖИНАҚ ҚҰРАМЫ: (1) маска, (2) бекіту баулары, (3) Dual Type-C зарядтау кабелі,
4. пайдалану нұсқаулығы, (5) сақтау қаптары.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:
ӨЛШЕМІ (Б × Е × Т): 385×185×52 mm. ҚУАТ КӨЗІ: литий-ионды аккумулятор. ЖҰМЫС КЕРНЕУІ: 3.7 V. ҚУАТЫ: 5 W. АККУМУЛЯТОР СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ: 1500 mAh. ҚОРЕК КЕРНЕУІ: 5 V. АҚЫЛДЫ ТАЙМЕР: 15 минут (автоматты режим), 10 минут (қолмен басқару режимі). ЗАРЯДТАУ УАҚЫТЫ: 1.5 сағат. ЕҢ ҰЗАҚ ҮЗДІКСІЗ ЖҰМЫС УАҚЫТЫ: 40 минут. LED САНЫ: 106 шам.
ТОЛҚЫН ҰЗЫНДЫҒЫ:
• Қызыл - 630 nm
• Көк - 415 nm
Жақын инфрақызыл (NIR) - 830 nm
• Аралас (қызыл + көк) - 630 + 415 nm
СӘУЛЕЛЕНУ ҚАРҚЫНДЫЛЫҒЫ:
• Қызыл - 4.9 mW/cm2
• Көк - 28 mW/cm2
Жақын инфрақызыл (NIR) - 10.1 mW/cm2
• Аралас (қызыл + көк) - 15 mW/cm2



LED MASK - ҮЙДЕГІ ФОТОТЕРАПИЯҒА АРНАЛҒАН МАСКА

Пигментацияны азайтады

Бет реңін жақсартады

Тері серпімділігін жақсартады

Әжімдерді тегістейді

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: терінің қартаю белгілері, фотоқартаю, пигментация мен гиперпигментация, безеу, безеуден кейінгі іздер, купероз, розацеа және басқа тамырлық зақымдар.

МАТЕРИАЛДАРЫ: ABS пластигі, силикон.

САЛМАҒЫ: 215 g.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:

Қызыл LED жарығы - бұл жарық көрінетін спектрдің басқа түстеріне қарағанда теріге тереңірек енеді. Ол фибробласттарға (коллагенді синтездейтін жасушалар) әсер етеді, осылайша терінің жасаруына және қартаю белгілерімен күресуге ықпал етеді.

Көк LED жарығы ең төменгі ену тереңдігіне ие және эпидермис деңгейінде жұмыс істейді. Порфириндер (адам ағзасындағы пигменттер) көгілдір LED жарығын сіңіріп, синглетті оттегі молекулаларын босатып, тері бетінде тұратын безеу бактерияларын өлтіреді. Осылайша көк LED жарығы дезинфекциялайды, қабыну түзілімдерін азайтады, безеумен күреседі.

Сары LED жарығы - коллаген өндірісін ынталандыру үшін теріге жеткілікті терең енеді, соның арқасында ол әжімдерді тегістейді. Сары LED жарығының жасушалық процестерге әсерінен лимфа тамырлары белсендіріледі, дренаж және лимфа ағыны жақсарады. Осылайша, ісіну азаяды, токсиндер денеден шығарылады. Сонымен қатар, сары LED жарығы теріге тыныштандыратын және қабынуға қарсы әсерге ие.

Аралас жарық - қызыл және көк түстердің комбинациясы олардың функционалдығын біріктіруге мүмкіндік береді, сондықтан аралас жарық қабынумен жұмыс істегенде ең тиімді болып саналады: безеу және кейінгі безеу. Көгілдір LED жарығы үстірт енуіне байланысты терінің жоғарғы сыртқы қабатымен - эпидермиспен байланысты тері ауруларымен күреседі. Екінші жағынан, қызыл LED жарығы тері ауруларына қарсы күресте жоғары тиімділік беретін майдың өндірілуіне айтарлықтай әсер етеді.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:
1. Маска реттелетін бекіту бауларымен жабдықталған.
2. Кірістірілген көз қорғаныштары жарықтың көзге тікелей түсуінен қорғайды.

3. Тағамдық силиконнан жасалған масканы қолдану қауіпсіз.
4. Ықшам пульт масканы алып жүріп қолдануға мүмкіндік береді.
5. Автоматты және қолмен басқару режимдері.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ:
1. Масканы алғаш қолданар алдында нұсқаулыққа сәйкес «Сезімталдық сынағын» жасаңыз.
2. Масканы қосу үшін қашықтан басқару пультіндегі қосу/өшіру түймесін 1 секунд басып тұрыңыз. Қосқаннан кейін қызыл LED жарығы функциясы және қолмен басқару режимі іске қосылады. Ауыстыру түймешігінің жанында M әрпі бар индикатор жанады (Қолмен - қолмен басқару режимі).
3. Масканы зарядтау қажет болса, нұсқаулықтағы зарядтау бөлімін оқыңыз. Маска зарядтау кезінде жұмыс істемейтінін ескеріңіз.
4. Қосу/өшіру түймесін қайтадан басыңыз, маска көк LED жарығы режиміне ауысады.
5. Қосу/өшіру түймесін үшінші рет басыңыз, сары LED жарығы режимі басталады.
6. Қуат батырмасын төртінші рет басқанда аралас фототерапия режимі іске қосылады.
7. Автоматты режимге (Auto - жарықты автоматты ауыстыру режимі) ауысу үшін ауыстыру батырмасын басыңыз.
8. Автоматты режимде қызыл LED жарығы 5 минут, көк LED жарығы 3 минут, сары LED жарығы 4 минут, содан кейін аралас жарық 3 минут жұмыс істейді.
9. Масканы өшіру үшін қосу/өшіру батырмасын басыңыз.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Масканы қолданар алдында теріні тазалаңыз.
2. Масканы киіп, көз қорғаныштарының көзге тығыз жанасқанына көз жеткізіңіз.
3. Қалауыңыз бойынша қолмен немесе автоматты басқару режимін орнатыңыз.
4. Қолмен басқару режимінде қажетті LED терапия түсін таңдаңыз.
5. Қолмен басқару кезінде режимді ауыстырғанда 10 минуттық ақылды таймер қайта басталатынын ескеріңіз. Алайда масканы 15 минуттан артық қолданбау қатаң ұсынылады.
6. Үйдегі фототерапия процедурасынан ләззат алыңыз.

ҚОЛДАНУ ЖИІЛІГІ МЕН ҰЗАҚТЫҒЫ:

ТЕРІ ТҮРІ / МӘСЕЛЕ	ТӘУЛІК УАҚЫТЫ	ҰЗАҚТЫҒЫ МЕН РЕТІ	ЖИІЛІГІ	ПРОЦЕДУРАЛАР КУРСЫ
БЕЗЕУ / ҚАБЫНУ	Кешке	Көк LED жарығы: 7 мин. Қызыл LED жарығы: 3 мин. Сары LED жарығы: 5 мин.	Күнара	Тұрақты түрде
ҰСАҚ ӘЖІМДЕР / ЖАСҚА БАЙЛАНЫСТЫ ӨЗГЕРІСТЕР	Кешке	Көк LED жарығы: 2 мин. Қызыл LED жарығы: 7 мин. Аралас жарық: 5 мин.	Аптасына 2-3 рет	Тұрақты түрде
КӨРІНЕТІН ТАМЫРЛАР / КУПЕРОЗ / СЕЗІМТАЛ ТЕРІ	Кешке	Көк LED жарығы: 2 мин. Қызыл LED жарығы: 2 мин. Сары LED жарығы: 2 мин. Аралас жарық: 5 мин.	Аптасына 2-3 рет	Тұрақты түрде

ТЕРІ ТҮРІ / МӘСЕЛЕ	ТӘУЛІК УАҚЫТЫ	ҰЗАҚТЫҒЫ МЕН РЕТІ	ЖИІЛІГІ	ПРОЦЕДУРАЛАР КУРСЫ
ПИГМЕНТАЦИЯ / БІРКЕЛКІ ЕМЕС ТЕРІ РЕҢІ	Кешке	Қызыл LED жарығы: 6 мин. Сары LED жарығы: 4 мин. Аралас жарық: 5 мин.	Аптасына 2-3 рет	Тұрақты түрде

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Жайсыздық немесе кез келген жанама әсер пайда болса, қолдануды тоқтатыңыз.

ЕСКЕРТУЛЕР:
1. Құрылғы тек үйде қолдануға арналған.
2. Масканы зарядтау кезінде қолданбаңыз.
3. Құрылғы бетіне немесе корпусының ішіне су тигізбеңіз.
4. Құрылғыны ашық жылу көзінің жанында қолданбаңыз.
5. Құрылғыны тазалау және техникалық қызмет көрсету кезінде қуатты өшіріңіз.

ЖИНАҚ ҚҰРАМЫ: (1) бет маскасы, (2) басқару пульті, (3) DC-USB зарядтау сымы,
4. бекіту баулары, (5) көз қорғаныштары, (6) нұсқаулық.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

ЗАРЯДТАУ УАҚЫТЫ: 3-4 h

ЖҰМЫС УАҚЫТЫ: 40-45 min

АҚЫЛДЫ ТАЙМЕР: 15 минут (автоматты режим), 10 минут (қолмен басқару режимі)

РЕЖИМДЕР:
• Қызыл LED жарығы - толқын ұзындығы 630 нм
• Көк LED жарығы - толқын ұзындығы 490 нм
• Сары LED жарығы - толқын ұзындығы 590 нм
• Аралас жарық

МЕНШІКТІ ҚУАТЫ (СӘУЛЕЛЕНУ ҚАРҚЫНДЫЛЫҒЫ):
• Қызыл LED жарығы - 2.4041 mW/cm2
• Көк LED жарығы - 8.6094 mW/cm2
Сары LED жарығы - 1.2704 mW/cm2
• Аралас жарық - 7.4833 mW/cm2

15 МИНУТТЫҚ СЕАНСТАҒЫ ЭНЕРГИЯ ДОЗАСЫ (ЭНЕРГИЯ СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ):
• Қызыл LED жарығы - 2.1637 J/cm2
• Көк LED жарығы - 7.7485 J/cm2
• Сары LED жарығы - 1.1434 J/cm2
• Аралас жарық - 6.7350 J/cm2

СУДАН ҚОРҒАНЫСЫ: IP22



LED MASK 2.0 - ЖАСАРТАТЫН ФОТОТЕРАПИЯ МАСКАСЫ

Пигментацияны азайтады

Бет реңін жақсартады

Тері серпімділігін жақсартады

Әжімдерді тегістейді

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: терінің қартаю белгілері, фотоқартаю, пигментация мен гиперпигментация, безеу, безеуден кейінгі іздер, купероз, розацеа және басқа тамырлық зақымдар.

МАТЕРИАЛДАРЫ: силикон, ABS пластигі.

САЛМАҒЫ: 380 g.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
LED MASK жарықдиодты терапия қағидасымен жұмыс істейді. Маскаға LED шамдары орнатылған; әрқайсысы белгілі бір түсті жарық шығаруға бағдарламаланған. Әр түс көрінетін жарық спектріндегі белгілі бір толқын ұзындығына сәйкес келеді. Жарық терінің әртүрлі тереңдігіне әсер етіп, рецепторларға сіңеді, жасуша ішіндегі табиғи процестерді белсендіріп, терінің белгілі реакциясын туғызады.

Ең үлкен толқын ұзындығына ие қызыл LED жарығы барлық ұсынылған шамдарға қарағанда теріге тереңірек енеді. Ол коллаген өндірісін ынталандыратын фибробласттарға әсер етеді және сол арқылы терінің қалпына келуін қамтамасыз етеді. Қызыл LED жарығымен терапия нәтижесінде жараның жазылуы жеделдетіледі, тері тартылады, әжімдер сияқты терінің қартаюының сыртқы белгілері азаяды.

Көк LED жарығы көрінетін спектрдің барлық түстерінің ішіндегі ең қысқа толқын ұзындығына ие. Микробқа қарсы әсері бар эпидермис деңгейінде жұмыс істейді. Порфириндер (біздің денеміздегі пигменттер) көк LED жарығын сіңіріп, синглетті оттегі молекулаларын босатып, тері бетінде тұратын безеу бактерияларын өлтіреді. Осылайша көк LED жарығы дезинфекциялайды, қабыну түзілімдерін азайтады, безеумен күреседі.

Жасыл LED жарығы эпидермис пен дермиске сіңіп, жасушалық реакцияны тудырады, оның салдары арасында теріні қалпына келтіру және емдеу бар. Ол қызаруды азайту, сезімтал терінің тітіркенуін жеңілдету үшін қолданылады. Жасыл LED жарығы капиллярлардың мөлшерін азайтып, қанның еркін ағымына ықпал ететін куперозбен күреседі.

Сары LED жарығы (қызыл + жасыл) қан айналымын ынталандыру үшін қолданылады, тері өңін ағартуға, пигментацияның ауырлығын азайтуға көмектеседі.

Аралас жарық (қызыл + көк + жасыл = ақ) косметиканың жылдам әрі терең сіңуіне қолданылады. Сондай-ақ ағзаға жалпы босаңсытатын және тыныштандыратын әсер береді.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:
1. Баусыз кірістірілген бекіткіш.
2. LCD дисплейі бар басқару пульті.
3. LED саны көбейтілген - 117 дана.
4. Әр жарық режимі үшін 3 қарқындылық деңгейі, жоғары энергия сыйымдылығы.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ:
1. Масканы алғаш қолданар алдында нұсқаулыққа сәйкес «Сезімталдық сынағын» жасаңыз.
2. Масканы Type C кабелі арқылы басқару пультіне шертілгенше жалғаңыз.
3. Құрылғыны қосу үшін басқару панеліндегі қосу/өшіру түймесін 2 секунд басып тұрыңыз, дыбыстық сигналды күтіңіз. Маска бірінші қарқындылық деңгейінде қызыл LED жарығы режимінде автоматты түрде қосылады.
4. Ауыстыру түймелерін (↑/↓) қысқа басу (1 секунд) көк LED жарығы режиміне (басқару тақтасындағы индикатор C: B), жасыл LED жарығы режиміне (индикатор C: G), сары LED жарығы режиміне (индикатор C: RG), ақ жарық режиміне (C индикаторы: RGB) ауысуға мүмкіндік береді.
5. Жарық қарқындылығын реттеу батырмаларын (-/+) қысқа басу (1 секунд) деңгейді 3-ке дейін арттырады немесе 1-деңгейге қайтарады.
6. Үзіліс батырмасын қысқа басу (1 секунд) құрылғыны уақытша тоқтатады; қайта басу жұмысын жалғастырады.
7. Құрылғыны өшіру үшін пульттегі қосу/өшіру батырмасын 2 секунд басып тұрыңыз.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Қол мен бетті тазалап, құрғатыңыз.
2. Масканы бетке киіп, ыңғайлы тұратындай жабысқақ бекіткіштерін бекітіңіз.
3. Басқару пультін жалғап, масканы қосыңыз.
4. Қажетті жарық режимі мен қарқындылығын таңдаңыз.
5. Фототерапия процедурасынан ләззат алыңыз.
6. Әр жарық режимі 15 минут жұмыс істейді, содан кейін пульт автоматты түрде өшеді. Режимді ауыстырғанда таймер қайта басталады. Фототерапия кезінде бір сеанста бірнеше режим қолдансаңыз, жалпы процедура уақыты 15 минуттан аспауын мұқият бақылаңыз.
7. LED терапиясынан кейін күтім құралын - сарысу немесе крем қолданыңыз: LED маскадан кейін терінің сіңіру қабілеті артады.

ҚОЛДАНУ ЖИІЛІГІ МЕН ҰЗАҚТЫҒЫ:

ТЕРІ ТҮРІ / МӘСЕЛЕ	ТӘУЛІК УАҚЫТЫ	ҰЗАҚТЫҒЫ МЕН РЕТІ	ЖИІЛІГІ	ПРОЦЕДУРАЛАР КУРСЫ
БЕЗЕУ / ҚАБЫНУ	Кешке	1-апта: көк, төмен - 4 минут; қызыл, төмен - 3 минут; жасыл, орташа - 6 минут. 2-апта: көк, орташа - 4 минут; қызыл, төмен - 4 минут; жасыл, орташа - 6 минут. 3-апта: көк, жоғары - 5 минут; қызыл, жоғары - 3 минут; жасыл, жоғары - 6 минут. 4-апта: үзіліс.	Күнара	Үзілісті қосқанда 1 ай. 1 апта үзіліс жасаңыз. Бағдарламаны 2-3 ай бойы қайталаңыз.
ҰСАҚ ӘЖІМДЕР / ЖАСҚА БАЙЛАНЫСТЫ ӨЗГЕРІСТЕР	Кешке	1-апта: қызыл, орташа - 5 минут; жасыл, жоғары - 5 минут; аралас, жоғары - 2 минут. 2-апта: қызыл, жоғары - 5 минут; жасыл, жоғары - 7 минут; аралас, жоғары - 2 минут. 1 және 2-апталарды кезектестіріңіз.	Аптасына 2-3 рет	Курс ұзақтығы шектелмеген
КӨРІНЕТІН ТАМЫРЛАР / КУПЕРОЗ / СЕЗІМТАЛ ТЕРІ	Кешке	1-апта: қызыл, төмен - 3 минут; жасыл, орташа - 5 минут; аралас, орташа - 5 минут. 2-апта: қызыл, орташа - 5 минут; жасыл, жоғары - 2 минут; аралас, жоғары - 5 минут. 3-апта: қызыл, жоғары - 5 минут; жасыл, жоғары - 5 минут; аралас, жоғары - 3 минут. 4-апта: үзіліс.	Күнара	Үзілісті қосқанда 1 ай. 1 апта үзіліс жасаңыз. Екі 4 апталық курс, содан кейін 1 ай үзіліс.
ПИГМЕНТАЦИЯ / БІРКЕЛКІ ЕМЕС ТЕРІ РЕҢІ	Кешке	Қызыл: қою пигментацияға жоғары, қалыпты пигментацияға орташа қарқындылық - 6 минут. Жасыл, жоғары - 4 минут. Аралас, орташа - 5 минут.	Аптасына 2-3 рет	Тұрақты түрде

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Эпилепсиясы, қалқанша без аурулары бар немесе қалқанша безді емдеуге арналған дәрі қабылдайтын адамдарға құрылғыны қолдануға тыйым салынады.
2. Тері зақымдары, жарақаттары немесе операциядан кейінгі жаралары бар адамдарға масканы қолдануға тыйым салынады.

ЕСКЕРТУЛЕР:
1. Жасартатын фототерапия маскасы үйде қолдануға арналған. Оны тек нұсқаулыққа сәйкес қолданыңыз. Басқа мақсатта қолдануға тыйым салынады: өнімді зақымдауы немесе ағзаға зиян келтіруі мүмкін.
2. Маска зақымдалса, қауіпті болдырмау үшін қолдануды тоқтатып, тұтынушылардың шағымдарын қабылдауға уәкілетті ұйымға хабарласыңыз.
3. Масканы зарядтау кезінде қолдануға тыйым салынады. Зарядтау кезінде масканы, зарядтау кабелін және USB адаптерін дымқыл қолмен ұстамаңыз.
4. Масканы қолданудан жайсыздық немесе жағымсыз реакция (терінің қызаруы, қышу, аллергия) пайда болса, дереу тоқтатыңыз.

ЖИНАҚ ҚҰРАМЫ: 1) маска, 2) басқару пультіне жалғауға арналған Type C-Type C кабелі,
3. басқару пульті, 4) USB-C зарядтау кабелі, 5) нұсқаулық, 6) сақтау қабы.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

ЗАРЯДТАУ УАҚЫТЫ: 3-4 h

ЖҰМЫС УАҚЫТЫ: 140 минут (қызыл/көк/жасыл) • 80 минут (аралас жарық) • 78 минут (сары LED жарығы)

АҚЫЛДЫ ТАЙМЕР: 15 min

РЕЖИМДЕР:
• Қызыл LED жарығы - толқын ұзындығы 660 нм
• Көк LED жарығы - толқын ұзындығы 460 нм
• Жасыл LED жарығы - толқын ұзындығы 525 нм
• Сары LED жарығы - қызыл + жасыл
• Аралас жарық (ақ) - қызыл + көк + жасыл

МЕНШІКТІ ҚУАТЫ (СӘУЛЕЛЕНУ ҚАРҚЫНДЫЛЫҒЫ):
1-деңгей
• Қызыл LED жарығы - 6.595 mW/cm2
• Көк LED жарығы - 17.112 mW/cm2
• Жасыл LED жарығы - 6.612 mW/cm2
Сары LED жарығы - 14.049 mW/cm2
• Аралас жарық - 27.542 mW/cm2. 2-деңгей
• Қызыл LED жарығы - 14.058 mW/cm2
• Көк LED жарығы - 30.48 mW/cm2
• Жасыл LED жарығы - 15.636 mW/cm2
Сары LED жарығы - 17.857 mW/cm2
• Аралас жарық - 32.169 mW/cm2

3-деңгей
• Қызыл LED жарығы - 16.368 mW/cm2
• Көк LED жарығы - 47.653 mW/cm2
• Жасыл LED жарығы - 23.095 mW/cm2
Сары LED жарығы - 28.081 mW/cm2
• Аралас жарық - 39.089 mW/cm2

15 МИНУТТЫҚ СЕАНСТАҒЫ ЭНЕРГИЯ ДОЗАСЫ (ЭНЕРГИЯ СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ):
1-деңгей
• Қызыл LED жарығы - 5.9355 J/cm2
• Көк LED жарығы - 15.4008 J/cm2
• Жасыл LED жарығы - 5.9508 J/cm2
• Сары LED жарығы - 12.6441 J/cm2
• Аралас жарық - 24.7878 J/cm2. 2-деңгей
• Қызыл LED жарығы - 12.6522 J/cm2
• Көк LED жарығы - 27.432 J/cm2
• Жасыл LED жарығы - 14.0724 J/cm2
• Сары LED жарығы - 16.0713 J/cm2
• Аралас жарық - 28.9521 J/cm2. 3-деңгей
Қызыл LED жарығы - 14.7312 J/cm2
• Көк LED жарығы - 42.8877 J/cm2
• Жасыл LED жарығы - 20.7855 J/cm2
• Сары LED жарығы - 25.2729 J/cm2
• Аралас жарық - 35.1801 J/cm2

СУДАН ҚОРҒАНЫСЫ: IP22



LED MASK 3.0 - СЫМСЫЗ ФОТОТЕРАПИЯ МАСКАСЫ

7 жарық спектрі

Әжімдерді тегістейді

Пигментацияны азайтады

Безеу мен безеуден кейінгі іздерді азайтады

Іштен жарқырау

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: әжімдер, серпімділіктің төмендеуі, безеу мен қабыну, гиперпигментация, өңсіз реңк, ісіну, баяу қалпына келу, косметиканың төмен тиімділігі.

МАТЕРИАЛДАРЫ: ABS пластигі, силикон.

САЛМАҒЫ: 265 g.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
Фототерапия (LED) - әртүрлі ұзындықтағы жарық толқындарымен жылусыз әсер ету әдісі. Толқындар дерманың белгілі тереңдігіне еніп, жасушалардың фоторецепторларына сіңеді де, табиғи жаңару процестерін іске қосады.

Қызыл LED жарығы (630 нм): коллаген синтезін ынталандыратын дермиске терең енеді. Қызыл LED жарығымен терапия нәтижесінде жараның жазылуы жеделдейді, тері тартылады, әжімдер сияқты терінің қартаюының сыртқы белгілері азаяды.

Көк LED жарығы (415 нм): безеудің пайда болу себептеріне әсер ететін күшті бактерияға қарсы әсері бар, дезинфекциялайды, қабынуды азайтады және теріні тыныштандырады.

Жасыл LED жарығы (520 nm) терінің жалпы реңін тегістейді. Қызаруды, пигментацияны азайту және сезімтал терінің тітіркенуін басу үшін қолданылады. Жасыл LED жарығы капиллярлардың көлемін азайтып, қанның еркін ағуына ықпал ету арқылы куперозбен күреседі.

Сары LED жарығы (630+520 нм): тіндердегі микроциркуляцияны жақсартады, лимфалық дренажды қамтамасыз етеді, тоқырау мен ісінуді жояды.

Ақ жарық (630+520+415 нм): жасушалық метаболизмді жеделдетеді, косметиканың белсенді компоненттерінің терең сіңуіне ықпал етеді.

Жақын инфрақызыл (NIR, 830 нм): тіндердің регенерациясын терең деңгейде жылдамдатады, микрозақымдарды емдейді және теріні тыныштандырады.

Терең инфрақызыл (DIR, 1070 нм): жасушалардың ішкі энергиясын белсендіреді, «іштен жарқыраудың» айқын әсерін қамтамасыз етеді.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:
1. 7 түс спектрі: эстетикалық мәселелердің кең ауқымын шешуге арналған барынша толық түстік қамту 1 құрылғыда.
2. Қосарлы басқару жүйесі: кез келген жағдайда ыңғайлы болуы үшін пульт арқылы немесе тікелей маска арқылы басқару мүмкіндігі.
3. Сымсыз басқару. Маска пультпен Bluetooth байланысын қолдайды: масканы пультке сыммен қоспай, режимдерді қашықтан баптап басқаруға болады. Бұл кез келген жағдайда еркін қозғалып, ыңғайлы қолдануға мүмкіндік береді.
4. Қолмен баптау режимі. Жеке бағдарламалар жасау: түстердің ретін және әр спектрдің жұмыс уақытын өзіңіз белгілейсіз.
5. Масканың анатомиялық 3D пішіні бетке сай келіп, тығыз жанасуды қамтамасыз етеді.
6. Ақылды таймер: қауіпсіз әрі тиімді қолдану үшін сеансты 15 минуттан кейін автоматты түрде аяқтайды.
7. Дауыстық сүйемелдеу. Құрылғы таңдалған режимдер мен Bluetooth қосылуын 2 тілде (орысша және ағылшынша) хабарлайды. Бұл функция міндетті емес: дауыстық сүйемелдеуді өшіруге болады.
8. Жад функциясы: тұрақты қолданғанда уақытты үнемдеу үшін қолмен орнатылған соңғы баптауларды сақтайды.
9. Терең енуге арналған 2 инфрақызыл жарық түрі. LED MASK 3.0 инфрақызыл сәуленің екі спектрімен жабдықталған (830 nm және 1070 nm). Бұл кәдімгі косметика мен стандартты фототерапия жете алмайтын дерманың ең терең қабаттарында жасару процестерін іске қосуға мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ:
LED MASK 3.0 қосарлы басқару жүйесімен жабдықталған:
1. Маска корпусындағы контроллер арқылы.
2. Қашықтан басқару пультімен.

Кірістірілген контроллермен басқару: бұл тәсілмен маска тек автоматты режимде жұмыс істей алады.

1. Масканы қосу немесе өшіру үшін батырманы 2 секунд басып тұрыңыз. Бұл әрекеттер ұзақ дыбыстық белгімен сүйемелденеді.
2. Маска жарығын ауыстыру үшін батырманы қысқа басыңыз.
3. Bluetooth функциясын қосып, басқару пультімен байланыстыру үшін батырманы 5 секунд басып тұрыңыз. Қосылғаннан кейін маска контроллеріндегі индикатор көк түспен жанады.

4. Жарық қарқындылығын арттыру үшін батырманы қысқа басыңыз.
5. Дауыс тілін - ағылшын немесе орыс тілін таңдау үшін батырманы басыңыз.

6. Жарық қарқындылығын азайту үшін батырманы қысқа басыңыз.
7. Дауыстық сүйемелдеуді қосу немесе өшіру үшін батырманы басыңыз.

Пультпен басқару үшін алдымен контроллер арқылы масканы, содан кейін пультті қосып, олардың байланысуын күтіңіз. Сәтті қосылғаннан кейін «Bluetooth is connected/Bluetooth подключен» («Bluetooth қосылды») деген дыбыстық хабарлама естіледі.

1. Батырманы ұзақ басып, масканы қосыңыз.
2. Батырманы қысқа басу масканы басқару режимін таңдауға мүмкіндік береді: Автоматты (сеанс бойы 1 жарық түрі жұмыс істейді, процедураға түсті пайдаланушы өзі таңдайды) немесе қолмен басқару (пайдаланушы түстердің ауысуын, қажетті түстің ұзақтығы мен қарқындылығын белгілейді).
3. Ұзақ басу масканы өшіреді.

4. Қысқа басу таңдалған қарқындылық пен уақыт баптауларын растайды.
5. Қолмен басқару режимінде барлық баптаулар орнатылғаннан кейін екі рет басу масканы іске қосады.
6. Сеанс кезінде қысқа басу процедураны үзіліске қояды. Қайта қысқа басу тоқтатылған сеансты жалғастырады. Үзіліс кезінде экран жыпылықтайды.
7. Қолмен басқару режиміне ауысқаннан кейін ұзақ басу алдын ала орнатылған (соңғы сақталған) баптауларды жоюға мүмкіндік береді.

8. Батырманы қысқа басу қажетті жарыққа ауыстырады: төмен батырмасы келесі жарық түріне, жоғары батырмасы алдыңғы жарық баптауларына қайтарады.

9. Қолмен басқару режимінде арттыру батырмасын қысқа басу қарқындылық пен сеанс уақытын арттырады, азайту батырмасы оларды азайтады.
10. Автоматты режимде арттыру батырмасын қысқа басу әсер қарқындылығын арттырады, азайту батырмасы қарқындылық деңгейін азайтады.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Сеанс алдында бет терісін тазалаңыз: макияжды кетіріп, күтім құралдарын жақпаңыз.
2. Масканы контроллер арқылы қосыңыз.
3. Масканы бетке тығыз жанасатындай киіңіз.
4. Маска ыңғайлы тұратындай артындағы жабысқақ бекіткіштерді жалғап бекітіңіз.

Автоматты басқару режимі
5. Автоматты режимді тікелей маскадан да, басқару пультімен де басқаруға болады.

Тікелей маска арқылы басқару үшін
6. Контроллердегі қосу/өшіру батырмасын ұзақ басып, масканы қосыңыз.
7. Сол батырманы (қосу/өшіру/режим ауыстыру) қысқа басып, қажетті жарық түрін таңдаңыз.
8. Арттыру және азайту батырмаларымен қажетті жарық қарқындылығын орнатыңыз.

9. Сеанс автоматты түрде басталады, іске қосуды растаудың қажеті жоқ.
10. 15 минуттық ақылды таймер бағдарламаны өзі аяқтайды.

Басқару пультімен баптау үшін
11. Маска мен пульт арасында Bluetooth байланысын орнату қажет. Масканы қосқаннан кейін пультті қосып, дыбыстық белгіні күтіңіз.
12. Пультте алдымен автоматты басқару режимі қосылады. Экранның төменгі бұрышында A әрпі көрсетілгенін тексеріңіз.
13. Қажетті жарықты таңдаңыз.
14. Қарқындылық деңгейін 1-ден 3-ке дейін реттеңіз.
15. Маска ақылды таймердің кері санағын қосып, автоматты түрде жұмысын бастайды.
16. 15 минуттан кейін маска өздігінен өшеді.

Қолмен басқару режимі
17. Масканы контроллер арқылы іске қосыңыз.
18. Қолмен басқару режимі тек пультпен басқарылады, сондықтан маска мен пульт арасында Bluetooth байланысын орнату маңызды. Масканы қосқаннан кейін пультті қосып, дыбыстық белгіні күтіңіз.
19. Пульттен қолмен басқару режимін таңдаңыз. Экранда M әрпі жанады.
20. Қажетті жарық комбинациясын, олардың қарқындылығы мен жұмыс уақытын белгілей аласыз.
21. Ең бірінші реттелген қызыл LED жарығы. Реттеуді қарқындылық деңгейінен бастауға болады. Экранда қарқындылық деңгейінің белгісі жыпылықтайды. +/- түймелерін пайдаланып, қажетті деңгейді таңдаңыз. Оны бастау/кідірту түймесін басу арқылы растаңыз.
22. Содан кейін осы жарықтың жұмыс уақытын таңдаңыз. +/- батырмаларымен уақытты арттырыңыз немесе азайтыңыз. Іске қосу/үзіліс батырмасын басып, баптауды растаңыз.
23. Келесі түсті де осылай баптай аласыз (көк → сары → жасыл → ақ → жақын инфрақызыл → терең инфрақызыл).
24. Кез келген түсті өткізіп жіберу үшін оның жұмыс уақытын нөлге орнатыңыз немесе V/Λ батырмаларымен (түсті ауыстыру) келесі жарыққа ауысыңыз.
25. Λ батырмасымен (түсті ауыстыру) алдыңғы жарыққа оралып, жарықтығы мен жұмыс уақытын реттей аласыз.
26. Қолмен басқару режимінде LED MASK 3.0 жад функциясын ұсынады. Пультте қолмен баптауды қосқаннан кейін іске қосу/үзіліс батырмасын ұзақ басу алдын ала орнатылған жарық комбинациясын жояды.
27. Фототерапия сеансынан кейін күтім және ылғалдандыру құралдарын жағу ұсынылады.

ҚОЛДАНУ ЖИІЛІГІ МЕН ҰЗАҚТЫҒЫ:

ТЕРІ ТҮРІ / МӘСЕЛЕ	ТӘУЛІК УАҚЫТЫ	ҰЗАҚТЫҒЫ МЕН РЕТІ	ЖИІЛІГІ	КУРС
БЕЗЕУ	Жаңадан бастағандар және сезімтал тері: таңертең көк LED жарығы; кешке қызыл LED жарығы (ұйқыға бір сағат қалғанда). Тәжірибелі пайдаланушылар және басқа тері түрлері: таңертең немесе күндіз. Көк LED жарығы мелатонин өндірісін басады және ұйқы режимін өзгертуі мүмкін.	Жаңадан бастағандар және сезімтал тері: көк LED жарығы - бір күнде 15 минут; қызыл LED жарығы - екі күн сайын 15 минут. Осы кезектесуді қайталаңыз. Тәжірибелі пайдаланушылар және басқа тері түрлері, 1 сеанс ішінде: көк LED жарығы - 7 минут; қызыл LED жарығы - 7 минут.	Аптасына 3-4 рет	ПРОЦЕДУРАЛАР КУРСЫ: 4-6 апта. Үзіліс: 2 апта. Курсты қайталауға немесе басқа мәселеге арналған жаңа курс бастауға болады.
БЕЗЕУДЕН КЕЙІНГІ ІЗДЕР	Қызыл LED жарығы - кешке (ұйқыға бір сағат қалғанда) Күннің уақытына қарамастан басқа түстер	Тыртықтар: қызыл LED - 7 минут; жақын инфрақызыл - 7 минут. Қызыл дақтар: сары LED - 7 минут; жасыл LED - 7 минут.	Тыртықтар: аптасына 3 рет. Қызыл дақтар: аптасына 3 рет	Тыртықтар: курс - 12 апта, үзіліс - 4-6 апта. Курсты қайталауға немесе басқа мәселеге жаңа курс бастауға болады. Қызыл дақтар: курс - 6-8 апта, үзіліс - 4 апта. Курсты қайталауға немесе басқа мәселеге жаңа курс бастауға болады.
КЕҢЕЙГЕН ТЕРІ ТЕСІКТЕРІ / МАЙЛЫ ЖЫЛТЫР	Таңертең/күн (себебі көк LED жарығы мелатонин өндірісін басады, ұйқы режимін өзгерте алады)	Көк - 7 минут; қызыл - 7 минут	Аптасына 3-4 рет	ПРОЦЕДУРАЛАР КУРСЫ: 6-8 апта. Үзіліс: 3 апта. Курсты қайталауға немесе басқа мәселеге арналған жаңа курс бастауға болады.
ПИГМЕНТАЦИЯ	Тәуліктің кез келген уақытында	Сары LED жарығы - 7 минут Жасыл LED жарығы - 7 минут	Аптасына 3-4 рет	ПРОЦЕДУРАЛАР КУРСЫ: 8-12 апта. Үзіліс: 4-6 апта. Курсты қайталауға немесе басқа мәселеге арналған жаңа курс бастауға болады.
ТЕРІНІҢ ҚАБЫР ШАҚТАНУЫ / ТАРТЫЛУ СЕЗІМІ	Кешке (ұйықтардан бір сағат бұрын)	Қызыл LED жарығы - 5-7 минут жақын инфрақызыл жарық - 5-7 минут	Аптасына 3-4 рет	ПРОЦЕДУРАЛАР КУРСЫ: 6 апта. Үзіліс: 4 апта. Курсты қайталауға немесе басқа мәселеге арналған жаңа курс бастауға болады.
РОЗАЦЕА	Қызыл LED жарығы - кешке (ұйқыға бір сағат қалғанда) Күннің уақытына қарамастан басқа түстер	Сары LED жарығы - бір күнде 15 минут; қызыл LED жарығы - екі күн сайын 10 минут, сонымен қатар жақын инфрақызыл жарық - екі күн сайын 5 минут. Осы кезектесуді қайталаңыз.	Аптасына 3-4 рет	ПРОЦЕДУРАЛАР КУРСЫ: 8-12 апта. Үзіліс: 4 апта. Курсты қайталауға немесе басқа мәселеге арналған жаңа курс бастауға болады.
КУПЕРОЗ	Тәуліктің кез келген уақытында	Жасыл LED жарығы - 15 минут	Аптасына 2 рет	ПРОЦЕДУРАЛАР КУРСЫ: 8-12 апта. Үзіліс: 4 апта. Курсты қайталауға немесе басқа мәселеге арналған жаңа курс бастауға болады.

ТЕРІ ТҮРІ / МӘСЕЛЕ	ТӘУЛІК УАҚЫТЫ	ҰЗАҚТЫҒЫ МЕН РЕТІ	ЖИІЛІГІ	КУРС
ӘЖІМДЕР	Кешке (ұйықтардан бір сағат бұрын)	Қызыл LED жарығы - 7 минут жақын инфрақызыл жарық - 7 минут	Аптасына 3 рет	ПРОЦЕДУРАЛАР КУРСЫ: 8-12 апта. Үзіліс: 4 апта. Курсты қайталауға немесе басқа мәселеге арналған жаңа курс бастауға болады.
БЕТТІҢ ӨҢСІЗ РЕҢІ	Қызыл LED жарығы - кешке (ұйқыға бір сағат қалғанда) Сары LED жарығы тәулік уақытына қарамастан	Қызыл LED жарығы - 15 минут (бір күні), сары LED жарығы - 15 минут (келесі күні). Күнара кезектестіріңіз.	Аптасына 3-4 рет	ПРОЦЕДУРАЛАР КУРСЫ: 6-8 апта. Үзіліс: 3-4 апта. Курсты қайталауға немесе басқа мәселеге арналған жаңа курс бастауға болады.
ІСІНУ	Тәуліктің кез келген уақытында	Сары LED жарығы - 15 минут	Аптасына 3-4 рет	ПРОЦЕДУРАЛАР КУРСЫ: 8 апта. Үзіліс: 2-4 апта. Курсты қайталауға немесе басқа мәселеге арналған жаңа курс бастауға болады.
ЖЕТІЛГЕН ТЕРІ / СЕРПІМДІЛІК ПЕН ТОНУСТЫҢ ТӨМЕНДЕУІ / ТЕРІНІҢ БОСАҢСУЫ	Кешке (ұйықтардан бір сағат бұрын)	Аптасына 2 рет 1 сеанс: қызыл LED - 7 минут, жақын инфрақызыл - 7 минут. Аптасына 2 рет 1 сеанс: терең инфрақызыл - 15 минут. 1-апта сеансы - 5 минут; 2-апта - 10 минут; 3-аптадан бастап - 15 минут.	Аптасына 4 рет	ПРОЦЕДУРАЛАР КУРСЫ: 8-12 апта. Үзіліс: 4 апта. Курсты қайталауға немесе басқа мәселеге арналған жаңа курс бастауға болады.

Деңгей: 1-деңгейден бастап, 1 апта қолданыңыз. Содан кейін 2-деңгейге ауысып, 1.5 апта қолданыңыз, кейін 3-деңгейге ауысыңыз.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:

1. Қызыл жегі, фотосезімтал экзема немесе альбинизм болса, масканы қолданбаңыз. Мұндай жағдайларда фототерапия терінің ауыр реакциясын туғызуы мүмкін.
2. Фотосезімталдықтың кез келген бұзылысы болса (жарыққа сезімтал болсаңыз), масканы қолдануға тыйым салынады.
3. Фотосезімталдық туғызатын дәрілерді қабылдасаңыз, масканы қолданбаңыз. Оларға кейбір антибиотиктер, химиотерапиялық дәрілер мен диуретиктер жатады. Құрылғыны қолданар алдында дәрігермен кеңесіңіз.
4. Жараларыңыз болса, масканы қолданбаңыз немесе фототерапия сеансында сол аймақты айналып өтіңіз.
5. Соңғы 2 аптада күнге күйген болсаңыз, масканы қолданбаңыз.
6. Фицпатрик жіктеуі бойынша теріңіз I, V немесе VI түріне жатса, масканы қолданбаңыз.
7. Бұрын жарықтан туындайтын эпилепсия болған болса, масканы қолданбаңыз.
8. Безеудің ауыр түрлерінде қолданбаңыз.
9. Сәбилерге, қалқанша без аурулары бар немесе қалқанша безді емдеуге арналған дәрі қабылдайтын адамдарға құрылғыны қолдануға тыйым салынады.

10. Масканы зарядтау немесе техникалық қызмет көрсету кезінде қолданбаңыз. Зарядтау кезінде масканы, зарядтау кабелін және USB адаптерін дымқыл қолмен ұстамаңыз.
11. Маска зақымдалған болса, қолданбаңыз. Өндіруші тұтынушылардың шағымдарын қабылдауға уәкілеттік берген ұйымға хабарласыңыз.

ЕСКЕРТУЛЕР:

1. Масканы қолданар алдында сезімталдық сынағын жасау қажет.
2. Маска ыстық болып көрінсе немесе теріңіз жағымсыз ыстық сезінсе, масканы өшіріп шешіңіз.
3. Масканы тек тазаланған теріге қолданыңыз: макияжды кетіріп, процедура алдында күтім құралдарын жақпаңыз. Кейбір құрамдастар жарыққа сезімталдықты арттыруы немесе процедура әсерін азайтуы мүмкін.
4. Масканы судан алыс қолданыңыз, құрылғыға су тигізбеңіз.
5. Масканы ыстық беттерге қоймаңыз.
6. Құрылғыны өзіңіз өзгертуге немесе жөндеуге тырыспаңыз. Бұл кепілдікті жояды және электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Құрылғыда пайдаланушы өздігінен қызмет көрсете алатын бөлшектер жоқ.
7. Масканың өзі, контроллер, зарядтау ашасы немесе кабелі зақымдалған болса, масканы қолданбаңыз.
8. Қосар алдында желі кернеуінің құрылғыда көрсетілген кернеуге сәйкес келетінін тексеріңіз.
9. Шамдарды зақымдамау үшін жабдықты қатты соққылардан қорғаңыз.
10. Көзді қорғау үшін құрылғы жұмыс істеп тұрғанда жарық көзіне қарамаңыз.
11. Масканы мына жағдайларда қолданбаңыз: МРТ, диатермия, электрокоагуляция, сымсыз қуат беру, 5G және электромагниттік таратқыштары бар басқа жүйелер аймағында.
12. Бұл жабдықты басқа жабдықтың жанында немесе онымен қабаттастырып қолданбаңыз: жұмыс ақаулары туындауы мүмкін. Мұндай қолдану қажет болса, екеуінің де дұрыс жұмыс істейтінін бақылаңыз.
13. Түпнұсқа түрлендіргіштер мен кабельдерді қолданыңыз. Өндіруші көрсеткен немесе берген аксессуарлардан басқаларын қолдану электромагниттік сәулеленуді арттыруы немесе жабдықтың кедергілерге төзімділігін төмендетуі мүмкін. Бұл дұрыс жұмыс істемеуге әкеледі.
14. Масканы жұмыс істеп тұрған радио құрылғылардан - Wi-Fi роутерлерінен, ұялы телефондардан, бала бақылағыштарынан және антенналардан 30 cm-ден жақын қолданбаңыз. Қуатты радиосигналдар масканың жұмысын бұзуы немесе процедураның тиімділігін азайтуы мүмкін.
15. LED MASK 3.0 - жеке гигиена бұйымы, оны басқа адамдарға беру ұсынылмайды.
16. Маска зақымдалса, қауіпті болдырмау үшін қолдануды тоқтатып, тұтынушылардың шағымдарын қабылдауға уәкілетті ұйымға хабарласыңыз. Өз бетінше жөндеу, бөлшектеу немесе дұрыс қолданбау жағдайында бұл ұйым кепілдік міндеттемелерінен босатылады.
17. Масканы қолданудан жайсыздық немесе жағымсыз реакция (терінің қызаруы, қышу, аллергия) пайда болса, дереу тоқтатыңыз.

ЖИНАҚ ҚҰРАМЫ: 1) маска, 2) Dual Type-C зарядтау кабелі, 3) басқару пульті, 4. пайдалану нұсқаулығы, (5) сақтау қаптары.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

ҚУАТЫ: 3 W

АККУМУЛЯТОР СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ: 850 mAh

ЖҰМЫС КЕРНЕУІ: 3,7 V

ҚОРЕК КЕРНЕУІ: 5 V

АҚЫЛДЫ ТАЙМЕР: 15 min

ЗАРЯДТАУ УАҚЫТЫ: 4 сағат (маска), 45 минут (пульт)

ЖҰМЫС УАҚЫТЫ: • 64 минут (қызыл LED жарығы режимі) • 60 минут (көк LED жарығы режимі), • 55 минут (сары LED жарығы режимі), • 55 минут (жасыл LED жарығы режимі), • 57 минут (ақ жарық режимі), • 93 минут (жақын инфрақызыл (NIR) режимі), • 215 минут (терең инфрақызыл) (DIR)

РЕЖИМДЕР:
• Қызыл LED жарығы - толқын ұзындығы 630 нм
• Көк LED жарығы - толқын ұзындығы 415 нм
• Жасыл LED жарығы - толқын ұзындығы 520 нм
• Сары LED жарығы - қызыл + жасыл
• Ақ жарық - қызыл + көк + жасыл
Жақын инфрақызыл - 830 nm
Терең инфрақызыл - 1070 nm

МЕНШІКТІ ҚУАТЫ (СӘУЛЕЛЕНУ ҚАРҚЫНДЫЛЫҒЫ):
1-деңгей
• Қызыл LED жарығы - 10.5 mW/cm2
• Көк LED жарығы - 12.4 mW/cm2
• Сары LED жарығы - 10.4 mW/cm2
• Жасыл LED жарығы - 8.4 mW/cm2
Ақ жарық - 13.3 mW/cm2
• NIR - 7.76 mW/cm2
DIR - 3.14 mW/cm2. 2-деңгей
• Қызыл LED жарығы - 14.4 mW/cm2
• Көк LED жарығы - 18.5 mW/cm2
• Сары LED жарығы - 13.9 mW/cm2
• Жасыл LED жарығы - 11.2 mW/cm2
Ақ жарық - 16.9 mW/cm2
• NIR - 10.49 mW/cm2
DIR - 4.24 mW/cm2. 3-деңгей
• Қызыл LED жарығы - 17.4 mW/cm2
• Көк LED жарығы - 20.2 mW/cm2
• Сары LED жарығы - 17.6 mW/cm2
• Жасыл LED жарығы - 14.6 mW/cm2

Ақ жарық - 19.1 mW/cm2
• NIR - 17.1 mW/cm2
• DIR - 8.3 mW/cm2

15 МИНУТТЫҚ СЕАНСТАҒЫ ЭНЕРГИЯ ДОЗАСЫ (ЭНЕРГИЯ СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ):
1-деңгей
• Қызыл LED жарығы - 9.45 J/cm2
• Көк LED жарығы - 11.16 J/cm2
• Сары LED жарығы - 9.36 J/cm2
• Жасыл LED жарығы - 7.56 J/cm2
Ақ жарық - 11.97 J/cm2
• NIR - 6.98 J/cm2
• DIR - 2.83 J/cm2. 2-деңгей
• Қызыл LED жарығы - 12.96 J/cm2
• Көк LED жарығы - 16.65 J/cm2
• Сары LED жарығы - 12.51 J/cm2
• Жасыл LED жарығы - 10.08 J/cm2
Ақ жарық - 15.21 J/cm2
• NIR - 9.44 J/cm2
• DIR - 3.82 J/cm2. 3-деңгей
• Қызыл LED жарығы - 15.66 J/cm2
• Көк LED жарығы - 18.18 J/cm2
• Сары LED жарығы - 15.84 J/cm2
• Жасыл LED жарығы - 13.14 J/cm2
Ақ жарық - 17.19 J/cm2
• NIR - 15.39 J/cm2
• DIR - 7.47 J/cm2

ӨЛШЕМІ (Б × Е × Т): 255×580×121 mm



LED NECK MASK 2.0 - МОЙЫН МЕН ДЕКОЛЬТЕГЕ АРНАЛҒАН ФОТОТЕРАПИЯ

Қан айналымын жақсартады

Пигментацияны азайтады

Тері реңін тегістейді

Әжімдерді тегістейді

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: пигментация, безеу, купероз, розацеа, акне, терінің қартаю белгілері, май бездерінің белсенді жұмысы, кеңейген тесіктер, өңсіз және шаршаған тері.

МАТЕРИАЛДАРЫ: силикон, ABS пластигі.

САЛМАҒЫ: 210 g.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
LED NECK MASK жарықдиодты терапия қағидасымен жұмыс істейді. Маскаға LED шамдары орнатылған; әрқайсысы белгілі бір түсті жарық шығаруға бағдарламаланған. Әр түс көрінетін жарық спектріндегі белгілі бір толқын ұзындығына сәйкес келеді. Жарық терінің әртүрлі тереңдігіне әсер етіп, рецепторларға сіңеді, жасуша ішіндегі табиғи процестерді белсендіріп, терінің белгілі реакциясын туғызады.

Қызыл LED жарығы - бұл жарық көрінетін спектрдің басқа түстеріне қарағанда теріге тереңірек енеді. Ол фибробласттарға (коллагенді синтездейтін жасушалар) әсер етеді, осылайша терінің жасаруына және қартаю белгілерімен күресуге ықпал етеді.

Көк LED жарығы ең төменгі ену тереңдігіне ие және эпидермис деңгейінде жұмыс істейді. Порфириндер (адам ағзасындағы пигменттер) көгілдір LED жарығын сіңіріп, синглетті оттегі молекулаларын босатып, тері бетінде тұратын безеу бактерияларын өлтіреді. Осылайша көк LED жарығы дезинфекциялайды, қабыну түзілімдерін азайтады, безеумен күреседі.

Жасыл LED жарығы эпидермис пен дермиске сіңіп, жасушалық реакцияны тудырады, оның салдары арасында теріні қалпына келтіру және емдеу бар. Ол қызаруды азайту, сезімтал терінің тітіркенуін жеңілдету үшін қолданылады. Жасыл LED жарығы капиллярлардың мөлшерін азайтып, қанның еркін ағымына ықпал ететін куперозбен күреседі.

Сары LED жарығы (қызыл + жасыл) - қан айналымын ынталандыру үшін қолданылады, тері өңін жеңілдетуге, пигментацияның ауырлығын азайтуға көмектеседі.

Аралас жарық (қызыл + көк + жасыл = ақ) косметиканың жылдам әрі терең сіңуіне қолданылады. Сондай-ақ ағзаға жалпы босаңсытатын және тыныштандыратын әсер береді.

Жақын инфрақызыл жарық тіндердің тереңде қалпына келуін жеделдетеді, микрозақымдарды жазып, теріні тыныштандырады.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:
1. Мойын мен декольтенің осал аймақтарына әсер етуге арналған ерекше пішін.
2. Масканың екі жағындағы қарапайым бекіткіш.
3. Эргономикалық басқару пульті.
4. Әр жарық режимі үшін 3 қарқындылық деңгейі, жоғары энергия сыйымдылығы.
5. Тағамдық силиконнан жасалған масканы қолдану қауіпсіз.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ:
1. Масканы Type C кабелімен басқару пультіне жалғаңыз. Кабельді ұяға тән шертілген дыбыс естілгенше енгізіңіз.
2. Құрылғыны қосу үшін басқару тақтасындағы қосу/өшіру түймесін 2 секунд басып тұрыңыз. Маска бірінші қарқындылық деңгейінде қызыл LED жарығы режимінде автоматты түрде қосылады (басқару панелінің дисплейіндегі C: R, L: 1 индикаторлары).
3. Ауыстыру түймелерін (↑/↓) қысқа басу (1 секунд) көк LED жарығы режиміне (басқару панеліндегі индикатор C: B), жасыл LED жарығы режиміне (индикатор C: G), сары LED жарығы режиміне (индикатор C: RG), ақ жарық режиміне (C индикаторы: RGB), NIR режиміне (индикатор C: IR_) ауысуға мүмкіндік береді.
4. Жарық қарқындылығын реттеу батырмаларын (-/+) қысқа басу (1 секунд) деңгейді 3-ке дейін арттырады немесе 1-деңгейге қайтарады (пульттегі L: 1 (2/3) индикаторы).
5. Үзіліс батырмасын қысқа басу (1 секунд) құрылғыны уақытша тоқтатады; қайта басу жұмысын жалғастырады.
6. Құрылғыны өшіру үшін пульттегі қосу/өшіру батырмасын 2 секунд басып тұрыңыз.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
Алғаш қолданар алдында сезімталдық сынағын жасаңыз:
Масканы қолдың ішкі жағына орналастырыңыз.
Масканы қосып, толық 15 минуттық фототерапия сеансын өткізіңіз.
Теріде жайсыздық немесе күйдіру сезілсе, масканы қолдануды дереу тоқтатыңыз.
• Сынақтан кейін шамамен 6 сағат күтіңіз. Қолдың ішкі жағы қызарса және/немесе қышыса, LED NECK MASK сізге жарамайды.
1. Басқару пультін маскаға жалғаңыз.
2. Масканы мойныңызға киіңіз.
3. Масканы қосып, қажетті жарық режимі мен қарқындылық деңгейін таңдаңыз.
4. Фототерапия процедурасынан ләззат алыңыз. Әр жарық режимі 15 минут жұмыс істейді, содан кейін пульт автоматты түрде өшеді. Режимді ауыстырғанда таймер қайта басталады. Бір сеанста бірнеше режим қолдансаңыз, жалпы процедура уақыты 15 минуттан аспауын мұқият бақылаңыз.
5. LED терапиясынан кейін күтім құралын - сарысу немесе крем қолданыңыз: LED маскадан кейін терінің сіңіру қабілеті артады.
6. Көрінетін нәтижеге жету үшін масканы кемінде 4 апта бойы аптасына 3-4 рет тұрақты қолданыңыз.
7. Қажетті әсерге жеткеннен кейін аптасына 1-2 процедура жасауға болады.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Мойын мен декольтеге арналған LED фототерапия маскасы - үйде қолданылатын құрылғы. Оны тек осы нұсқаулықта сипатталғандай қолданыңыз. Басқа мақсатта қолданбаңыз: өнім зақымдалуы немесе денеге зиян келуі мүмкін.
2. Маска зақымдалса, қауіпті болдырмау үшін қолдануды тоқтатып, тұтынушылардың шағымдарын қабылдауға уәкілетті ұйымға хабарласыңыз. Өз бетінше жөндеу, бөлшектеу немесе дұрыс қолданбау жағдайында бұл ұйым кепілдік міндеттемелерінен босатылады.
3. Масканы зарядтау кезінде қолдануға тыйым салынады. Зарядтау кезінде масканы, зарядтау кабелін және USB адаптерін дымқыл қолмен ұстамаңыз.
4. Масканы қолданудан жайсыздық немесе жағымсыз реакция (терінің қызаруы, қышу, аллергия) пайда болса, дереу тоқтатыңыз.
5. Эпилепсиясы, қалқанша без аурулары бар немесе қалқанша безді емдеуге арналған дәрі қабылдайтын адамдарға құрылғыны қолдануға тыйым салынады.
6. Тері зақымдары, жарақаттары немесе операциядан кейінгі жаралары бар адамдарға масканы қолдануға тыйым салынады.

ЕСКЕРТУЛЕР:
1. Құрылғы тек үйде қолдануға арналған.
2. Масканы зарядтау кезінде қолданбаңыз.
3. Құрылғы бетіне немесе корпусының ішіне су тигізбеңіз.
4. Құрылғыны ашық жылу көзінің жанында қолданбаңыз.
5. Құрылғыны тазалау және техникалық қызмет көрсету кезінде қуатты өшіріңіз.

ЖИНАҚ ҚҰРАМЫ: (1) фототерапия маскасы, (2) басқару пульті, (3) пультті маскаға жалғауға арналған Type C кабелі, (4) USB-Type C зарядтау кабелі, (5) сақтау қабы, (6) нұсқаулық, (7) масканың 2 бауы.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:
ЗАРЯДТАУ УАҚЫТЫ: 2 сағат. ЖҰМЫС УАҚЫТЫ: 60 минут. АҚЫЛДЫ ТАЙМЕР: 15 минут (автоматты режим)
РЕЖИМДЕР:
• Қызыл LED жарығы - толқын ұзындығы 630 нм
• Көк LED жарығы - толқын ұзындығы 415 нм
• Жасыл LED жарығы - толқын ұзындығы 525 нм
• Сары LED жарығы - қызыл + жасыл
• Аралас жарық (ақ) - қызыл + көк + жасыл
Жақын инфрақызыл жарық - толқын ұзындығы 830 nm

МЕНШІКТІ ҚУАТЫ (СӘУЛЕЛЕНУ ҚАРҚЫНДЫЛЫҒЫ):
1-деңгей
• Қызыл LED жарығы - 7.755 mW/cm2
• Көк LED жарығы - 16.6 mW/cm2
• Жасыл LED жарығы - 12.214 mW/cm2
Сары LED жарығы - 16.069 mW/cm2
• Аралас жарық - 30.211 mW/cm2
• Жақын инфрақызыл - 6.2 mW/cm2

2-деңгей
• Қызыл LED жарығы - 16.562 mW/cm2
• Көк LED жарығы - 23.34 mW/cm2
• Жасыл LED жарығы - 15.710 mW/cm2
• Сары LED жарығы - 26.597 mW/cm2
• Аралас жарық - 33.950 mW/cm2
Жақын инфрақызыл - 11.9 mW/cm2. 3-деңгей
• Қызыл LED жарығы - 22.896 mW/cm2
• Көк LED жарығы - 29.57 mW/cm2
• Жасыл LED жарығы - 25.895 mW/cm2
Сары LED жарығы - 30.697 mW/cm2
• Аралас жарық - 38.154 mW/cm2
Жақын инфрақызыл - 19.54 mW/cm2

15 МИНУТТЫҚ СЕАНСТАҒЫ ЭНЕРГИЯ ДОЗАСЫ (ЭНЕРГИЯ СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ)
1-деңгей
Қызыл LED жарығы - 7.755 J/cm2
• Көк LED жарығы - 17.928 J/cm2
• Жасыл LED жарығы - 12.214 J/cm2
• Сары LED жарығы - 16.069 J/cm2
• Аралас жарық - 30.211 J/cm2
Жақын инфрақызыл - 6.20 J/cm2. 2-деңгей
• Қызыл LED жарығы - 16.562 J/cm2
• Көк LED жарығы - 33.240 J/cm2
• Жасыл LED жарығы - 15.710 J/cm2
• Сары LED жарығы - 26.597 J/cm2
• Аралас жарық - 33.950 J/cm2
Жақын инфрақызыл - 11.9 J/cm2. 3-деңгей
• Қызыл LED жарығы - 22.896 J/cm2
• Көк LED жарығы - 50.627 J/cm2
• Жасыл LED жарығы - 25.895 J/cm2
• Сары LED жарығы - 30.697 J/cm2
• Аралас жарық - 38.154 J/cm2
• Жақын инфрақызыл - 19.54 J/cm2

СУДАН ҚОРҒАНЫСЫ: IP22



LED PATCHES - ТЕРІГЕ НҮКТЕЛІ КҮТІМ ЖАСАУҒА АРНАЛҒАН LED ПАТЧТАРЫ

Қабынуды жылдам басады

Пигментацияны ағартады

Нысаналы лифтинг

Серпімділікті жақсартады

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: жергілікті қабыну мен безеу, терінің аллергиялық реакциялары, ұсақ кемшіліктер, май теңгерімінің бұзылуы, жекелеген аймақтардағы жасқа байланысты өзгерістер (әжімдер, қатпарлар), пигменттік дақтар.

МАТЕРИАЛДАРЫ: PC пластигі, силикон.

САЛМАҒЫ: 23.4 g (қорап), 2.78 g (патч).

ФУНКЦИЯЛАРЫ:

Фототерапия (LED) - терінің белгілі бір тереңдігіне еніп, жасушаларға сіңетін әртүрлі ұзындықтағы жарық толқындарымен әсер ету әдісі. Ол табиғи жаңару процестерін іске қосады.

Қызыл LED жарығы (630 нм): жасушалардағы метаболикалық процестерді ынталандырады, терең қалпына келтіруге ықпал етеді, тері құрылымын жақсартады және пигментті дақтарды ағартады.

Көк LED жарығы (415 nm) майлы терінің теңгерімін қалыпқа келтіреді, жұмсақ тазартады және тыныштандырады.

Патчтар бактерияға қарсы және жасартатын әсерді бір уақытта беру үшін екі жарық спектрін біріктіретін жалғыз АРАЛАС РЕЖИМДЕ жұмыс істейді.

UVC - Корпустағы радиация (275 нм): патчтарды зарарсыздандыру үшін тек жабық қорап ішінде қолданылады. Сәуле бактериялар мен вирустардың ДНҚ мен РНҚ-сын бұзады, бұл патчты келесі қолдану тері үшін мүлдем қауіпсіз болатынын қамтамасыз етеді.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:
1. Нысаналы әсер: ықшам өлшемі патчты дәл өңдеу қажет аймаққа (безеуге, қатпарға немесе пигменттік даққа) бекітуге мүмкіндік береді.
2. Қол бос қалады: патчтар арнайы гипоаллергенді жабысқақ жапсырмалармен теріге берік бекітіледі (жинақта 32 дана). Сеанс кезінде өз ісіңізбен айналыса аласыз.
3. Автоматты залалсыздандыру: патчтары бар қорап жабылғанда 1 минуттық UVC залалсыздандыру циклі автоматты түрде іске қосылып, әр қолдануда теріге қауіпсіздікті қамтамасыз етеді.
4. Ақылды таймер: сеанс дәл 10 минутқа созылады, содан кейін патч өздігінен өшеді.
5. Дербестік: қораптың толық заряды патчтарды 10 рет толық зарядтауға жетеді, ал бір патч үздіксіз 60 минутқа дейін жұмыс істейді.

6. Қос тиімділік: зарядтау қорабында 2 тәуелсіз патч бар. Оларды беттің әртүрлі мәселелі аймақтарына (мысалы, симметриялы әжімдерге немесе бірнеше қабынуға) бір уақытта қолданып, процедура уақытын екі есе қысқартуға болады. Немесе кезектестіріңіз: бір патч зарядталып, залалсызданып жатқанда екіншісі жұмысқа дайын тұрып, үздіксіз күтімді қамтамасыз етеді.
7. Алып жүруге ыңғайлы: патчтарды жолда сақтап, зарядтаңыз. Ықшам жабық қорап сөмкеде құрылғыларды сыртқы зақымнан қорғайды.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ:
1. Зарядтау қорабынан кез келген патчты алыңыз.
2. Жабысқақ жапсырманы құрылғының артқы жағына жабыстырыңыз.
3. Жапсырманың қорғаныш үлдірін алып, патчты өңделетін жердің таза терісіне қойыңыз. Теріге жабысуы үшін басыңыз.
4. Қосу үшін патчтың алдыңғы жағындағы батырманы басыңыз.
5. Құрылғы 10 минуттан кейін автоматты түрде өшеді (немесе мәжбүрлеп өшіру үшін батырманы қайта басыңыз).
6. Сеанстан кейін пайдаланылған жапсырманы ажыратып, қоқысқа тастаңыз.
7. Зарядтау және автоматты залалсыздандыру үшін патчты батырмасын артқа, зарядтау түйіспелерін төмен қаратып сымсыз қорапқа қайта салыңыз (дұрыс қосылса, жасыл индикатор жанады).

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Сезімталдық сынағы. Маңызды: процедура алдында сынақ міндетті. Қосулы патчты білектің ішкі жағына 10 минут қойыңыз. Ыстық немесе жайсыздық сезілсе, құрылғыны дереу алыңыз. 6 сағаттан кейін реакцияны бағалаңыз. Тері қызарса немесе қышыса, патчтарды қолдану сізге жарамайды.
2. Күнделікті қолдану: сеанс алдында теріні тазалаңыз. Күтім құралдарын жақпаңыз.
3. Патчты мәселелі аймаққа бекітіп, қосыңыз.
4. Бір сеанста бір аймаққа әсер етуді 10 минуттан асыру ұсынылмайды.
5. Аяқтағаннан кейін әдеттегі күтім немесе ылғалдандыру құралын жағыңыз.

ҚОЛДАНУ ЖИІЛІГІ МЕН ҰЗАҚТЫҒЫ:

LED КҮТІМІН ЖАҢА БАСТАҒАНДАРҒА: қажетті әсерге жеткенше патчты мәселелі аймаққа күнара қолданыңыз.

ТӘЖІРИБЕЛІ ПАЙДАЛАНУШЫЛАРҒА: әсерге жеткенше мәселелі аймаққа күніне 1 рет қолданыңыз.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Жарыққа жоғары сезімталдық: фотосезімталдық туғызатын аурулар (мысалы, қызыл жегі немесе фотодерматоз) болса, құрылғыны қолдануға тыйым салынады.
2. Белгілі дәрілер мен косметика: жарыққа сезімталдықты арттыратын дәрілерді қабылдасаңыз немесе косметиканы қолдансаңыз, патчтарды қолданбаңыз. Оларға ретиноидтар, кейбір антибиотиктер және цитрус эфир майлары жатады.
3. Тері зақымдары: ашық жара немесе терең кесік бар аймақтарға қолданбаңыз.
4. Процедураны көтере алмау: білектегі алдын ала сынақтан кейін тері қызарса немесе қыши бастаса, құрылғы сізге жарамайды.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ:
1. Құрғақ қол: қолданар алдында қолыңыз толық құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
2. Көруді қорғау: патч қосулы кезде жарық көзіне ұзақ тікелей қарамаңыз.
3. Жайсыздықта тоқтату: процедура кезінде тітіркену сезілсе, қолдануды дереу тоқтатыңыз.
4. Ылғалдан қорғау: патчтар судан қорғалмаған. Оларды сумен жумаңыз және ылғалды ортада (мысалы, жуынатын бөлмеде) қолданбаңыз.
5. Қауіпсіз зарядтау: зарядтау қорабын желіге ұзақ қосулы қалдырмаңыз. 100% зарядқа жеткенде бірден ажыратыңыз. Құрылғыны розеткаға қосулы кезде қолданбаңыз.
6. Тазалау: әр қолданудан кейін патчтың жұмыс бетін жұмсақ, түксіз майлықпен абайлап сүртіңіз. Агрессивті залалсыздандырғыштарды немесе жанғыш заттарды қолданбаңыз.

ЖИНАҚ ҚҰРАМЫ: (1) зарядтау қорабы ×1, 2) патчтар ×2, 3) патчты бекіту жапсырмалары ×32, 4. Dual Type C зарядтау кабелі ×1, 5) пайдалану нұсқаулығы ×1.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

ӨЛШЕМІ (Б × Е × Т): 35×58×20 mm (қорап), 21×21×5 mm (патч)

ҚУАТ КӨЗІ: литий-ионды аккумулятор

ЖҰМЫС КЕРНЕУІ: 3,6 V

ҚОРЕК КЕРНЕУІ: 5 V

ҚУАТЫ: 0,09 W

АККУМУЛЯТОР СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ: 200 mAh (қорап), 18 mAh (патч)

ЗАРЯДТАУ УАҚЫТЫ: 1,5 h

АҚЫЛДЫ ТАЙМЕР: 10 min

ЕҢ ҰЗАҚ СЫМСЫЗ ЖҰМЫС УАҚЫТЫ: Патчты 10 рет толық зарядтау (қораптың 1 зарядынан), 60 минут үздіксіз жұмыс (1 патч)

LED САНЫ: Патчта 1 шам

ТОЛҚЫН ҰЗЫНДЫҒЫ:
• Аралас: қызыл 630 nm + көк 415 nm
Қорап функциясы: автоматты UVC залалсыздандыру - 275 nm

СӘУЛЕЛЕНУ ҚАРҚЫНДЫЛЫҒЫ:
• Аралас спектр - 36.36 mW/cm2



LED SET - БЕТ, МОЙЫН ЖӘНЕ ДЕКОЛЬТЕГЕ АРНАЛҒАН ФОТОТЕРАПИЯ

Бет реңін жақсартады

Әжімдерді тегістейді

Безеу мен безеуден кейінгі іздерді азайтады

Қан айналымын жақсартады

Пигментацияны азайтады

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: терінің қартаю белгілері, фотоқартаю, пигментация мен гиперпигментация, безеу, безеуден кейінгі іздер, купероз, розацеа және басқа тамырлық зақымдар.

МАТЕРИАЛДАРЫ: силикон, ABS пластигі.

САЛМАҒЫ: Бет маскасы 380 g + мойын маскасы 210 g.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
LED SET жарықдиодты терапия қағидасымен жұмыс істейді. Маскаларға LED шамдары орнатылған; әрқайсысы белгілі бір түсті жарық шығаруға бағдарламаланған. Әр түс көрінетін жарық спектріндегі белгілі бір толқын ұзындығына сәйкес келеді. Жарық терінің әртүрлі тереңдігіне әсер етіп, рецепторларға сіңеді, жасуша ішіндегі табиғи процестерді белсендіріп, терінің белгілі реакциясын туғызады.

Ең үлкен толқын ұзындығына ие қызыл LED жарығы барлық ұсынылған шамдарға қарағанда теріге тереңірек енеді. Ол коллаген өндірісін ынталандыратын фибробласттарға әсер етеді және сол арқылы терінің қалпына келуін қамтамасыз етеді. Қызыл LED жарығымен терапия нәтижесінде жараның жазылуы жеделдетіледі, тері тартылады, әжімдер сияқты терінің қартаюының сыртқы белгілері азаяды.

Көк LED жарығы көрінетін спектрдің барлық түстерінің ішіндегі ең қысқа толқын ұзындығына ие. Микробқа қарсы әсері бар эпидермис деңгейінде жұмыс істейді. Порфириндер (біздің денеміздегі пигменттер) көк LED жарығын сіңіріп, синглетті оттегі молекулаларын босатып, тері бетінде тұратын безеу бактерияларын өлтіреді. Осылайша көк LED жарығы дезинфекциялайды, қабыну түзілімдерін азайтады, безеумен күреседі.

Жасыл LED жарығы эпидермис пен дермиске сіңіп, жасушалық реакцияны тудырады, оның салдары арасында теріні қалпына келтіру және емдеу бар. Ол қызаруды азайту, сезімтал терінің тітіркенуін жеңілдету үшін қолданылады. Жасыл LED жарығы капиллярлардың мөлшерін азайтып, қанның еркін ағымына ықпал ететін куперозбен күреседі.

ҚОЛДАНУ ЖИІЛІГІ МЕН ҰЗАҚТЫҒЫ:
Сары LED жарығы (қызыл + жасыл) - қан айналымын ынталандыру үшін қолданылады, тері өңін жеңілдетуге, пигментац
жарық (қызыл + көк + жасыл = ақ) - косметиканың тез және терең енуі үшін қолданылады. Сонымен қатар, ол денеге жа
әсер етеді.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:
1. Әсер ету аймағы: 2 маска күтім қажет 3 аймақты қамтиды.
2. Ортақ пульт: екі маска 1 пультпен басқарылады.
3. Көпфункциялы қолдану: маскаларды жинақ ретінде (2 масканы бір уақытта) де, бөлек те қолдануға болады.
4. Қолмен басқару режимі масканың жеке сеансын баптауға мүмкіндік береді.
5. Маска материалы - тағамдық силикон: теріге қауіпсіз және тітіркендірмейді.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ:
1. Маскаларды Type C кабелімен басқару пультіне жалғаңыз. Кабельдің әр ұшын маска ұясына тән шертілген дыбыс естілгенше толық енгізіңіз.
2. Құрылғыларды қосу үшін пульттегі қосу/өшіру батырмасын 2 секунд басып тұрыңыз.
3. Ауыстыру түймелерін (↑/↓) қысқа басу (1 секунд) көк LED жарығы режиміне (басқару тақтасындағы индикатор C: B), жасыл LED жарығы режиміне (индикатор C: G), сары LED жарығы режиміне (индикатор C: RG), ақ жарық режиміне (C индикаторы: RGB) ауысуға мүмкіндік береді.
4. Жарық қарқындылығын реттеу батырмаларын (-/+) қысқа басу (1 секунд) деңгейді 3-ке дейін арттырады немесе 1-деңгейге қайтарады (пульттегі L: 1 (2/3) индикаторы).
5. Үзіліс батырмасын қысқа басу (1 секунд) құрылғылардың жұмысын уақытша тоқтатады; қайта басу жұмысын жалғастырады.
6. Маскаларды өшіру үшін пульттегі қосу/өшіру батырмасын 2 секунд басып тұрыңыз.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Масканы алғаш қолданар алдында нұсқаулыққа сәйкес «Сезімталдық сынағын» жасаңыз.
2. Басқару пультін маскаларға жалғаңыз.
3. Бет маскасын және мойын мен декольте маскасын киіңіз.
4. Маскаларды қосып, қажетті жарық режимі мен қарқындылығын таңдаңыз.
5. Фототерапия процедурасынан ләззат алыңыз.
6. Әр жарық режимі 15 минут жұмыс істейді, содан кейін пульт автоматты түрде өшеді. Режим ауысқанда таймер қайта басталады. Маңызды: бір сеанста бірнеше режим қолданғанда жалпы фототерапия уақыты 15 минуттан аспауын мұқият бақылаңыз.
7. LED терапиясынан кейін күтім құралын - сарысу немесе крем қолданыңыз: LED терапиясынан кейін терінің сіңіру қабілеті артады.

ТЕРІ ТҮРІ / МӘСЕЛЕ	ТӘУЛІК УАҚЫТЫ	ҰЗАҚТЫҒЫ МЕН РЕТІ	ЖИІЛІГІ	ПРОЦЕДУРАЛАР КУРСЫ
БЕЗЕУ / ҚАБЫНУ / МАЙЛЫ ТЕРІ	Таңертең / кешке	1-апта: көк, төмен - 3 минут; сары, төмен - 3 минут; қызыл, төмен - 3 минут; жасыл, төмен - 3 минут; аралас, төмен - 3 минут. 2-апта: көк, орташа - 4 минут; сары, орташа - 3 минут; қызыл, орташа - 2 минут; жасыл, орташа - 3 минут; аралас, орташа - 3 минут. 3-апта: көк, жоғары - 3 минут; сары, жоғары - 3 минут; қызыл, жоғары - 3 минут; жасыл, жоғары - 3 минут; аралас, жоғары - 3 минут. 4-апта: көк, жоғары - 5 минут; сары, жоғары - 3 минут; қызыл, жоғары - 2 минут; жасыл, жоғары - 3 минут; аралас, жоғары - 2 минут.	Күнара	Бағдарламаны 2-3 ай бойы қайталаңыз. Әр 6 ай сайын бір рет.
ҰСАҚ ӘЖІМДЕР / ЖАСҚА БАЙЛАНЫСТЫ ӨЗГЕРІСТЕР		Көк, жоғары - 2 минут. Сары, жоғары - 3 минут. Қызыл, жоғары - 5 минут. Жасыл, жоғары - 3 минут. Аралас, жоғары - 2 минут.	Аптасына 2-3 рет	Курс ұзақтығы шектелмеген
КӨРІНЕТІН ТАМЫРЛАР / КУПЕРОЗ / СЕЗІМТАЛ ТЕРІ	Кешке	1-апта: көк, төмен - 1 минут; қызыл, төмен - 3 минут; жасыл, орташа - 3 минут; сары, орташа - 3 минут; аралас, орташа - 5 минут. 2-апта: көк, төмен - 1 минут; қызыл, орташа - 3 минут; жасыл, жоғары - 3 минут; сары, жоғары - 3 минут; аралас, жоғары - 5 минут. 3-апта: көк, төмен - 2 минут; қызыл, жоғары - 5 минут; жасыл, жоғары - 2 минут; сары, жоғары - 3 минут; аралас, жоғары - 3 минут. 4-апта: үзіліс.	Күнара	Үзілісті қосқанда 1 ай. 1 апта үзіліс жасаңыз. Төрт апталық 2-3 курс өткізіп, 1 ай үзіліс жасаңыз. Төрт апталық 2-3 курсты қайталап, осы циклді жалғастырыңыз.

ТЕРІ ТҮРІ / МӘСЕЛЕ	ТӘУЛІК УАҚЫТЫ	ҰЗАҚТЫҒЫ МЕН РЕТІ	ЖИІЛІГІ	ПРОЦЕДУРАЛАР КУРСЫ
ПИГМЕНТАЦИЯ / БІРКЕЛКІ ЕМЕС ТЕРІ РЕҢІ	Кешке	Қызыл, жоғары - 5 минут. Сары, жоғары - 3 минут. Жасыл, жоғары - 2 минут. Көк, төмен - 1 минут. Аралас, орташа - 4 минут.	Аптасына 2-3 рет	Курс ұзақтығы шектелмеген. Қолданғаннан кейін SPF кремін жағыңыз.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Сәбилерге, эпилепсиясы, қалқанша без аурулары бар немесе қалқанша безге арналған дәрі қабылдайтын адамдарға құрылғыны қолдануға тыйым салынады.
2. Терісі зақымдалған, жарақаттанған немесе операциядан кейінгі жаралары бар адамдарға маскаларды қолдануға тыйым салынады.

ЕСКЕРТУЛЕР:
1. Құрылғы тек үйде қолдануға арналған.
2. Маскалардың бірі зақымдалса, қауіпті болдырмау үшін қолдануды тоқтатып, тұтынушылардың шағымдарын қабылдауға уәкілетті ұйымға хабарласыңыз.
3. Маскаларды зарядтау кезінде қолдануға тыйым салынады. Зарядтау кезінде маскаларды, зарядтау кабелі мен USB адаптерін дымқыл қолмен ұстамаңыз.
4. Масканы қолданудан жайсыздық немесе жағымсыз реакция (терінің қызаруы, қышу, аллергия) пайда болса, дереу тоқтатыңыз.

ЖИНАҚ ҚҰРАМЫ: (1) бет маскасы, (2) мойын мен декольтеге арналған фототерапия маскасы, (3) Type C пультіне жалғау кабелі, (4) басқару пульті,
5. Type C-USB зарядтау кабелі, 6) нұсқаулық, 7) сақтау қаптары, 8) мойын маскасының 2 бауы.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:
ЗАРЯДТАУ УАҚЫТЫ: 4 h

ЖҰМЫС УАҚЫТЫ: 30 минут (2 маска бір уақытта ең жоғары қарқындылықта жұмыс істегенде)

АҚЫЛДЫ ТАЙМЕР: 15 min

РЕЖИМДЕР:
• Қызыл LED жарығы - толқын ұзындығы 660 нм
• Көк LED жарығы - толқын ұзындығы 415 нм
• Жасыл LED жарығы - толқын ұзындығы 525 нм
• Сары LED жарығы - қызыл + жасыл
• Аралас жарық (ақ) - қызыл + көк + жасыл

МЕНШІКТІ ҚУАТЫ (СӘУЛЕЛЕНУ ҚАРҚЫНДЫЛЫҒЫ):
LED MASK 1-деңгейі
• Қызыл LED жарығы - 5.455 mW/cm2
• Көк LED жарығы - 12.065 mW/cm2
• Жасыл LED жарығы - 8.582 mW/cm2
Сары LED жарығы - 13.012 mW/cm2
• Аралас жарық - 21.826 mW/cm2

LED NECK MASK
• Қызыл LED жарығы - 5.171 mW/cm2
• Көк LED жарығы - 10.707 mW/cm2
• Жасыл LED жарығы - 6.413 mW/cm2
• Сары LED жарығы - 11.888 mW/cm2
• Аралас жарық - 18.059 mW/cm2. 2-деңгей (LED MASK)
• Қызыл LED жарығы - 12.155 mW/cm2
• Көк LED жарығы - 23.541 mW/cm2
• Жасыл LED жарығы - 12.757 mW/cm2
• Сары LED жарығы - 16.86 mW/cm2
• Аралас жарық - 26.797 mW/cm2 (LED NECK MASK)
• Қызыл LED жарығы - 9.759 mW/cm2
• Көк LED жарығы - 25.02 mW/cm2
• Жасыл LED жарығы - 13.664 mW/cm2
Сары LED жарығы - 16.725 mW/cm2
• Аралас жарық - 25.447 mW/cm2. 3-деңгей (LED MASK)
• Қызыл LED жарығы - 15.94 mW/cm2
• Көк LED жарығы - 33.06 mW/cm2
• Жасыл LED жарығы - 17.461 mW/cm2
• Сары LED жарығы - 20.607 mW/cm2
Аралас жарық - 29.321 mW/cm2 (LED NECK MASK)
• Қызыл LED жарығы - 15.275 mW/cm2
Көк LED жарығы - 31.849 mW/cm2
• Жасыл LED жарығы - 16.986 mW/cm2
• Сары LED жарығы - 19.561 mW/cm2
• Аралас жарық - 30.183 mW/cm2

15 МИНУТТЫҚ СЕАНСТАҒЫ ЭНЕРГИЯ ДОЗАСЫ (ЭНЕРГИЯ СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ):
LED MASK 1-деңгейі
• Қызыл LED жарығы - 4.9095 J/cm2
• Көк LED жарығы - 10.8585 J/cm2
• Жасыл LED жарығы - 7.7238 J/cm2
• Сары LED жарығы - 11.7108 J/cm2
Аралас жарық - 19.6434 J/cm2 (LED NECK MASK)
• Қызыл LED жарығы - 4.6539 J/cm2
• Көк LED жарығы - 9.6363 J/cm2
• Жасыл LED жарығы - 5.7717 J/cm2

• Сары LED жарығы - 10.6992 J/cm2
• Аралас жарық - 16.2531 J/cm2. 2-деңгей (LED MASK)
• Қызыл LED жарығы - 10.9395 J/cm2
• Көк LED жарығы - 21.1869 J/cm2
• Жасыл LED жарығы - 11.4813 J/cm2
• Сары LED жарығы - 15.174 J/cm2
Аралас жарық - 24.1173 J/cm2 (LED NECK MASK)
• Қызыл LED жарығы - 8.7831 J/cm2
• Көк LED жарығы - 22.518 J/cm2
• Жасыл LED жарығы - 12.2976 J/cm2
• Сары LED жарығы - 15.0525 J/cm2
• Аралас жарық - 22.9023 J/cm2. 3-деңгей (LED MASK)
Қызыл LED жарығы - 14.346 J/cm2
• Көк LED жарығы - 29.754 J/cm2
• Жасыл LED жарығы - 15.7149 J/cm2
• Сары LED жарығы - 18.5463 J/cm2
• Аралас жарық - 26.3889 J/cm2 (LED NECK MASK)
• Қызыл LED жарығы - 13.7475 J/cm2
• Көк LED жарығы - 28.6641 J/cm2
• Жасыл LED жарығы - 15.2874 J/cm2
• Сары LED жарығы - 17.6049 J/cm2
• Аралас жарық - 27.1647 J/cm2

СУДАН ҚОРҒАНЫСЫ: IP22



МАМІ - БЕТ ПЕН МОЙЫНҒА АРНАЛҒАН ЛИФТИНГ МАССАЖЕРІ

Тері тонусын жақсартады

Бет лифтингі

Әжімдерді тегістейді

Ісінуді азайтады

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: жасқа байланысты көрінетін өзгерістер, фотоқартаю, салбыраған ұрт, беттің өңсіз реңі, безеу, пигментация, кеңейген тері тесіктері, ісіну және тері серпімділігінің төмендеуі.

МАТЕРИАЛДАРЫ: ABS пластигі, мырыш қорытпасы, тот баспайтын болат.

САЛМАҒЫ: Массажер - 179 g, база - 108 g.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:

EMS - бұлшықеттерді миостимуляциялауға арналған электр тогы. Ол тері қабаттарына терең еніп, бұлшықет қабатына жетеді. Бұлшықеттердің жиырылуын ынталандыру арқылы EMS теріні тартып, лифтинг әсерін береді, коллаген мен эластиннің түзілуін арттырады, терінің серпімділігі мен созылғыштығын жақсартады, ісінуді азайтады.

3 түсті фототерапия: көрінетін спектрдің әртүрлі толқын ұзындығындағы қызыл, көк және аралас жарықтары теріге еніп, қалпына келу процестерін іске қосады. Ең таяз енетін көк LED жарығы тері бетінде жұмыс істеп, залалсыздандырады және қабынуды азайтады. Ең терең енетін қызыл LED жарығы коллаген түзетін фибробласттарға әсер етіп, жасартуға және қартаю белгілерімен күресуге қолданылады. Қызыл және көк LED жарықтарын біріктіру екі қызметті үйлестіріп, қабынуға тиімді әсер етеді.

Діріл - теріге механикалық әсер ету. Ол барлық зат алмасу процестерін күшейтіп, теріні тартады, көрінетін әжімдерді азайтады.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:
1. Жайлы әсер деңгейін таңдауға арналған 3 EMS қарқындылық деңгейі.
2. Ток көзі ретінде 2 электрод.
3. Доға тәрізді жұмыс пішіні дене иілімдерін қайталайды; массажерді екі аймаққа - бет пен мойынға қолдануға болады.
4. Қолмен басқару режимі: режимдер мен әрқайсысының жұмыс уақытын өзіңіз белгілеп, жеке комбинация жасайсыз.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ:
1. Құрылғыны қосу немесе өшіру үшін қуат (POWER) батырмасын басып тұрыңыз.
2. Фототерапия жарығын таңдау үшін POWER батырмасын қысқа басыңыз. Алдымен көк LED жарығы автоматты түрде қосылады. Қайта басқанда қызыл LED жарығы таңдалады. Аралас жарық режимін қосу үшін POWER батырмасын тағы басыңыз.
3. Массажер қосылғаннан кейін деңгей (LEVEL) батырмасын қысқа басып, EMS қарқындылығын әлсізден күштіге дейін таңдаңыз. Әлсіз деңгейде 1 индикатор жанады

(Low). Орташа деңгейде 2 индикатор (Low + Medium), күшті деңгейде 3 индикатор (Low + Medium + High) жанады.
4. LEVEL батырмасын ұзақ басып, дірілді қосыңыз. Дәл солай ұзақ басу дірілді өшіреді.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Макияжды кетіріп, бетті тазартқышпен жуыңыз.
2. Теріге күтім құралын біркелкі жағыңыз (су негізіндегі гель тәрізді құрылым ең жақсы нәтиже үшін токтың барынша өтуін қамтамасыз етеді).
3. Құрылғыны қосып, фототерапия режимін таңдаңыз.
4. EMS қарқындылық деңгейін реттеңіз.
5. Құрылғының массаж бетін бет терісіне тигізіп, массаж сызықтарымен жылжытыңыз. Төменнен (иектен) жоғары (маңдайдағы шаш өсу сызығына) қарай жүріңіз.
6. Барлық массаж сызықтары бойымен процедураны үш рет қайталаңыз. Құрылғымен 10 минуттан артық жұмыс істеу ұсынылмайды.
7. Массаждан кейін құрылғыны өшіріп, массаж бетін тазалау майлығымен сүртіңіз.

ҚОЛДАНУ ЖИІЛІГІ МЕН ҰЗАҚТЫҒЫ:

ТЕРІ ТҮРІ / МӘСЕЛЕ	ТӘУЛІК УАҚЫТЫ	ҰЗАҚТЫҒЫ МЕН РЕТІ	ЖИІЛІГІ	КУРС
БЕЗЕУ / ҚАБЫНУ	Тәуліктің кез келген уақытында	LED: көк LED - 5 минут; қызыл LED - 2 минут. EMS: орташа қарқындылық - 5-7 минут. Режимдерді бір уақытта емес, көрсетілген ретпен қолданыңыз.	Күнара	2 апта. 3-4 күн үзіліс. 2 апта. Жылына 4-5 апталық курс.
ҰСАҚ ӘЖІМДЕР / ҚҰРҒАҚ ТЕРІ / ПИГМЕНТАЦИЯ / БІРКЕЛКІ ЕМЕС ТЕРІ РЕҢІ	Кешке	LED: қызыл LED - 7 минут; аралас жарық - 5 минут. EMS: төмен қарқындылық - 5 минут; орташа - 3 минут; ең жоғары (тығыз теріге) - 3 минут. LED және EMS режимдерін бір уақытта қолдануға болады.	Аптасына 2 рет	3-4 апта. 1 апта үзіліс. 4 апталық курсты қайталаңыз. Әрі қарай тұрақты түрде қайталаңыз.
КӨРІНЕТІН ТАМЫРЛАР / КУПЕРОЗ / СЕЗІМТАЛ ТЕРІ	Кешке	LED: қызыл LED - 7 минут; аралас жарық - 5 минут. Діріл: 5 минут. Купероз кезінде EMS режимін қолдануға болмайды. Режимдерді бір уақытта емес, көрсетілген ретпен қолданыңыз.	Аптасына 2 рет	4 апта. 1 апта үзіліс. 4 апталық курсты қайталаңыз. Әрі қарай тұрақты түрде қайталаңыз.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Соңғы екі аптада косметикалық немесе химиялық пилинг, лазерлік тегістеу, фракциялық лазерлік жасарту, мезотерапия не дермалық филлер енгізу жасалып, тері жазылу кезеңінде болса, құрылғыны қолданбаңыз.
2. Құрылғы 12 жасқа толмаған адамдарға арналмаған.
3. Құрылғы дене, сезу және ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдарға арналмаған.
4. Құлақ денсаулығына қатысты мәселелер (сыртқы отит, құлақ инфекциясы, басқа аурулар) болса, құрылғыны қолданбаңыз.
5. Массажерді жарылған теріге, ашық жараларға, мәселелі немесе тітіркенген теріге (ауыр безеу, күнге күю, инфекция және т.б.) қолданбаңыз.
6. Көз айналасындағы сезімтал аймаққа қолданбаңыз: ол жердің терісі жұқа әрі нәзік.
7. Шырышты қабықтарға (мысалы, мұрынның, ауыздың ішіне, жыныс мүшелерінің аймағына) қолданбаңыз: жергілікті тітіркену туғызуы мүмкін.

ЕСКЕРТУЛЕР:
1. Зарядтау ұясы мен USB сымын құрғақ ұстаңыз.
2. Құрылғыны ылғалды ортада зарядтамаңыз (мысалы, суы бар ванна, жұмыс істеп тұрған душ немесе су толы бассейн жанында).
3. Құрылғыны тек осы массажермен бірге берілген USB кабелімен қолданыңыз.
4. USB кабелі зақымдалса, қауіпті болдырмау үшін тек түпнұсқа сыммен ауыстырыңыз.
5. Аккумулятор қызметін ұзарту үшін массажерді кемінде әр 2 ай сайын 100%-ға дейін толық зарядтаңыз.

ЖИНАҚ ҚҰРАМЫ: (1) массажер, (2) тұғыр-база, (3) USB-C зарядтау кабелі, 4. нұсқаулық, (5) майлық, (6) қап.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

НОМИНАЛДЫ ЖҰМЫС КЕРНЕУІ: 5-9 V

НОМИНАЛДЫ ҚОРЕК КЕРНЕУІ: 3,7 W

ҚУАТ КӨЗІ: литий-ионды

АККУМУЛЯТОР СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ: 900 mAh

ӨЛШЕМДЕРІ: 147.1×83×44.4 mm (құрылғы), 57.1×57.1×76 mm (тұғыр)

САЛМАҒЫ: Құрылғы - 179 g, тұғыр - 108 g

ЗАРЯДТАУ УАҚЫТЫ: 3 h

ЖҰМЫС УАҚЫТЫ: Қызыл LED жарығы/Көк LED жарығы режимі - 200 минут Аралас жарық режимі - 300 минут

СӘУЛЕЛЕНУ ҚАРҚЫНДЫЛЫҒЫ:
Қызыл LED жарығы - 7.7867 mW/cm2
• Көк LED жарығы - 32.758 mW/cm2
• Аралас жарық - 23.322 mW/cm2

EMS:
• 1-деңгей - 0.08 mA
• 2-деңгей - 0.11 mA
• 3-деңгей - 0.13 mA

ТОК ЖИІЛІГІ: 34,7 kHz

ТОЛҚЫН ҰЗЫНДЫҒЫ: Қызыл LED жарығы - 625 нм - көк LED жарығы - 465 нм

ТОЛҚЫН ПІШІНІ: екі фазалы симметриялы

СУДАН ҚОРҒАНЫСЫ: IPX4



MEI1 - БЕТ ПЕН МОЙЫНҒА АРНАЛҒАН EMS МАССАЖЕРІ

V пішінді лифтинг

Ісінуді азайтады

Контурларды қалыптастырады

Қатпарлар мен әжімдерді тегістейді

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: серпімділіктің төмендеуі және бет контурының көмескіленуі, таңертеңгі ісіну, бұлшықет түйілуі мен қысылуы, жасқа байланысты өзгерістер (әжімдер), беттің өңсіз реңі, күнделікті косметиканың нашар сіңуі.

МАТЕРИАЛЫ: ABS пластигі.

САЛМАҒЫ: 78 g.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
Құрылғы тіндердің барлық қабатына өзара үйлескен
4 технология арқылы кешенді әсер етеді:

EMS ағзаның табиғи биоэлектрлік сигналдарын қайталап, бет бұлшықеттерін жұмсақ жиырылтады және жаттықтырады, тонусын қалпына келтіреді.

Терең қыздыру (42 °C): жылулық әсер түйілген бұлшықеттерді босаңсытып, микроайналымды күшейтеді.

ТОЛҚЫНДЫ ДІРІЛ (минутына 8500 айналым): жоғары жиілікті механикалық тербелістер қуатты лимфа дренажын қамтамасыз етіп, ісіну мен тіндердегі сұйықтық іркілісін азайтады.

ИОНДЫҚ ЕНГІЗУ (ионофорез): қыздырумен бірге бұл технология күтім сарысуының белсенді құрамдастарын дерманың терең қабаттарына жеткізіп, тиімділігін еселейді.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:
1. Ойластырылған 360° дизайн: корпустың барлық жағы - белсенді жұмыс беті. Жоғарғы бөлігі (роликтер) 3D массажға, бүйір қырлары гуаша массажына, төменгі шығыңқы бөлігі нүктелі массажға арналған.
2. 1 құрылғыда 4 технология: EMS, толқынды діріл, қыздыру және ионофорез.
3. 2 жұмыс режимі: таңертеңгі лимфа дренажы мен тонусқа арналған негізгі режим (ақ индикатор); кешкі қарқынды жасарту күтімі мен босаңсытуға арналған қыздырумен кешенді режим (қызыл индикатор).
4. Ақылды таймер: қауіпсіздік үшін құрылғы 10 минут үздіксіз жұмыстан кейін автоматты түрде өшеді, ал 2 минут әрекетсіз тұрса, ұйқы режиміне өтеді.
5. Ықшамдық және дербестік: кірістірілген 800 mAh аккумулятор бір зарядпен 80 минутқа дейін үздіксіз қолдануға мүмкіндік береді.

6. Әмбебап қолдану: массажер құрылымы оны нүктелі, роликті және лифтинг күтіміне, сондай-ақ мойынға, иыққа, қолға және аяққа массаж жасауға қолдануға мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ:
1. Құрылғыны қосу немесе өшіру үшін қуат батырмасын 1-2 секунд басып тұрыңыз (дыбыстық белгі естіледі).
2. Алғашқы қысқа басу (әдепкі режим): EMS, діріл және иондық енгізу қосылады. Индикатор сақинасы ақ түспен жанады. Таңертеңгі ісінуді азайтуға және тонусқа өте қолайлы.
3. Екінші қысқа басу (кешенді режим): алдыңғы технологияларға терең қыздыру қосылады. Индикатор қызыл түспен жанады. Қарқынды лифтинг пен босаңсытуға жарайды.
4. Зарядтау кезінде индикатор қызыл LED жарығымен біркелкі жыпылықтайды және 100% жеткенде ол үздіксіз жанып тұрады.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. EMS жұмыс істеуі үшін тазаланған теріге ток өткізетін гельді, ылғалдандыратын сарысуды немесе тек су негізіндегі эссенцияны молынан жағу қажет. Күтім құралының құрамында майлар мен қышқылдар (AHA, BHA, PHA қышқылдары, ретинол, жоғары концентрациялы С дәрумені) болмауы тиіс.
2. Құрылғыны қосып, қажетті режимді таңдаңыз.
3. Таңдалған жұмыс бетін теріге тығыз тигізіп, массаж сызықтарымен массаж жасаңыз. Құрылғыны бірқалыпты жылдамдықпен, баяу әрі артық қысымсыз жылжытыңыз.
4. 10 минут жұмыстан кейін ақылды таймер құрылғыны автоматты түрде өшіреді.
5. Массажерді дымқыл майлықпен сүртіңіз (ылғалдан қорғаныс дәрежесі IPX3: ағын сумен жууға тыйым салынады).

ҚОЛДАНУ ЖИІЛІГІ МЕН ҰЗАҚТЫҒЫ:

ТЕРІ ТҮРІ / МӘСЕЛЕ	ТӘУЛІК УАҚЫТЫ	ҰЗАҚТЫҒЫ МЕН РЕТІ	ЖИІЛІГІ	КУРС
ТЫҒЫЗ, ІСІНГЕН ТЕРІ	Кешке, күннің 2-жартысында	«EMS, діріл, иондық енгізу» режимі - 3-5 минут; «EMS, діріл, иондық енгізу, қыздыру» режимі - 5 минут	Аптасына 2-3 рет	Емдеу курсы: 10 апта. Үзіліс: 2 апта. 10 апталық курсты тұрақты түрде қайталаңыз.
ҰСАҚ ӘЖІМДЕРІ БАР ҚҰРҒАҚ ТЕРІ	Таңертең	«EMS, діріл, иондық енгізу» режимі - 3-4 минут; «EMS, діріл, иондық енгізу, қыздыру» режимі - 3-4 минут	Аптасына 1-2 рет	Емдеу курсы: 10 апта. Үзіліс: 2 апта. 10 апталық курсты тұрақты түрде қайталаңыз.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Кардиостимуляторы, остеопорозы, температура/ауырсыну сезімталдығының жоғалуы және тері аурулары бар адамдарға қолдануға тыйым салынады.
2. Кесілген жерлерге, пластикалық операциядан кейінгі аймақтарға, іріңді немесе қабынған теріге, көз алмаларына, қабақтарға және қалқанша без аймағына қолданбаңыз.
3. Металл протездер орналасқан аймақтарға қолданбаңыз.
4. Тіс емдетіп жүрген (немесе пломба/брекеті бар), сондай-ақ металға аллергиясы немесе куперозы (телеангиэктазиясы) бар адамдар сақтықпен қолдануы тиіс.

5. Жүктілік, етеккір, бала емізу, гипертония немесе дене қызуы жоғарылау кезінде тек дәрігермен кеңескеннен кейін қолданыңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ:
1. Құрылғы судан қорғалмаған.
2. Оны суда қолдануға, кран астында жууға немесе жоғары ылғалды жерде (мысалы, жуынатын бөлмеде) сақтауға тыйым салынады.
3. Құрылғыны зарядтау кезінде қолданбаңыз. Сеанс алдында әрдайым желіден ажыратыңыз.
4. Зарядтау немесе қолдану кезінде әдеттен тыс қызу не түтін байқалса, құрылғыны дереу өшіріңіз.
5. Құрылғыны құлатпаңыз және соққылардан қорғаңыз.
6. Құрылғыны тікелей күн сәулесінен алыс, құрғақ, салқын жерде сақтаңыз. Ұзақ уақыт қолданбай сақтағанда аккумуляторды әр 3 ай сайын зарядтаңыз.

ЖИНАҚ ҚҰРАМЫ: (1) массажер, (2) сақтау қабы, (3) Type-C зарядтау кабелі,
4. пайдалану нұсқаулығы.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

ӨЛШЕМІ (Б × Е × Т): 140×80×10 mm

ҚУАТ КӨЗІ: кірістірілген литий аккумуляторы

ЖҰМЫС КЕРНЕУІ: 5 V

ҚУАТЫ: 4,4 W

АККУМУЛЯТОР СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ: 800 mAh

АҚЫЛДЫ ТАЙМЕР: 10 min

ЗАРЯДТАУ УАҚЫТЫ: ≤ 2 h

ЕҢ ҰЗАҚ ЖҰМЫС УАҚЫТЫ (ТОЛЫҚ ЗАРЯДТАН КЕЙІН): 80 min

ТОК КҮШІ: 1,4 mA

ДІРІЛ: минутына 8500 айналым

ҚЫЗДЫРУ ТЕМПЕРАТУРАСЫ: 42 °C

СУДАН ҚОРҒАНЫСЫ: IPX3



MIGA - АУЫЗ ҚУЫСЫНЫҢ ИРРИГАТОРЫ

Қызыл иек ауруларының алдын алуға көмектеседі

Тамақ қалдықтарын кетіреді

Тісжегінің алдын алуға көмектеседі

Ауыздың қиын жететін аймақтарын тазартады

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: тіс қағы, тісжегі, қызыл иек аурулары, ауыздан жағымсыз иіс шығуы.

МАТЕРИАЛЫ: ABS пластигі.

САЛМАҒЫ: 157 g.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:

Сұйықтық ауыз қуысының ең қиын жететін жерлерін тиімді тазалап, тамақ қалдықтарын кетіреді, бұл тісжегінің пайда болуының алдын алады.

Ирригатор жасайтын сұйықтық қысымы қызыл иекке массаж жасап, қан айналымы мен жазылуын ынталандырады.

Тіл мен ұртты су ағынымен тазалау ауыздан жағымсыз иісті кетіруге көмектеседі.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:
1. Ирригатормен бірге 1 стандартты саптама, сақтау қорабы және зарядтау кабелі беріледі.
2. 1 режим.
3. Резервуар көлемі - 70 ml.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ:
1. Алғаш қолданар алдында аккумуляторды толық зарядтаңыз. Ол үшін магниттік зарядтау кабелін ирригатор корпусындағы түйіспелерге жалғаңыз. Зарядтау кезінде құрылғыны қолдануға болмайды.
2. Саптаманы орнату/алу: саптаманы құрылғының жоғарғы қақпағындағы тесікке шертілгенше енгізіңіз. Шертілген дыбыс дұрыс орнатылғанын білдіреді. Алу үшін құрылғының жоғарғы қақпағын басып, сол күйде ұстап тұрып саптаманы шығарыңыз.
3. Резервуарды толтыру: құрылғының өшірулі екеніне көз жеткізіп, резервуар түбіндегі қақпақты ашыңыз да, сумен толтырыңыз.
4. Құрылғыны қосу немесе өшіру үшін қосу/өшіру батырмасын басыңыз. Ескерту: қолдану кезінде индикатор көк түспен тұрақты жанады.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Саптаманы орнатып, құрылғыны жұмыс қалпына келтіріңіз. Ол үшін бір қолыңызбен корпусты ұстап, екінші қолыңызбен су резервуарын төмен тартыңыз.
2. Саптаманы ауызға салып, тіске бағыттаңыз да, құрылғыны қосу үшін қосу/өшіру батырмасын басыңыз. Тазалау кезінде ирригаторды тік ұстаңыз.
3. Жақсы нәтиже үшін тазалауды азу тістерден (артқы тістерден) бастап, алдыңғы тістерге қарай жылжытыңыз. Су ағынын қызыл иекке 90 градус бұрышпен бағыттаңыз. Су шашырамауы үшін аузыңызды кең ашпаңыз.
4. Саптаманы қызыл иек сызығымен жылжытып, қызыл иек қалтасы мен тісаралық кеңістік тазаланғанша әр тісте қысқа кідіріңіз.
5. Тазалаудан кейін қосу/өшіру батырмасымен құрылғыны өшіріп, резервуардағы суды төгіңіз. Ол үшін қақпақты ашып, суды ағызыңыз да, ирригаторды бастапқы қалпына жинаңыз.
6. Ауыз қуысын күніне 2 рет, тамақтан кейін тазалаңыз. Ескерту: алғашқы тазалауда аздап қанау қалыпты, ол бір апта ішінде басылады. Қанау 2 аптадан артық тоқтамаса, құрылғыны қолдануды тоқтатып, тіс дәрігеріне жүгініңіз.

ҚОЛДАНУ ЖИІЛІГІ:
Күніне 2 рет, тамақтан кейін; ортодонтиялық құрылымдарға күтім үшін - әр тамақтан кейін.

ҚОЛДАНУ ҰЗАҚТЫҒЫ:
Шектелмеген.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Пародонтиттің өршуі, ауыз қуысындағы жедел қабыну процестері.
2. Қызыл иектің қатты қанауы.
3. Ауыз қуысына операция жасалғаннан кейінгі алғашқы 2 ай.

ЕСКЕРТУЛЕР:
1. Ирригаторды душта қолданбаңыз, суға батырмаңыз және суға құлау қаупі бар жерге қоймаңыз.
2. Құрылғыны температурасы немесе ылғалдылығы жоғары, сондай-ақ тікелей күн сәулесі түсетін жерге қоймаңыз.
3. Зарядтау кезінде құрылғыны дымқыл қолмен ұстамаңыз және ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
4. Зарядтау кабелін ұқыпты ұстаңыз: жылу көздерінен алыс ұстаңыз, күшпен созбаңыз, бүкпеңіз не бұрамаңыз, қысылып қалуына жол бермеңіз. Бұл кабельді істен шығаруы мүмкін. Ирригатордың өзі немесе кабелі зақымдалса (құлаудан, су кіруден және т.б.), қолданбаңыз және зарядтамаңыз.
5. Ирригаторды тек түпнұсқа зарядтау құралымен зарядтаңыз. Құрылғыда көрсетілгеннен басқа кернеулі желіге қоспаңыз.
6. Құрылғыны саптамасыз қолданбаңыз. Өндіруші ұсынбаған саптамаларды қолданбаңыз.

7. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
8. Ирригаторға бөгде заттарды салмаңыз.
9. Резервуарға су құяр алдында құрылғыны зарядтау кабелінен ажыратыңыз. Толтырғанда суды асырып құймаңыз.
10. Тазалау және қызмет көрсету алдында құрылғының өшірулі және зарядталып жатпағанына көз жеткізіңіз.
ЖИНАҚ ҚҰРАМЫ: (1) сақтау қорабы, (2) ирригатор, (3) саптама, (4) магниттік қосқышы бар USB зарядтау кабелі, (5) нұсқаулық.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

ЗАРЯДТАУ УАҚЫТЫ: 2 сағат артық

ЖҰМЫС УАҚЫТЫ: 20 min

АҚЫЛДЫ ТАЙМЕР: жоқ

РЕЗЕРВУАР ТОЛЫ БОЛҒАНДАҒЫ ЖҰМЫС УАҚЫТЫ: 30 s

ҚУАТЫ: 482,3 kPa

МИНУТЫНА ИМПУЛЬС САНЫ: 900-1100

РЕЗЕРВУАР СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ: 70 ml

СУДАН ҚОРҒАНЫСЫ: IPX7



MIGA BLACK - АУЫЗ ҚУЫСЫНЫҢ ИРРИГАТОРЫ

Қызыл иек ауруларының алдын алуға көмектеседі

Тамақ қалдықтарын кетіреді

Тісжегінің алдын алуға көмектеседі

Ауыздың қиын жететін аймақтарын тазартады

Ортодонтиялық құрылымдарға күтім

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: тіс қағы, тісжегі, ортодонтиялық құрылымдар мен тісаралық кеңістікте тұрып қалған тамақ қалдықтары, қызыл иек аурулары, ауыздан жағымсыз иіс шығуы.

МАТЕРИАЛЫ: ABS пластигі.

САЛМАҒЫ: 183 g.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:

Сұйықтық ең қиын жететін жерлерді тазартып, тісжегінің алдын алуға және ортодонтиялық құрылымдарды тазалауға мүмкіндік береді.

Ирригатор жасайтын сұйықтық қысымы қызыл иекке массаж жасап, қан айналымы мен жазылуын ынталандырады.

Тіл мен ұртты су ағынымен тазалау ауыздан жағымсыз иісті кетіруге көмектеседі.

3 әсер ету режимі мен жинақтағы 4 саптама тамақ қалдықтары мен тіс қағын тиімді кетіріп, тісаралық кеңістіктерді, қызыл иек қалталарын, тілді және ортодонтиялық құрылымдарды тазалайды.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:
1. Жинақта 4 саптама: стандартты, пародонтологиялық, ортодонтиялық және тіл тазалауға арналған.
2. Корпуста саптаманы сақтауға арналған бөлім бар.
3. 3 жұмыс режимі: жұмсақ, импульстік, қуатты.
4. Резервуар көлемі - 140 ml.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ:
1. Саптаманы шертілгенше орнатыңыз.
Ирригатормен бірге әрқайсысының өз қызметі бар 4 түрлі саптама беріледі:
Стандартты саптама тістерді күнделікті тазалауға қолданылады. Иілген ұшы тіс қағы мен тамақ қалдықтарын шайып кетіруге көмектеседі.
Пародонтологиялық саптама қызыл иек қалталарын тазалауға қолданылады (қабынған қызыл иек тістен ажырағанда қалта түзіледі).

Бұл саптаманың қызыл иек күтіміне арналған жұмсақ резеңке ұшы бар.
• Ортодонтиялық саптама брекет жүйелерін тазалауға арналған. Ұшында су өтетін тесіктен бөлек қатты қылшықтары бар щетка орналасқан. Ол ортодонтиялық құрылымдардың құлыптарын тазалап, тіс қағы мен тамақ қалдықтарын шайып кетіреді.
Тіл тазалайтын саптама қасық пішінді. Онымен жұмсақ тіндердегі қақ пен кірді кетіруге болады.
2. Резервуарды ашып, сумен толтырыңыз.
3. Саптаманы ауызға салып, қосу батырмасын қысқа басып, құрылғыны қосыңыз.
4. Режимдерді ауыстыру үшін құрылғы батырмасын ұзақ басыңыз.
Құрылғыда 3 режим бар:
Жұмсақ (жасыл индикатор): төмен қысым, жаңадан бастағандарға және тісі сезімтал адамдарға жарайды;
Импульстік (көк индикатор): өзгермелі пульсациялық қысым, терең тазалау мен қызыл иек массажы үшін күшті және әлсіз режимдер кезектеседі;
Қуатты (ақ индикатор): жоғары қысым, адамдардың көпшілігінің күнделікті қажеттіліктеріне сай тиімді тазалау.
5. Қолданғаннан кейін қысқа басып өшіріңіз. Өшкенде құрылғы соңғы режимді есте сақтап, келесі қосылғанда сол режимде автоматты түрде жұмыс істейді.
6. Саптаманы босату батырмасын басып, абайлап шығарыңыз. Саптамалар бөлімін ашып, ішіне салыңыз.
7. Тұрақты тазалауды ұмытпаңыз: резервуарды ажыратып, жуыңыз. Ескерту: алғаш қолданғанда жұмсақ режимді таңдаңыз. Алғашқы тазалауда аздап қанау қалыпты, бір апта ішінде басылады. Қанау 2 аптадан артық тоқтамаса, құрылғыны қолдануды тоқтатып, тіс дәрігеріне жүгініңіз.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Кәдімгі тазалау үшін стандартты көпфункциялы саптаманы қолданыңыз. Қосу батырмасын басып, қажетті режимді таңдаңыз. Су ағыны өңделетін аймаққа перпендикуляр болатындай саптаманы тіске қарсы қойыңыз. Ескерту: сезімтал қызыл иек оңай қанайды. Ағынды тікелей қызыл иекке бағыттамаңыз. Тісі сезімтал адамдарға жұмсақ режим ұсынылады.
2. Артқы тістерден бастап, алдыңғы тістерге қарай жылжыңыз. Қызыл иек пен тісаралық кеңістік тазаланғанша әр тісте қысқа кідіріп, бүкіл тіс қатарын өтіңіз. Сыртқы жағынан бастасаңыз, ішкі жағында қайталаңыз. Осы ретті жоғарғы және төменгі тіс қатарында орындаңыз.
3. Қызыл иек қалталарын тазалау үшін пародонтологиялық саптаманы қолданыңыз. Қуат батырмасын басып, қажетті режимді таңдаңыз. Саптаманы оның ұшы қызыл иек шеті мен тіс-қызыл иек қалтасына бағытталатындай бұрышпен орналастырыңыз. Жоғарыдағы ұсынымдарға сай тазалаңыз.
4. Тілді тазалау үшін қасық тәрізді саптаманы қолданыңыз. Саптаманы орнатып, қосу батырмасын басыңыз және қажетті режимді таңдаңыз.

Саптаманы тілдің түбінен ұшына қарай бір бағытта сыпыру қозғалыстарымен жүргізіңіз. Тілді тазалау 30 секундқа, шамамен 5 рет жүргізуге созылуы тиіс.
5. Брекет жүйелерін тазалау үшін ортодонтиялық саптаманы қолданыңыз. Су ағыны өтетін тесіктен бөлек, ұшында қатты қылшықтары бар щетка болғандықтан, брекет құлыптарын жақсы тазалап, қақ пен тамақ қалдықтарын шайып кетіреді.

ҚОЛДАНУ ЖИІЛІГІ:
Күніне 2 рет, тамақтан кейін; ортодонтиялық құрылымдарға күтім үшін - әр тамақтан кейін.

ҚОЛДАНУ ҰЗАҚТЫҒЫ:
Шектелмеген.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Пародонтиттің өршуі, ауыз қуысындағы жедел қабыну процестері.
2. Қызыл иектің қатты қанауы.
3. Ауыз қуысына операция жасалғаннан кейін бірнеше апта қолдану ұсынылмайды.
4. Қызыл иек ауруы болса немесе соңғы 2 айда ауыз қуысына операция жасалса, қолданар алдында тіс дәрігерімен кеңесіңіз.

ЕСКЕРТУЛЕР:
1. Зақымдалып, кепілдіктен айырылмау үшін құрылғыны бөлшектемеңіз және бөлшектерін ауыстырмаңыз.
2. Күйіп қалмау үшін ауыз тазалау резервуарына 50 °C-тан ыстық су құймаңыз.
3. Қуат кабелі немесе аша зақымдалса, қолданар алдында ауыстырыңыз. Кабельді созбаңыз, бүкпеңіз не бұрамаңыз. Ауыр заттардың астында немесе заттардың арасында қысылып қалуына жол бермеңіз. Құрылғы мен кабельді жылу көздерінен алыс ұстаңыз.
4. Құрылғыны тек мақсаты бойынша, ауыз қуысын тазалауға қолданыңыз. Зақымдамау үшін тіс пен қызыл иекке қысым түсірмеңіз.
5. Бұзылу, өрт, электр тогының соғуы және басқа қауіптердің алдын алу үшін құрылғыны суға ұзақ батырмаңыз.
6. Құрылғыны ашық от пен жылытқыштардан алыс ұстаңыз.
7. Құрылғыны жуынатын бөлме немесе дәретхана сияқты ылғалды жерде зарядтамаңыз.
8. Ирригаторды саптамасыз қолданбаңыз.
9. Құрылғы балаларға арналмаған. Тек ересектердің бақылауымен қолдануға болады. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
10. Су резервуарына ауыз шаю құралын қоспаңыз: бұл коррозия туғызып, резервуардың корпусқа жабысып қалуына әкеледі және кейін оны ашуды қиындатуы мүмкін.

ЖИНАҚ ҚҰРАМЫ: (1) ирригатор, (2) стандартты саптама, (3) пародонтологиялық саптама, 4. ортодонтиялық саптама, (5) тіл тазалау саптамасы, (6) сақтау қабы, (7) USB-C зарядтау кабелі, (8) нұсқаулық.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

ЗАРЯДТАУ УАҚЫТЫ: 1,5 h

ЖҰМЫС УАҚЫТЫ: 90 min

АҚЫЛДЫ ТАЙМЕР: жоқ

РЕЗЕРВУАР ТОЛЫ БОЛҒАНДАҒЫ ЖҰМЫС УАҚЫТЫ: 40 s

ҚУАТЫ: • Жұмсақ режим: 275-413 kPa; • импульстік режим: 413-758 kPa; • қуатты режим: 827-965 kPa

МИНУТЫНА ИМПУЛЬС САНЫ: 1600

РЕЗЕРВУАР СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ: 140 ml

СУДАН ҚОРҒАНЫСЫ: IPX7



MIGA NEW - АУЫЗ ҚУЫСЫНЫҢ ИРРИГАТОРЫ

Қызыл иек ауруларының алдын алуға көмектеседі

Тамақ қалдықтарын кетіреді

Тісжегінің алдын алуға көмектеседі

Ауыздың қиын жететін аймақтарын тазартады

Ортодонтиялық құрылымдарға күтім

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: тіс қағы, тісжегі, ортодонтиялық құрылымдарда тұрып қалған тамақ қалдықтары, қызыл иек аурулары, ауыздан жағымсыз иіс шығуы.

МАТЕРИАЛЫ: ABS пластигі.

САЛМАҒЫ: 195 g.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:

Сұйықтық ең қиын жететін жерлерді тазартып, тісжегінің алдын алуға және ортодонтиялық құрылымдарды тазалауға мүмкіндік береді.

Ирригатор жасайтын сұйықтық қысымы қызыл иекке массаж жасап, қан айналымы мен жазылуын ынталандырады.

Тіл мен ұртты су ағынымен тазалау ауыздан жағымсыз иісті кетіруге көмектеседі.

Ирригатормен бірге әрқайсысының өз қызметі бар 3 түрлі саптама беріледі:

Стандартты саптама тістерді күнделікті тазалауға арналған. Иілген ұшы қақ пен тамақ қалдықтарын шайып кетіруге көмектеседі.

ПАРОДОНТОЛОГИЯЛЫҚ САПТАМА қызыл иек қалталарын тазалайды (қабынған қызыл иек тістен ажырағанда қалта түзіледі). Қызыл иек күтіміне арналған жұмсақ резеңке ұшы бар.

ТІЛ ТАЗАЛАУ САПТАМАСЫ қасық пішінді; онымен жұмсақ тіндердегі қақ пен кірді кетіруге болады.

Залалсыздандыру режимі саптамаларды стерильдеуге арналған. Су және шөп ерітінділерімен жанасқанда ирригатор саптамаларында патогенді микрофлора дамуы мүмкін. Осы ирригатордың саптамалар бөлімінде ультракүлгін шам орнатылған. Бұл толқын ұзындығындағы ультракүлгін сәуле (275 nm) бактерицидтік әсер береді.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:
1. Жинақта 3 саптама.
2. Үлкейтілген су резервуары - 130 ml.
3. Жиналмалы құрылымы ирригаторды шағын әрі ықшам етеді.
4. Саптамаларды залалсыздандыру режимі.
5. Ирригаторға кірістірілген саптама сақтау бөлімі.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ:
1. Саптаманы орнату және алу. Ескерту: алғаш қолданғанда өнім ішінен (сұйықтық резервуарынан, су беру түтігінен) қоқыс табылса, өнім зақымдалған болуы мүмкін. Ішінде таза сұйықтық іздері болса, алаңдамаңыз: бұл қалыпты. Ол - ирригатордың жұмысын тексеруге қолданылған тазартылған су. Өнімді жуып, қорықпай қолданыңыз. Саптаманы сақтау бөлімінен алып, ұясына енгізіңіз: магниттік бекіткіш оны автоматты түрде бекітеді. Алу үшін саптаманы ұясынан тартып шығарыңыз. Сақтау бөліміне салып, қақпағын берік жабыңыз.
2. Су құю: шаңнан қорғайтын қақпақты ашыңыз. Ирригаторды тік ұстап, су құйыңыз да, қақпақты жабыңыз. Таза кран суын қолдану ұсынылады. Су салқын сезілсе, бөлме температурасындағы, 40 °C-тан аспайтын суды қолданыңыз. Дәрігер ұсынымына сай тұзды су мен ауыз қуысына арналған құралды да қолдануға болады.
3. Қосу және режим таңдау: режим ауыстыру батырмасын басыңыз. Жұмсақ режимде бірінші, қуатты режимде екінші, импульстік режимде үшінші индикатор жанады. Залалсыздандыру режимінде соңғы, 4-индикатор жанады. Қажетті режимді таңдаңыз. Жұмсақ режимнен бастап, үйренген сайын қарқындылықты біртіндеп арттыру ұсынылады.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Стандартты көпфункциялы саптаманы қолданыңыз. Қосу батырмасын басып, қажетті режимді таңдаңыз. Су ағыны өңделетін аймаққа перпендикуляр болатындай саптаманы тіске қарсы қойыңыз. Ескерту: сезімтал қызыл иек оңай қанайды. Ағынды тікелей қызыл иекке бағыттамаңыз!
2. Артқы тістерден бастап, алдыңғы тістерге қарай жылжыңыз. Қызыл иек пен тісаралық кеңістік тазаланғанша әр тісте қысқа кідіріп, бүкіл тіс қатарын өтіңіз. Сыртқы жағынан бастасаңыз, ішкі жағында қайталаңыз. Осы ретті жоғарғы және төменгі тіс қатарында орындаңыз. Ескерту: тісі сезімтал адамдарға жұмсақ режим ұсынылады.
3. Қолданғанда өнімді тік ұстаңыз: саптаманың магниттік бекіткіші ажыраса, су беру тоқтауы мүмкін.
4. Қызыл иек қалталарын тазалау үшін пародонтологиялық саптаманы қолданыңыз. Қуат батырмасын басып, қажетті режимді таңдаңыз. Саптаманы оның ұшы қызыл иек шеті мен тіс-қызыл иек қалтасына бағытталатындай бұрышпен орналастырыңыз. Жоғарыдағы ұсынымдарға сай тазалаңыз.

5. Тілді тазалау үшін қасық тәрізді саптаманы қолданыңыз. Орнатып, қосу батырмасын басыңыз және қажетті режимді таңдаңыз. Тілдің түбінен ұшына қарай бір бағытта сыпыру қозғалыстарымен жүргізіңіз. Тазалау 30 секундқа, шамамен 5 рет жүргізуге созылуы тиіс.
6. Залалсыздандыру режимі: саптаманы сақтау бөліміне салып, шаңнан қорғайтын қақпақты жабыңыз.
7. Режим ауыстырғышымен төртінші - залалсыздандыру режимін таңдап, қосу батырмасын басыңыз.
8. Залалсыздандыру режимі саптама мен оның сақтау бөлімін стерильдеу үшін іске қосылады.
9. Көру қабілетіне зиян келтірмеу үшін күлгін стерильдеу шамына тікелей қарамаңыз.

ҚОЛДАНУ ЖИІЛІГІ:
Күніне 2 рет, тамақтан кейін; ортодонтиялық құрылымдарға күтім үшін - әр тамақтан кейін.

ҚОЛДАНУ ҰЗАҚТЫҒЫ:
Шектелмеген.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Пародонтиттің өршуі, ауыз қуысындағы жедел қабыну процестері.
2. Қызыл иектің қатты қанауы.
3. Ауыз қуысына операция жасалғаннан кейін бірден.

ЕСКЕРТУЛЕР:
1. Зарядтау кезінде зарядтау ұясын құрғақ ұстаңыз.
2. Кернеуі көрсетілгеннен өзгеше қуат көзіне қоспаңыз.
3. Зарядтау құралын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
4. Зақымдалған немесе дұрыс жұмыс істемейтін құрылғыны қолданбаңыз.
5. Су ағынын тікелей тілге, құлаққа немесе дененің басқа бөліктеріне бағыттамаңыз: су қысымы жарақаттауы мүмкін.
6. Тіс ауруы болса, өнімді тіс дәрігерінің бақылауымен қолданыңыз.
7. Бұл өнімді ауыз қуысына арналған немесе тіс дәрігері ұсынған құралмен бірге қолдануға болады.
8. Маман емес адамдар құрылғыны бөлшектемеуі және тесіктеріне бөгде заттарды салмауы тиіс.
9. Құрылғыны үй-жайдан тыс ауыр жағдайларда қолдану ұсынылмайды.
10. Резервуарға йод, ағартқыш немесе суда ерімейтін хош иісті май құймаңыз: бұл заттар жұмысына әсер етіп, қызмет мерзімін қысқартады.
11. Қолданар алдында ауыздағы барлық әшекейді алыңыз.
12. Тілде немесе ауызда көрінетін жаралар болса, өнімді қолданбаңыз.
13. Дәрігер антибиотик тағайындаса, өнімді тек дәрігердің нақты ұсынымымен қолданыңыз.
14. Жарақат алмау үшін су ағынын құлаққа бағыттамаңыз.
15. 3 жасқа толмаған балаларға өнімді қолдануға рұқсат бермеңіз.
16. Өнімді тікелей күн сәулесі мен жылу көздерінен алыс, құрғақ, таза бөлмеде сақтаңыз.

17. Ұзақ сақтауға (3 айдан артық) қояр алдында аккумуляторды толық зарядтаңыз.
18. Резервуарда су жоқ кезде өнімді қоспаңыз: құрылғы істен шығуы мүмкін.
19. Резервуарды тазалауға 50 °C-тан ыстық су қолданбаңыз. Қызмет мерзімін ұзарту үшін жоғары температурадан деформациялануына жол бермеңіз. Өнімді тазалауға бөлме температурасындағы, 40 °C-тан төмен су немесе ағын кран суы ұсынылады.
20. Бітелу мен зақымның алдын алу үшін суға тіс пастасын, тұзды, қатты ауыз шаю таблеткаларын немесе басқа химиялық заттарды қоспаңыз.
21. Ауыз шаю немесе сергіту құралын құяр алдында құрамында изопропилмиристат бар-жоғын тексеріңіз: ол өнімді зақымдап, қалыпты жұмысына әсер етуі мүмкін.
22. Еріткіштерді, спирттерді немесе басқа агрессивті тазартқыштарды қолданбаңыз: өнімнің түсі өзгеріп, істен шығуы мүмкін.

ЖИНАҚ ҚҰРАМЫ: (1) ирригатор, (2) стандартты саптама, (3) пародонтологиялық саптама, (4) тіл тазалау саптамасы, (5) сақтау қабы, (6) нұсқаулық, (7) USB-C зарядтау кабелі.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

ЗАРЯДТАУ УАҚЫТЫ: 3 h

ЖҰМЫС УАҚЫТЫ: • Жұмсақ режим - 50 минут; • қуатты режим - 45 минут; • импульстік режим - 100 минут; • залалсыздандыру режимі - 220 минут

АҚЫЛДЫ ТАЙМЕР: жоқ

РЕЗЕРВУАР ТОЛЫ БОЛҒАНДАҒЫ ЖҰМЫС УАҚЫТЫ: • Жұмсақ режим: 35 ± 8 секунд; • қуатты режим: 30 ± 8 секунд; • импульстік режим: 65 ± 10 секунд

ҚУАТЫ: • Жұмсақ режим: 392-637 kPa; • қуатты режим: 686-931 kPa; • импульстік режим: 588-833 kPa

МИНУТЫНА ИМПУЛЬС САНЫ: 1600±20%

РЕЗЕРВУАР СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ: 130 ml

СУДАН ҚОРҒАНЫСЫ: IPX7



MIGA PRO - ТАСЫМАЛДЫ ИРРИГАТОР

Қызыл иек ауруларының алдын алуға көмектеседі

Тамақ қалдықтарын кетіреді

Тісжегінің алдын алуға көмектеседі

Ауыздың қиын жететін аймақтарын тазартады

Ортодонтиялық құрылымдарға күтім

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: тіс қағы, тісжегі, ортодонтиялық құрылымдарда тұрып қалған тамақ қалдықтары, қызыл иек аурулары, ауыздан жағымсыз иіс шығуы.

МАТЕРИАЛДАРЫ: MS пластигі, ABS пластигі.

САЛМАҒЫ: 260 g.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:

Сұйықтық ең қиын жететін жерлерді тазартып, тісжегінің алдын алуға және ортодонтиялық құрылымдарды тазалауға мүмкіндік береді.

Ирригатор жасайтын сұйықтық қысымы қызыл иекке массаж жасап, қан айналымы мен жазылуын ынталандырады.

Ирригатормен бірге әрқайсысының өз қызметі бар 3 түрлі саптама беріледі:

Стандартты саптама тістерді күнделікті тазалауға арналған. Иілген ұшы қақ пен тамақ қалдықтарын шайып кетіруге көмектеседі.

Ортодонтиялық саптама брекет жүйелерін тазалауға арналған. Ұшында су өтетін тесіктен бөлек қатты қылшықтары бар щетка орналасқан. Ол ортодонтиялық құрылымдардың құлыптарын тазалап, тіс қағы мен тамақ қалдықтарын шайып кетіреді.

ПАРОДОНТОЛОГИЯЛЫҚ САПТАМА қызыл иек қалталарын тазалайды (қабынған қызыл иек тістен ажырағанда қалта түзіледі). Қызыл иек күтіміне арналған жұмсақ резеңке ұшы бар.

Залалсыздандыру режимі резервуарды стерильдеуге арналған. Су және шөп ерітінділерімен жанасқанда ирригаторда патогенді микрофлора дамуы мүмкін. Осы ирригатордың резервуарына оны стерильдеуге арналған ультракүлгін шам орнатылған.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:
1. Жинақта 3 саптама.
2. Үлкейтілген су резервуары - 180 ml.
3. Жиналмалы құрылымы ирригаторды ықшам етіп, тасымалдауды жеңілдетеді.
4. Резервуарды залалсыздандыру режимі.
5. Ирригаторға кірістірілген саптама сақтау бөлімі.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ:
1. Саптаманы орнату және алу: саптаманы сақтау бөлімінен алып, ұясына шертілгенше бекітіңіз. Алу үшін саптаманы ауыстыру батырмасын басып, ұясынан тартып шығарыңыз. Сақтау бөліміне салып, берік бекітіңіз.
2. Су құю: резервуар қақпағын ашыңыз. Ирригаторды көлденең ұстап, су құйыңыз да, қақпағын жабыңыз. Таза дистилденген су ұсынылады. Су салқын сезілсе, бөлме температурасындағы, 40 °C-тан аспайтын суды қолданыңыз. Дәрігер ұсынымына сай тұзды су мен ауыз қуысына арналған құралды да қолдануға болады.
3. Қосу және режим таңдау: қосу батырмасын қысқа басып, құрылғыны қосыңыз. Қайта қысқа басу тазалау режимін ауыстырады. Режим батырмасын ұзақ басу (3 секунд) жылдамдықты өзгертеді. Қолданғаннан кейін ұзақ басып (3 секунд) өшіріңіз. Өшкенде құрылғы соңғы режимді есте сақтап, келесі қосылғанда сол режимде автоматты түрде жұмыс істейді.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Стандартты көпфункциялы саптаманы қолданыңыз. Қосу батырмасын басып, қажетті режим мен жылдамдықты таңдаңыз. Су ағыны өңделетін аймаққа перпендикуляр болатындай саптаманы тіске қарсы қойыңыз. Ескерту: сезімтал қызыл иек оңай қанайды. Ағынды тікелей қызыл иекке бағыттамаңыз!
2. Артқы тістерден бастап, алдыңғы тістерге қарай жылжыңыз. Қызыл иек пен тісаралық кеңістік тазаланғанша әр тісте қысқа кідіріп, бүкіл тіс қатарын өтіңіз. Сыртқы жағынан бастасаңыз, ішкі жағында қайталаңыз. Осы ретті жоғарғы және төменгі тіс қатарында орындаңыз. Ескерту: тісі сезімтал адамдарға жұмсақ режим ұсынылады.
3. Қызыл иек қалталарын тазалау үшін пародонтологиялық саптаманы қолданыңыз. Қуат батырмасын басып, қажетті режимді таңдаңыз. Саптаманы оның ұшы қызыл иек шеті мен тіс-қызыл иек қалтасына бағытталатындай бұрышпен орналастырыңыз. Жоғарыдағы ұсынымдарға сай тазалаңыз.
4. Брекет жүйелерін тазалау үшін ортодонтиялық саптаманы қолданыңыз. Су ағыны өтетін тесіктен бөлек, ұшында қатты қылшықтары бар щетка болғандықтан, брекет құлыптарын жақсы тазалап, қақ пен тамақ қалдықтарын шайып кетіреді.
5. Залалсыздандыру режимі: ирригаторды жабық қалпына жинасаңыз, ультракүлгін тазалау режимі автоматты түрде 10 минутқа іске қосылады.

6. Көру қабілетіне зиян келтірмеу үшін күлгін стерильдеу шамына тікелей қарамаңыз.

ҚОЛДАНУ ЖИІЛІГІ:
Күніне 2 рет, тамақтан кейін; ортодонтиялық құрылымдарға күтім үшін - әр тамақтан кейін.

ҚОЛДАНУ ҰЗАҚТЫҒЫ:
Шектелмеген.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Пародонтиттің өршуі, ауыз қуысындағы жедел қабыну процестері.
2. Қызыл иектің қатты қанауы.
3. Ауыз қуысына операция жасалғаннан кейін бірден.

ЕСКЕРТУЛЕР:
1. Зарядтау кезінде зарядтау ұясын құрғақ ұстаңыз.
2. Кернеуі көрсетілгеннен өзгеше қуат көзіне қоспаңыз.
3. Зарядтау құралын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
4. Зақымдалған немесе дұрыс жұмыс істемейтін құрылғыны қолданбаңыз.
5. Су ағынын тікелей тілге, құлаққа немесе дененің басқа бөліктеріне бағыттамаңыз: су қысымы жарақаттауы мүмкін.
6. Тіс ауруы болса, өнімді тіс дәрігерінің бақылауымен қолданыңыз.
7. Бұл өнімді ауыз қуысына арналған немесе тіс дәрігері ұсынған құралмен бірге қолдануға болады.
8. Маман емес адамдар құрылғыны бөлшектемеуі және тесіктеріне бөгде заттарды салмауы тиіс.
9. Құрылғыны үй-жайдан тыс ауыр жағдайларда қолдану ұсынылмайды.
10. Резервуарға йод, ағартқыш немесе суда ерімейтін хош иісті май құймаңыз: бұл заттар жұмысына әсер етіп, қызмет мерзімін қысқартады.
11. Қолданар алдында ауыздағы барлық әшекейді алыңыз.
12. Тілде немесе ауызда көрінетін жаралар болса, өнімді қолданбаңыз.
13. Дәрігер антибиотик тағайындаса, өнімді тек дәрігердің нақты ұсынымымен қолданыңыз.
14. Жарақат алмау үшін су ағынын құлаққа бағыттамаңыз.
15. 3 жасқа толмаған балаларға өнімді қолдануға рұқсат бермеңіз.
16. Өнімді тікелей күн сәулесі мен жылу көздерінен алыс, құрғақ, таза бөлмеде сақтаңыз.
17. Ұзақ сақтауға (3 айдан артық) қояр алдында аккумуляторды толық зарядтаңыз.
18. Резервуарда су жоқ кезде өнімді қоспаңыз: құрылғы істен шығуы мүмкін.
19. Резервуарды тазалауға 40 °C-тан ыстық су қолданбаңыз. Қызмет мерзімін ұзарту үшін жоғары температурадан деформациялануына жол бермеңіз. Өнімді тазалауға бөлме температурасындағы, 40 °C-тан төмен су немесе ағын кран суы ұсынылады.
20. Бітелу мен зақымның алдын алу үшін суға тіс пастасын, тұзды, қатты ауыз шаю таблеткаларын немесе басқа химиялық заттарды қоспаңыз.

21. Ауыз шаю немесе сергіту құралын құяр алдында құрамында изопропилмиристат бар-жоғын тексеріңіз: ол өнімді зақымдап, қалыпты жұмысына әсер етуі мүмкін.
22. Еріткіштерді, спирттерді немесе басқа агрессивті тазартқыштарды қолданбаңыз: өнімнің түсі өзгеріп, істен шығуы мүмкін.

ЖИНАҚ ҚҰРАМЫ: (1) ирригатор, (2) стандартты саптама, (3) пародонтологиялық саптама, 4. ортодонтиялық саптама, 5) сақтау қабы, 6) нұсқаулық, 7) USB-DC зарядтау кабелі.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

ЗАРЯДТАУ УАҚЫТЫ: 4 h

АҚЫЛДЫ ТАЙМЕР: жоқ

ӘР РЕЖИМ МЕН ЖЫЛДАМДЫҚТАҒЫ ЖҰМЫС УАҚЫТЫ:
СТАНДАРТТЫ РЕЖИМ
• Төмен жылдамдық - 96 минут
• Орташа жылдамдық - 72 минут
Жоғары жылдамдық - 59 минут. ИМПУЛЬСТІК РЕЖИМ
• Төмен жылдамдық - 133 минут
• Орташа жылдамдық - 103 минут
• Жоғары жылдамдық - 84 минут
• ЖҰМСАҚ РЕЖИМ
• Төмен жылдамдық - 140 минут
• Орташа жылдамдық - 96 минут

ӘР РЕЖИМ МЕН ЖЫЛДАМДЫҚТАҒЫ ИМПУЛЬС ЖИІЛІГІ:
СТАНДАРТТЫ РЕЖИМ
• Төмен жылдамдық - 1440/min
• Орташа жылдамдық - 1920/min
• Жоғары жылдамдық - 2400/min
• ИМПУЛЬСТІК РЕЖИМ
Төмен жылдамдық - 1440/min ± 10%
Орташа жылдамдық - 1920/min ± 10%
Жоғары жылдамдық - 2400/min ± 10%
• ЖҰМСАҚ РЕЖИМ
Төмен жылдамдық - 960/min ± 10%
• Орташа жылдамдық - 1440/min ± 10%
• Жоғары жылдамдық - 1920/min ± 10%

РЕЗЕРВУАР СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ: 180 ml

СУДАН ҚОРҒАНЫСЫ: IPX7

ТОЛЫ РЕЗЕРВУАРДЫ ҚОЛДАНУ (БОСАТУ) УАҚЫТЫ:
СТАНДАРТТЫ РЕЖИМ
• Төмен жылдамдық - 116 секунд
Орташа жылдамдық - 68 секунд; жоғары жылдамдық - 55 секунд

ИМПУЛЬСТІК РЕЖИМ
Төмен жылдамдық - 144 секунд
• Орташа жылдамдық - 93 секунд
• Жоғары жылдамдық - 65 секунд. ЖҰМСАҚ РЕЖИМ
• Төмен жылдамдық - 143 секунд
Орташа жылдамдық - 92 секунд
• Жоғары жылдамдық - 65 секунд

ҚУАТЫ: Стандартты режим: төмен жылдамдық - 339.2 kPa; орташа - 661.2 kPa; жоғары - 901.1 kPa. Импульстік режим: төмен жылдамдық - 315.1 kPa; орташа - 460.6 kPa; жоғары - 776.3 kPa. Жұмсақ режим: төмен жылдамдық - 133.1 kPa; орташа - 375.8 kPa; жоғары - 655.0 kPa.



MIO2 - EMS ФУНКЦИЯСЫ БАР МИКРОТОКТЫ МАССАЖЕР

Тері серпімділігін жақсартады

Қартаю белгілерін азайтады

Әжімдерді тегістейді

Ісіну мен пигментацияға қарсы әсер етеді

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: мимикалық әжімдер, бет ісінуі және көз астындағы шеңберлер, өңсіз әрі босаңсыған тері, салбыраған ұрт, жасқа байланысты өзгерістер, кеңейген тесіктер, пигментация.

МАТЕРИАЛДАРЫ: ABS пластигі, PC пластигі, мырыш қорытпасы.

САЛМАҒЫ: Массажер - 80 g, база - 70 g.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:

EMS - бұлшықеттерді миостимуляциялауға арналған электр тогы. Ол тері қабаттарына терең еніп, бұлшықет қабатына жетеді. Бұлшықеттердің жиырылуын ынталандыру арқылы EMS теріні тартып, лифтинг әсерін береді, коллаген мен эластиннің түзілуін арттырады, терінің серпімділігі мен созылғыштығын жақсартады, ісінуді азайтады.

Бұл функция 42 ± 3 °C температурада массаж жасап, қан мен лимфа ағынын жеделдетеді, зат алмасуды белсендіріп, тіндердің оттегімен қамтамасыз етілуін арттырады. Бет реңі жақсарып, тері тегістеледі және қартаю белгілері аз байқалады.

Діріл - теріге механикалық әсер. Ол жасушалардағы барлық зат алмасу процестерін күшейтіп, токсиндердің шығарылуын ынталандырады және терінің қалпына келуіне ықпал етеді.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:
1. 3 режим: EMS, қыздыру, EMS/діріл/қыздыру.
2. Сезілетін токтар: WAU брендінің жаңартылған құрылғысында инженерлер ток күші мен импульс жиілігін реттеу арқылы EMS әсерінің қолданудан кейін көрініп қана қоймай, процедура кезінде де сезілуіне қол жеткізді.
3. Екі тәуелсіз арна (ток көзі ретінде 2 электрод) қамту аймағын кеңейтіп, бұлшықеттерге әсері мен токтың сезілуін күшейтеді.
4. Сымсыз зарядтау: зарядтау базасы арқылы зарядталады.
5. Оңай басқару: қосу/өшіруден режим ауыстыруға дейін 1 батырмамен басқарылады.
6. MIO2 иілген пішіні бет контурын қайталайды, конус тәрізді бұрыштары акупунктура нүктелерін уқалап, бұлшықеттерді босаңсытуға көмектеседі. Құрылғы пішіні гуаша массажын жасауға да мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ:
1. MIO2 құрылғысы 1 батырмамен басқарылады.
2. Қосу/өшіру батырмасын ұзақ басып, құрылғыны қосыңыз.
3. Қосу/өшіру батырмасын қысқа басып, қажетті режимді таңдаңыз:
• Көк индикатор - EMS;
• Қызыл индикатор - қыздыру;
Ақ индикатор - EMS, қыздыру және діріл комбинациясы.
4. Қосу/өшіру батырмасын ұзақ басып, массажерді өшіріңіз.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Теріге ток өткізетін массаж гелін жағыңыз. Құрылғының жұмыс бетін массаж аймағына тигізіңіз.
2. Бет бұлшықеттерінің анатомиялық орналасуына сай төменнен жоғары жылжытып, бет пен мойынға массаж жасаңыз.
3. MIO2 жұмыс бетімен массаж сызықтарының бойымен жылжытып, гуаша массажын жасауға болады.
4. Құрылғының конус тәрізді бұрышы акупунктура нүктелерінің массажына арналған. Сол нүктелерге жеңіл тигізіп, шағын шеңбер жасаңыз.

ҚОЛДАНУ ЖИІЛІГІ МЕН ҰЗАҚТЫҒЫ:

ТЕРІ ТҮРІ / МӘСЕЛЕ	ТӘУЛІК УАҚЫТЫ	ҰЗАҚТЫҒЫ МЕН РЕТІ	ҚОЛДАНУ	КУРСЫНЫҢ ЖИІЛІГІ
ТЫҒЫЗ ТЕРІ / ІСІНУ / САЛБЫРАУ	Кешке, күннің 2-жартысында	EMS режимі - 3-5 минут; EMS + қыздыру + діріл режимі - 5 минут	Аптасына 2-3 рет	10 апта. Үзіліс: 2 апта. 10 апталық курсты тұрақты түрде қайталаңыз.
ҰСАҚ ӘЖІМДЕРІ БАР ҚҰРҒАҚ ТЕРІ	Таңертең.	Қыздыру режимі - 2-3 минут; EMS режимі - 3-4 минут; EMS + қыздыру + діріл режимі - 3 минут	Аптасына 1-2 рет	10 апта. Үзіліс: 2 апта. 10 апталық курсты тұрақты түрде қайталаңыз.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Тері бүтіндігінің бұзылуы.
2. Кейбір косметологиялық процедуралардан кейінгі терінің жазылу кезеңі (мысалы, лазерлік тегістеу, химиялық пилинг, мезотерапия және т.б.).
3. Стероидтары бар дәрілерді қабылдау.

ЕСКЕРТУЛЕР:
1. Құрылғыны суға батырмаңыз.
2. Құрылғыны ылғалды ортада (мысалы, су толы ванна, душ, бассейн жанында) зарядтамаңыз.
3. Құрылғыны отқа тастамаңыз.
4. Массажердің өзі немесе бөлшектері зақымдалса, қолданбаңыз.
5. Аккумулятор қызметін ұзарту үшін массажерді кемінде әр 2 ай сайын 100%-ға дейін толық зарядтаңыз.
6. Құрылғы 12 жасқа толмаған адамдарға және дене, сезу, ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдарға арналмаған.

ЖИНАҚ ҚҰРАМЫ: (1) массажер, (2) зарядтау базасы, (3) USB-C зарядтау кабелі,
4. сақтау қабы, (5) майлық, (6) нұсқаулық.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

ӨЛШЕМІ (Б × Е × Т): Массажер - 136×54×22 mm, зарядтау базасы - 85×78×52 mm

ҚУАТ КӨЗІ: литий-ионды аккумулятор

АККУМУЛЯТОР СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ: 500 mAh

ЖҰМЫС КЕРНЕУІ: 3,7 V

ҚУАТЫ: 5 W

ЗАРЯДТАУ УАҚЫТЫ: 2,5 h

ЖҰМЫС УАҚЫТЫ: Толық зарядтан кейін 50 минут

АҚЫЛДЫ ТАЙМЕР: 10 min

ДІРІЛ ЖЫЛДАМДЫҒЫ: минутына 1200 айналым

EMS ҚАРҚЫНДЫЛЫҒЫ: 2 mA

ТОК ЖИІЛІГІ: 2,5 kHz

ТОЛҚЫН ПІШІНІ: екі фазалы симметриялы

ҚЫЗДЫРУ ТЕМПЕРАТУРАСЫ: 42 ± 3 °C

СУДАН ҚОРҒАНЫСЫ: IPX4



MIRA - БЕТ ПЕН МОЙЫНҒА АРНАЛҒАН ЛИФТИНГ МАССАЖЕРІ

Ісінуді азайтады

Бет пен мойынды тартады

Әжімдерді азайтады

Тері серпімділігін жақсартады

Безеуге қарсы әсер етеді

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: әжімдер, терінің босаңсуы мен салбырауы, жарқыраудың жоғалуы және тері реңінің нашарлауы, ісіну, қызару, тітіркену, қабыну.

МАТЕРИАЛДАРЫ: PC пластигі, ABS пластигі, силикон, мырыш қорытпасы.

САЛМАҒЫ: Массажер - 164 g, база - 115 g

ФУНКЦИЯЛАРЫ:

EMS - бұлшықеттерді миостимуляциялауға арналған электр тогы. Ол тері қабаттарына терең еніп, бұлшықет қабатына жетеді. Бұлшықеттердің жиырылуын ынталандыру арқылы EMS теріні тартып, лифтинг әсерін береді, коллаген мен эластиннің түзілуін арттырады, терінің серпімділігі мен созылғыштығын жақсартады, ісінуді азайтады.

ДІРІЛ - механикалық тербелістер (=импульстер). Олар тіндердегі лимфа дренажы мен микроайналымды (қан/лимфа қозғалысын) жақсартады, бұлшықет қысылуын босаңсытады. Соның нәтижесінде ісіну азайып, бет реңі жақсарады және косметиканың сіңуі артады.

LED терапиясы: әр түс көрінетін спектрдің белгілі толқын ұзындығына сәйкес келеді. Әртүрлі тереңдікке әсер еткен жарық рецепторларға сіңіп, жасуша ішіндегі табиғи процестер мен белгілі реакцияны іске қосады. Қызыл LED жарығы терең еніп, митохондрияларға сіңеді және фибробласттардың коллаген мен эластин өндіруін белсендіреді. Нәтижесі: жасару, серпімділік, әжімдердің азаюы. Көк LED жарығын P. acnes бактерияларының порфириндері сіңіреді. Түзілген синглетті оттегі бактерияларды жойып, безеу мен қабынуға қарсы әсер етеді және май бездерін қалыпқа келтіреді. Жасыл LED жарығы тыныштандырады, тамырларды тарылтып, лимфа ағынын жақсартады. Сезімтал және реактивті теріге жарайды. Қызару, ісіну және куперозға қарсы тиімді.

ЖЫЛУ ұсақ қан тамырларын кеңейтеді. Бұл өңделетін аймақта қан ағынын арттырады. Күшейген қан айналымы зат алмасу өнімдерінің тез шығарылуына көмектесіп, тері жасушаларының жалпы қоректенуін жақсартады. Сондай-ақ қан ағынының артуы дене температурасын көтеріп, тер бездерінің өзектерін белсендіреді. Бұл тесіктерді физикалық түрде «ашып», тазалауға немесе косметиканы қабылдауға дайындайды.

СУЫҚ тамырларды тарылтып, тері бетіне қан ағынын шектейді және капилляр қабырғаларының өткізгіштігін төмендетеді. Бұл қызаруды (қан ағыны азайғандықтан) және ісінуді (тамырлардан тіндерге сұйықтық шығуы азайғандықтан) басады.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:
1. 5 технология көпфункциялылықты қамтамасыз етеді. Барлық мәселені шешуге арналған 1 құрылғы сатып алуда қаражат үнемдейді.
2. Құрылғы режимдерді біріктіріп, күтімді тері қажеттілігіне бейімдеуге мүмкіндік береді.
3. Жайлы әрі ауыртпайтын әсерді таңдауға арналған 3 EMS деңгейі.
4. Әртүрлі мәселені шешуге арналған 3 түсті фототерапия.
5. Эргономикалық пішін: көлемді сабы ыңғайлы ұстауды қамтамасыз етіп, массажға көңіл бөлуге мүмкіндік береді.
6. Ақылды технология. Массажер ақылды таймермен жұмыс істейді: 10 минуттан кейін автоматты түрде өшеді. Суық режимі де 3 минутқа дейін жұмыс істеп, қауіпсіздікті және технологияның тиімділігін қамтамасыз етеді.
7. Көпфункциялы жұмыс беті. Доға пішіні көптеген аймақтарды өңдеуге мүмкіндік береді: мойын, иек (бет контуры), ұрт, көз асты, маңдай.
8. Жұмыс бетінің материалы. MIRA басында алтын жалатылған болаттан жасалған екі белсенді электрод бар. Электр өткізгіштігі бойынша алтын тек күміс пен мыстан кейін үшінші орында тұрады. Арнайы жабын осы құрылғыдағы токтың өтуіне ықпал етеді.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ:
1. Құрылғы ортаңғы батырманы (LED батырмасы) ұзақ басқанда қосылады.
2. LED батырмасын қысқа басу фототерапия жарығын ауыстырады. Бірінші басу - қызыл LED, екінші - көк LED, үшінші - жасыл, төртінші - фототерапияны өшіру.
3. Фототерапия жарығын әр ауыстырған сайын LED батырмасының айналасында сол жарыққа сәйкес диод жанады.
4. Жоғарғы батырманы (EMS батырмасы) қысқа басу EMS режимін қосады. Қысқа басу EMS қарқындылығын орнатады. Бірінші басу - 1-деңгей (әлсіз), екінші - 2-деңгей (орташа), үшінші - 3-деңгей (күшті). Қайта басу EMS режимін толық өшіреді.
5. Әр режим ауысқанда дисплейде ток қарқындылығы әлсізден күштіге дейін көрсетіледі: 1-деңгейде 1 диод, 2-деңгейде 2 диод, 3-деңгейде барлық 3 диод жанады.
6. Жоғарғы батырманы (EMS батырмасы) ұзақ басу толқынды дірілді қосады. Қайта ұзақ басу діріл функциясын өшіреді.
7. Төменгі түймені (температура түймесі) қысқа басу суық режимді қосады. Ол 3 минут жұмыс істейді және осы уақыттан кейін автоматты түрде өшеді. Бұл құрылғыны қызып кетуден қорғайды және мүмкіндігінше суық режимде ең суық температурада жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Құрылғы дисплейінде суық режимді қосқанда, көк жарық диодты термометр белгішесі жанады.
8. Температура батырмасын қайта басу суықтан жылыға ауыстырады. Жылы режимге ауысқанда дисплейде қызыл термометр белгісі жанады.

9. Массажерде ақылды таймер бар. 10 минут жұмыстан кейін құрылғы өздігінен өшеді.
10. Құрылғыны өшіру үшін LED батырмасын басып тұрыңыз.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Теріге ток өткізетін жанасу гелін немесе су негізіндегі гель тәрізді күтім құралын жағыңыз. Бұл ең жоғары нәтиже үшін токтың жақсы өтуін қамтамасыз етеді.
2. Құрылғыны қосып, қажетті режимдерді баптаңыз.
3. Массажды мойыннан бастаңыз. Лимфа жолдарын «ашу» үшін құлақ сырғалығынан бұғанаға қарай тік сызықтармен жоғарыдан төмен жылжытыңыз.
4. Содан кейін бет ортасынан шетіне қарай массаж сызықтарымен жылжытыңыз. Ауырлық күшіне қарсы тұрып, бұлшықеттерді тарту үшін қозғалыс бағыты - қиғаш жоғары. Процедураны төменнен (иектен) жоғары (маңдайдағы шаш өсу сызығына) қарай орындаңыз.
5. Маңдайдағы көлденең әжімдерді тегістеу үшін тік жоғары жылжытыңыз.
6. Массаж басында қыздыру мен дірілді қосу ұсынылады. Бұл екі технология теріні белсенді құрамдастар мен ынталандыруды барынша қабылдауға дайындайды. Дайындық мақсаты - бұлшықеттерді босаңсыту, тазалау үшін тесіктерді кеңейту, қан айналымы мен лимфа дренажын арттырып, жасушаларды дайындау. Әсер ету ұзақтығы - 2 минутқа дейін.
7. Әрі қарай жасушалар мен бұлшықеттерді ынталандырып, қан айналымын жақсартатын негізгі кезең өтеді. Мақсаты - жаңа коллаген мен эластин түзу, бұлшықеттерді жаттықтыру (лифтинг), нақты мәселелерді (мысалы, безеу немесе пигментация) жою. EMS қосып, жайлы қарқындылық орнатыңыз. LED терапиясын баптап, қызыл LED жарығынан бастаңыз.
8. Негізгі жасартатын әсерден кейін нақты мәселе үшін қызыл LED-ті көкке (безеу мен майлылыққа қарсы) немесе жасылға (тыныштандыру, купероз/қызаруға қарсы) ауыстыруға болады. Кезеңнің жалпы ұзақтығы - 6 минут.
9. Массажды суық функциясымен аяқтаңыз. Бұл кезең қол жеткізген нәтижені бекітеді. Суық теріні тыныштандырып, қалдық қызаруды басады және косметиканың белсенді құрамдастарын теріде бекітеді. Соңғы кезең - 2 минутқа дейін.

ҚОЛДАНУ ЖИІЛІГІ МЕН ҰЗАҚТЫҒЫ:

ТЕРІ ТҮРІ / МӘСЕЛЕ	**ТӘУЛІК УАҚЫТЫ**	**ҰЗАҚТЫҒЫ МЕН РЕТІ**	**ЖИІЛІГІ**	**КУРС**
МАЙЛЫ НЕМЕСЕ АРАЛАС ТЕРІ / КЕҢЕЙГЕН ТЕСІКТЕР / МАЙЛЫ ЖЫЛТЫР / БЕЗЕУДЕН КЕЙІНГІ ІЗДЕР	Таңертең	EMS + Көк LED жарығы + Суық. Суық режимден бастаңыз (2 минут), содан кейін EMS және жарық қосыңыз. Ең аз EMS қарқындылығын 3 өңдеуге дейін пайдаланыңыз, содан кейін біртіндеп арттырыңыз.	Аптасына 2-3 рет, 10-15 минуттан	ПРОЦЕДУРАЛАР КУРСЫ: 1 ай. Үзіліс: 2-3 ай. Курстар арасында: аптасына 2-3 рет көк LED жарығын 10-15 минут қолданыңыз.

САЛБЫРАУ / ІСІНУ ТҮРІНДЕГІ ҚАРТАЮ / ТАҢЕРТЕҢГІ ІСІНУ	Таңертең	EMS + Суық. Суық режимнен бастаңыз (2 минут), содан кейін EMS қосыңыз. Ең аз EMS қарқындылығын 3 өндеуге дейін пайдаланыңыз, содан кейін біртіндеп арттырыңыз.	Аптасына 3-4 рет, 10-15 минуттан	ПРОЦЕДУРАЛАР КУРСЫ: 1 ай. Үзіліс: 2-3 ай.
ӨҢСІЗ ТЕРІ / СЕРПІМДІЛІК ПЕН ТОНУСТЫҢ ТӨМЕНДЕУІ	Таңертең / кешке (кез келген уақытта)	EMS + Қызыл LED жарығы + Қыздыру (10-15 минут), содан кейін Суық (2-3 минут). Ең аз EMS қарқындылығын 3 өндеуге дейін пайдаланыңыз, содан кейін біртіндеп арттырыңыз.	Аптасына 2-3 рет, 10-15 минут	ПРОЦЕДУРАЛАР КУРСЫ: 1 ай. Қайталау: 4-5 айдан кейін. Курстар арасында: аптасына 1 қолдау сеансы.
ҚҰРҒАҚ / СУСЫЗДАНҒАН ТЕРІ	Кешке	EMS + Жылу. Қыздыру режимінен бастаңыз (2 минут), содан кейін EMS қосыңыз. Ең аз EMS қарқындылығын 3 өндеуге дейін пайдаланыңыз, содан кейін біртіндеп арттырыңыз.	Аптасына 2 рет, 10-15 минут	ПРОЦЕДУРАЛАР КУРСЫ: 1 ай. Қайталау: 4-5 айдан кейін. Курстар арасында: әр 2 аптада 1 қолдау сеансы.
ЖЕТІЛГЕН ТЕРІ / СЕРПІМДІЛІК ПЕН ТОНУСТЫҢ ТӨМЕНДЕУІ	Кешке	EMS + Қызыл LED жарығы + Жылу. Жылыту режимінен бастаңыз (2 минут), содан кейін EMS және жарық қосыңыз. Ең аз EMS қарқындылығын 3 өндеуге дейін пайдаланыңыз, содан кейін біртіндеп арттырыңыз.	Аптасына 2-3 рет, 15 минут	ПРОЦЕДУРАЛАР КУРСЫ: 1-1.5 ай. Қайталау: 4-5 айдан кейін. Курстар арасында: айына 1-2 қолдау сеансы + аптасына 3 рет қызыл LED жарығын қолдану (15 минут).
БҰЛШЫҚЕТ ГИПЕРТОНУСЫ / КЕРІЛУ	Кешке	EMS (тек 1-деңгейдегі қарқындылық) + жасыл LED жарығы. Ең төмен EMS қарқындылығын 3 процедураға дейін қолданып, содан кейін біртіндеп арттырыңыз.	Аптасына 2-3 рет, 15 минут. Бұлшықет тал шықтарының бағытымен жылжытыңыз.	ПРОЦЕДУРАЛАР КУРСЫ: 1-1.5 ай. Қайталау: жарты жылдан кейін немесе бұлшықет қысылуы сезілгенде.
СЕЗІМТАЛ ТЕРІ / РЕМИССИЯДАҒЫ КУПЕРОЗ	Таңертең / кешке (кез келген уақытта)	EMS (тек 1-деңгейдегі қарқындылық) + жасыл LED жарығы. Ең төмен EMS қарқындылығын 3 процедураға дейін қолданып, содан кейін біртіндеп арттырыңыз.	Аптасына 2 рет, 10 минут	ПРОЦЕДУРАЛАР КУРСЫ: 1 ай. Қайталау: 4-5 айдан кейін. Курстар арасында: әр 2-3 аптада 1 қолдау сеансы.

МОЙЫН	Кешке	EMS + қызыл LED + қыздыру. Қыздырудан (2 минут) бастап, содан кейін EMS пен жарықты қосыңыз. Алғашқы 3 процедураға дейін EMS-тің ең төмен қарқындылығын қолданып, кейін біртіндеп арттырыңыз. Қалқанша без ауруы сияқты қарсы көрсетілімдер болмағанда ғана қолданыңыз. Қалқанша безді және оның жанындағы тамыр соғуы сезілетін ұйқы артериясы синусын әрдайым айналып өтіңіз.	Аптасына 2-3 рет, 10-15 минут	ПРОЦЕДУРАЛАР КУРСЫ: 1 ай. Қайталау: 4 айдан кейін. Курстар арасында: әр 2 аптада 1 қолдау сеансы.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:

1. Құрылғы тек үйде жеке қолдануға арналған және медициналық құрылғы болып саналмайды.
2. Төмендегі адамдар құрылғыны тек дәрігердің нұсқауымен қолдануы тиіс:
• Жүкті және бала емізетін әйелдер.
• Терісі сезімтал немесе тері аурулары бар адамдар.
• Электрондық медициналық құрылғылары (мысалы, кардиостимулятор) орнатылған адамдар.
• Диабеті немесе қан айналымы бұзылыстары бар адамдар.
3. Құрылғыны мына аймақтарға қолданбаңыз:
• Зақымдалған теріге (жара, қабыну, экзема).
• Шырышты қабықтар аймағына (көз, ауыз).

ЕСКЕРТУЛЕР:

1. Суық режимінде үсікке жол бермеу үшін құрылғыны терінің бір жерінде тым ұзақ ұстамаңыз.
2. Қыздыру режимінде шамадан тыс ыстық сезілсе, күйікке жол бермеу үшін процедураны дереу тоқтатыңыз.
3. Балалар құрылғыны тек ересектердің бақылауымен қолдануы тиіс.

ЖИНАҚ ҚҰРАМЫ: (1) MIRA массажері, (2) жұмыс бетінің қақпағы, (3) зарядтау базасы,
4. USB-Type C кабелі, 5) нұсқаулық, 6) сақтау қаптары.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

ӨЛШЕМІ (Б × Е × Т): 179.5×72×48.4 mm (массажер), 81×69.8×64.8 mm (база)

ҚУАТЫ: 10 W

ЖҰМЫС КЕРНЕУІ: 3,7 V

ҚУАТ КӨЗІ: кірістірілген литий-полимерлі аккумулятор

АККУМУЛЯТОР СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ: 1350 mAh

ЗАРЯДТАУ УАҚЫТЫ: 3 h

ЖҰМЫС УАҚЫТЫ: 35 min

АҚЫЛДЫ ТАЙМЕР: 10 минут. Жылы режим - 5 минут, суық режим - 3 минут

ДІРІЛ ЖЫЛДАМДЫҒЫ: минутына 7000 айналым

ТОК КҮШІ: 1-деңгей - 1.9 mA; 2-деңгей - 2.48 mA; 3-деңгей - 3.44 mA

ТОК ЖИІЛІГІ: Әлсіз деңгей - 20 kHz; орташа - 25.2 kHz; жоғары - 30.6 kHz

ТОЛҚЫН ҰЗЫНДЫҒЫ: Қызыл LED жарығы - 630 nm; көк LED жарығы - 460 nm; жасыл LED жарығы - 520 nm

ТОЛҚЫН ПІШІНІ: екі фазалы симметриялы толқын

СӘУЛЕЛЕНУ ҚАРҚЫНДЫЛЫҒЫ:
Қызыл жарық - 10 mW/cm2; көк жарық - 24 mW/cm2; жасыл жарық - 21 mW/cm2

СУДАН ҚОРҒАНЫСЫ: IPX3



MORI BLACK - ЭЛЕКТРЛІК ДЫБЫСТЫҚ ТІС ЩЕТКАСЫ

Қызыл иекті нығайтады

Тістерді тазартады

Тіс тасын кетіреді

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: тіс тазалау, тіс қағы, ауыздан жағымсыз иіс, қызыл иек аурулары.

МАТЕРИАЛЫ: пластик.

САЛМАҒЫ: 200 g.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
Щетка жоғары жиілікті діріл қағидасымен жұмыс істейді. Тазалау дыбыспен емес, дыбыс толқыны (=жоғары жиілікті діріл) іске қосатын қылшықтардың жылдам тербелісімен орындалады. Қылшықтар қызыл иектен тіс шетіне қарай жылдам сыпыру қозғалыстарын жасайды. Жоғары жылдамдық сілекей, су және тіс пастасынан микрокөпіршіктер ағынын түзеді. Ауыздағы осындай динамикалық сұйықтық ағыны қиын жететін жерлерді де тиімді тазартады.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:
1. 5 жұмыс режимі: жұмсақтан (31000 тербеліс) ең қарқындыға дейін (48000 тербеліс).
2. Жинақта жұмсақ және орташа қатты қылшықтары бар 2 түрлі саптама.
3. Тазалау аймағын ауыстыру туралы дыбыстық еске салулар.
4. Орташа қатты саптаманың қылшықтары түсін өзгертіп, саптаманы ауыстыру қажет екенін еске салады.
5. Жад функциясы.
6. Зарядтау базасының ұзын кабелі.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ:
1. Саптаманы электр қозғалтқыш ұшының білігіне (беріліс білігіне) дәл келтіріп, щеткаға орнатыңыз. Маңызды: орнатқанда саптаманы бұрудың қажеті жоқ.
2. Щетканы қосу үшін қосу/өшіру/режим ауыстыру батырмасын қысқа басыңыз.
3. Батырманы қайта қысқа басу режимдерді мына ретпен ауыстырады: сезімтал тістер (Sensitive), қызыл иек күтімі (Gum care), жылтырату (Polish), ағарту (White), тазалау (Clean).
4. Әр 30 секунд сайын щетка кідіріп, тазалау аймағын ауыстыруды еске салады.
5. 2 минуттан кейін автоматты жұмыс уақыты аяқталып, щетка өшеді.
6. Щетканы өзіңіз өшіру үшін қосу/өшіру/режим ауыстыру батырмасын басыңыз.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Саптаманы орнатыңыз.
2. Саптаманы сумен сулап, қажетті мөлшерде тіс пастасын жағыңыз.
3. Щетканы қосыңыз.
4. Саптаманы ауызға салып, қызыл иекке қатысты 45 градус бұрышпен ұстаңыз. Қосу батырмасын басып, ыңғайлы жұмыс режимін таңдаңыз.
5. Тістерді тазалай бастаңыз. Щетка басын тіс түбінен шетіне қарай сыпыру қозғалыстарымен жүргізіңіз.
6. Тіс дәрігерлері кемінде 2 минут тазалауды ұсынады. Ауыз қуысын 4 аймаққа бөліп, тіс қатарының әр ширегін (квадрантын) 30 секунд тазалауға болады.
Осы ұсынымды сақтау үшін щеткада әр 30 секундқа таймер орнатылған:
Щетка бірнеше секунд тоқтайды. 2 минуттан кейін автоматты жұмыс уақыты аяқталып, өшеді.
7. Процедурадан кейін саптаманы шайып, табиғи түрде кептіріңіз. Щетка корпусын да сумен шаюға болады.

ҚОЛДАНУ ЖИІЛІГІ:
Күніне 2 рет, 1 тазалау сеансы - 2 минут.

ҚОЛДАНУ ҰЗАҚТЫҒЫ:
1 саптаманың қолдану мерзімі - 3 ай.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Инфекциялық пародонтит.
2. Операциядан кейінгі немесе ауыздағы жаралардың жазылу кезеңі.
3. Тістердің жоғары сезімталдығы.
4. Тістердің патологиялық қозғалғыштығы.
5. Балалардың қолдануына арналмаған.

ЕСКЕРТУЛЕР:
1. Дыбыстық тіс щеткасының саптамасын әр қолданудан кейін сумен жуыңыз.
2. Щетка корпусын тікелей сумен тазалауға болады.
3. Жазатайым жағдайдың алдын алу үшін зарядтау кезінде базаға металл заттарды қоймаңыз.
4. Корпусы немесе саптамасы зақымдалса, щетканы қолданбаңыз.
5. Жылу көздерінен алыс ұстаңыз.
6. Электрлік дыбыстық тіс щеткасын өзіңіз жинамаңыз және бөлшектемеңіз.

ЖИНАҚ ҚҰРАМЫ: (1) тіс щеткасының корпусы, (2) жұмсақ қылшықты саптама,
3. орташа қатты қылшықты саптама, (4) индукциялық зарядтау базасы,
5. нұсқаулық.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

ЗАРЯДТАУ УАҚЫТЫ: 12 h

ЖҰМЫС УАҚЫТЫ: 240 min

АҚЫЛДЫ ТАЙМЕР: 2 min

РЕЖИМДЕР МЕН ДІРІЛ:
• Жұмсақ - минутына 31000 айналым
Қызыл иек күтімі - минутына 35000 айналым
• Жылтырату - минутына 41000 айналым
• Ағарту - минутына 45000 айналым
Тазалау - минутына 48000 айналым

СУДАН ҚОРҒАНЫСЫ: IPX7



MORI 2.0 - ЭЛЕКТРЛІК ДЫБЫСТЫҚ ТІС ЩЕТКАСЫ

Қызыл иекті нығайтады

Тістерді тазартады

Тіс тасын кетіреді

Гингивиттің алдын алуға көмектеседі

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: тіс тазалау, тіс қағы, ауыздан жағымсыз иіс, қызыл иек аурулары.

МАТЕРИАЛЫ: PC пластигі.

САЛМАҒЫ: 110 g.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
Щетка жоғары жиілікті діріл қағидасымен жұмыс істейді. Тазалау дыбыспен емес, дыбыс толқыны іске қосатын қылшықтардың жылдам тербелісімен орындалады.

Щетка физикалық қысымды электр сигналына айналдыратын басу күші датчигімен жабдықталған.

MORI 2.0 тазалауды талдауға арналған 3D картасын құрастыру функциясымен жабдықталған. Залалсыздандыру қорабындағы ультракүлгін стерилизатор микробтар мен вирустарды жояды.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:
1. АҚЫЛДЫ ТАЙМЕР
2. 5 кәсіби тазалау режимі:
• Жұмсақ (сезімтал тістерге арналған режим)
• Тазалау (стандартты тазалау)
• Ақ эмаль (ағарту)
• Жылтырату
• Массаж
3. Шашыраудан қорғау жүйесі.
4. Қарқындылықты реттеу: әр режимде ыңғайлы баптауды таңдауға арналған 5 деңгей (10, 30, 50, 70 және 90) бар.
5. Тазалау аймақтарының интерактивті 3D индикациясы.
6. Ультракүлгін стерильдеу қорабы.
7. Саптаманы ауыстыру туралы ескерту.
8. Заряд индикаторы және зарядтау кезіндегі бақылау.
9. LED индикациясы бар қысым датчигі.
10. Әртүрлі тазалауға арналған үш түрлі ауыстырмалы саптама:
• Күнделікті гигиенаға арналған классикалық тазалау саптамасы
• Жылтырату әсері күшейтілген ағарту саптамасы
• Сезімтал тістерге арналған жұмсақ қылшықты саптама

11. Жад функциясы.
12. Саптаманы автоматты анықтау.
13. Автоматты қосылу.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ:
1. MORI 2.0 тіс щеткасының автоматты қосылу функциясы бар:
корпусты алақаныңызбен ұстағанда щетка қосылады.
2. Қосу/өшіру/функция таңдау батырмасын қысқа басып, щетканы қосыңыз.
3. Функция ауыстыру батырмасымен мәзірді айналдырыңыз. Бөлімді таңдау үшін қосу/өшіру/функция таңдау батырмасын қысқа басыңыз.
4. «Мәзір/Setting» тармағын тауып, ашыңыз. Мәзірден «3D OFF / 3D өшірулі» тармағын таңдаңыз. Қосу/өшіру батырмасын бір рет басып, оны қосыңыз.
5. Тілді таңдаңыз. MORI 2.0 әрі қарай баптауға және қолдануға дайын.
6. Қажетті саптаманы электр қозғалтқыш ұшының білігіне (беріліс білігіне) дәл келтіріп орнатыңыз. Содан кейін MORI 2.0 щеткасын нұсқаулыққа сай баптауды жалғастырыңыз.
7. Баптаулар бөліміндегі «Тазалау уақыты» тармағын таңдаңыз. Функция таңдау батырмасымен 2/3/4 минутты немесе «Шектеусіз» режимін орнатыңыз.
8. «Артқа» тармағын таңдап, «Баптаулардан» жалпы мәзірге оралыңыз.
9. Мәзірде тазалау режимін таңдаңыз.
10. Режимді таңдағаннан кейін функция таңдау батырмасымен қарқындылықты орнатыңыз. MORI 2.0 щеткасында әр режимге арналған 5 қуат деңгейі бар: 10, 30, 50, 70 және 90.
11. MORI 2.0 жад функциясымен жабдықталған. Режимді 10 секундтан артық қолдансаңыз, щетка оны есте сақтап, келесі жолы сол режимді қосады.
12. MORI 2.0 тазалау аймағын ауыстыруды еске салу үшін қысқа кідіреді. Тазалау уақыты 2 минут болса, әр 30 секунд сайын; 3 минут болса, әр 45 секунд сайын; 4 минут болса, әр минут сайын тоқтайды. Шектеусіз уақытты («Unlimited») таңдасаңыз, щетка кідірмейді.
13. MORI 2.0 дыбыстық тіс щеткасы басу күші датчигімен жабдықталған. Артқы панельдегі жарық индикаторы қысымды бақылау үшін түсі мен діріл түрін өзгертіп, «ду-ду-ду» дыбысын шығарады.
14. Автоматты тазалау уақыты аяқталғанда щетка өшеді. Өзіңіз тоқтатқыңыз келсе, тазалау басталғаннан 5 секунд өткеннен кейін қосу/өшіру батырмасын қысқа басыңыз.
15. Тазалаудан кейін дисплейде қалған заряд деңгейі және ауыз қуысының картасымен тазалау нәтижесі көрсетіледі.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Саптаманы орнатыңыз.
2. Саптаманы сумен сулап, қажетті мөлшерде тіс пастасын жағыңыз.
3. Саптаманы ауызға салып, қызыл иекке қатысты 45 градус бұрышпен ұстаңыз. Қылшықтарды қызыл иек сызығына немесе сәл жоғары жеңіл тигізіңіз.
4. Щетканы қосып, ыңғайлы жұмыс режимін таңдаңыз.
5. Тістерді тазалай бастаңыз. Щетка басын тіс түбінен шетіне қарай сыпыру қозғалыстарымен жүргізіңіз.
6. Жоғарғы тіс қатарының ішкі бетін тазалау үшін щетканы тік ұстаңыз: басын тіске тігінен қойып, әр тісті тазалаңыз.
7. Белгіленген тазалау уақыты аяқталғанда щетка тоқтайды. Дисплейде қалған заряд, содан кейін тазалау нәтижесі бар ауыз қуысының 3D картасы көрсетіледі.

8. Өткен процедураны 3D картамен талдаңыз: бұл мінсіз тазалауға жетуге көмектеседі.
9. Процедурадан кейін саптаманы шайып, табиғи түрде кептіріңіз. Щетка корпусын да сумен шаюға болады.

ҚОЛДАНУ ЖИІЛІГІ:
Күніне 2 рет, 1 тазалау сеансы - 2 минут.

ҚОЛДАНУ ҰЗАҚТЫҒЫ:
1 саптаманың қолдану мерзімі - 3 ай.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Инфекциялық пародонтит.
2. Операциядан кейінгі немесе ауыздағы жаралардың жазылу кезеңі.
3. Тістердің жоғары сезімталдығы.
4. Тістердің патологиялық қозғалғыштығы.
5. Балалардың қолдануына арналмаған.

ЕСКЕРТУЛЕР:
1. MORI 2.0 щеткасын 8 жастан асқан балалар және сезу, дене не ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдар қолдана алады, егер олар құрылғыны қолдану туралы нұсқау алып, қауіпсіз тәсілдер мен дұрыс қолданбаудың ықтимал қауіптерін түсінсе.
2. Құрылғыны балалар ойыншығы ретінде қолдануға тыйым салынады.
3. Балалар тіс тазалау мен құрылғыны қолдануды тек ересектердің бақылауымен орындауы тиіс.

ЖИНАҚ ҚҰРАМЫ: (1) тіс щеткасының корпусы, ауыстырмалы саптамалар: (2) сезімтал тістерге, (3) ағартуға, (4) тазалауға арналған саптама, (5) Type-C зарядтау сымы,
6. сақтау қабы, 7) нұсқаулық, 8) саптамаларды залалсыздандыру қорабы.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

ЗАРЯДТАУ УАҚЫТЫ: 8 h

АҚЫЛДЫ ТАЙМЕР: 2 min

ЖҰМЫС УАҚЫТЫ: • Жұмсақ режим - 1200 минут; • тазалау - 250 минут; • эмальді ағарту - 400 минут; • жылтырату - 500 минут; • массаж - 400 минут

РЕЖИМДЕР МЕН ТЕРБЕЛІС ЖИІЛІГІ:
• Жұмсақ (минутына 28000 тербеліс)
Тазалау (минутына 37000 тербеліс)
• Ақ эмаль (минутына 41000 тербеліс)
Жылтырату (минутына 36000 тербеліс)
Массаж (минутына 35000 тербеліс)

СУДАН ҚОРҒАНЫСЫ: IPX7



NEO - ТЕРІНІ ЖАСАРТУҒА АРНАЛҒАН ҚҰРЫЛҒЫ

Лифтинг әсері

Тері мәселелеріне әсер етеді

Тері серпімділігі мен созылғыштығын қалпына келтіреді

Пигментацияны азайтады

Тыртықтарды азайтады

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: бет контурының жасқа байланысты өзгерістері, әжімдер, босаңсыған тері, пигментация, безеу, розацеа, тыртықтар мен тыртық іздері, созылу іздері.

МАТЕРИАЛДАРЫ: ABS пластигі, PC пластигі, силикон.

САЛМАҒЫ: Базасы бар массажер - 183 g.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
NEO массажері төмен температуралы (суық) плазма технологиясына негізделген. Плазма - бейтарап молекулалардан тұратын және зарядталған бөлшектерді: бос электрондар мен оң және теріс иондарды қамтитын газ. Ол теріні залалсыздандырады, безеу мен розацеаға қарсы әсер етіп, қабынудың алдын алады. Коллаген талшықтарының тығыздығын қалпына келтіруді ынталандыру арқылы жаралар мен тыртықтардың жазылуына ықпал етеді. Плазма жасартатын процестермен байланысты гендерді белсендіргенде беттегі әжімдер мен терең қатпарлар азаяды. Плазма әсерінен липидтік қосқабаттар қайта құрылып, әртүрлі заттар өтетін арналар түзіледі, бұл косметиканың сіңуін арттырады. Сондай-ақ плазма меланин шоғырларын ыдыратып, пигментацияны ағартады.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:
1. Түпнұсқа патенттелген дизайн WAU брендіне арнайы әзірленген. Массажердің артқы бөлігінің дөңгеленген пішіні қолда ыңғайлы ұстап, барынша оңай әрі жайлы массаж жасауға мүмкіндік береді.
2. Ыңғайлы жұмыс беті терінің үлкен аймақтарын да, қиын жететін жерлерін де өңдейді. Соңғыларына арнайы жіңішке жоғарғы ұшы қарастырылған.
3. Теріні плазма әсеріне біртіндеп дайындауға арналған 3 қарқындылық деңгейі.
4. Қолдануға ыңғайлы: массажер 1 батырмамен басқарылады, 10 минуттық ақылды таймері бар.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ:
Құрылғыға су тигізуге, дымқыл қолмен ұстауға немесе дымқыл теріге қолдануға тыйым салынады: бұл қауіпті болуы мүмкін.
1. Қосу/өшіру батырмасын ұзақ басып (2 секунд), құрылғыны қосыңыз. Қосылғанда дыбыстық белгі естіледі.
2. Қарқындылық индикаторлары бар дисплей жанады. Құрылғыда 3 әсер күші бар: STRONG (күшті), MEDIUM (орташа), SOFT (әлсіз). Деңгей ауыстыру батырмасын қайта басып, өзіңізге сәйкесін таңдаңыз. Алдымен SOFT деңгейі қосылып, белгісі жанады. Қайта басқанда MEDIUM, келесі басқанда STRONG деңгейі қосылады.
3. Ақылды таймер құрылғыны 10 минут жұмыстан кейін дыбыстық белгі беріп, автоматты түрде өшіреді.
4. Құрылғыны өшіру үшін қосу/өшіру/қарқындылық ауыстыру батырмасын басып тұрыңыз.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Әдеттегі тазартқышпен жуыныңыз. Теріні кір мен артық майдан тазартыңыз.
2. Беттегі барлық сұйықтық ізін кетіріп, массажерді қолданар алдында терінің толық кебуін күтіңіз. Терідегі су құрылғыны қолданғанда айтарлықтай жайсыздық туғызуы мүмкін.
3. Құрылғыны қосып, қажетті қарқындылықты таңдаңыз. Тері бейімделуі үшін ең төмен әсер күшінен бастау ұсынылады.
4. Процедура кезінде құрылғыны теріге жақын қыспаңыз: тері бетінен 2-3 mm қашықтықта ұстаңыз. Массаж сызықтарымен төменнен (иектен) жоғары (шаш өсу сызығына) қарай баяу жүргізіңіз. Мәселелі аймақтарға ерекше назар аударыңыз. Қолданғанда плазма түзілу дыбысы естіледі және озон иісі сезілуі мүмкін: бұл қалыпты.
5. Процедурадан кейін құрылғыны өшіріп, теріні ылғалдандыру үшін күтім косметикасын жағыңыз. Жақсы сіңуі үшін жеңіл массаж жасаңыз.
6. Жұмыс бетін дымқыл (спирт сіңірілген) майлықпен тазалаңыз. Ескерту: процедурада плазмамен ыдыраған шаң мен тері майының қалдықтары жұмыс бетінің керамикалық бөлігіне оңай жабысады. Бұл керамиканың сарғаюына әкелуі мүмкін, бірақ құрылғының тиімділігіне әсер етпейді.

ҚОЛДАНУ ЖИІЛІГІ МЕН ҰЗАҚТЫҒЫ:

ТЕРІ ТҮРІ / МӘСЕЛЕ	ТӘУЛІК УАҚЫТЫ	ҰЗАҚТЫҒЫ МЕН РЕТІ	ЖИІЛІГІ	КУРС
БЕЗЕУ / ҚАБЫНУ	Таңертең	Бастапқы курс: беттің әр аймағына 5-10 минут. Бір процедураның жалпы ұзақтығы - 20-30 минутқа дейін. Тері бейімделуі үшін қуатты біртіндеп арттыру ұсынылады: 1-апта - ең төмен деңгей (тері сезімтал болса, ең төмен деңгейді 2 апта қолданыңыз); 2-апта - орташа деңгей; 3-аптадан бастап, тері жақсы бейімделсе - ең жоғары деңгей. Қолдау курсы (алдын алу): бүкіл бетке 10-20 минут.	Бастапқы курс: аптасына 2-3 рет (негізгі белгілер жойылғанша жалғастыруға болады). Қолдау курсы (алдын алу): әр 10-14 күнде 1 рет.	Бастапқы курс: 6-8 апта. Аяқтағаннан кейін терінің қалпына келуі және тұрақты ынталандыруға үйреніп кетпеуі үшін 1-2 ай үзіліс жасау ұсынылады.
ПИГМЕНТАЦИЯ	Кешке		Аптасына 2 рет, гиперпигментация аймақтарына назар аударып	
ЖАСҚА БАЙЛАНЫСТЫ ӨЗГЕРІСТЕР	Кешке		Бастапқы курс: аптасына 2-3 рет. Қолдау курсы (алдын алу): аптасына 1 рет (әр 10-14 күнде 1 рет қолдануға да болады).	
ТЫРТЫҚТАР	Кешке	Тыртық көлеміне қарай 5-10 минут. Бетке: ең төмен қуаттан бастап, 3 сеансқа дейін қолданыңыз, кейін біртіндеп арттырыңыз. Денеге: орташа қуаттан бастап, 3 сеансқа дейін қолданыңыз, кейін біртіндеп арттырыңыз.	Аптасына 2 рет	ПРОЦЕДУРАЛАР КУРСЫ: 1-1.5 ай. Қайталау: жылына 2-3 курс. Курстар арасында: айына 1-2 процедура.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Балаларға, аллергиясы бар адамдарға және бетке/көзге операция жасалған адамдарға қолдануға тыйым салынады.
2. Құрылғыға су тигізуге, дымқыл қолмен ұстауға және дымқыл теріге қолдануға тыйым салынады.

ЕСКЕРТУЛЕР:
1. Құрылғы суға батырылған, дұрыс жұмыс істемейтін, зақымдалған немесе сынған болса, қолданбаңыз.
2. Құрылғыны көз аймағында (жоғарғы және төменгі көз ұясы сүйегінің бойында), самайда, қалқанша безде, кеуде мен жыныс мүшелерінде қолданбаңыз.
3. Құрылғыны бөлшектемеңіз: зақым, ақау, электр тогының соғуы, өрт немесе жарақат болуы мүмкін.

ЖИНАҚ ҚҰРАМЫ: (1) құрылғы, (2) тұғыр-база, (3) зарядтау кабелі, (4) сақтау қабы, (5) майлық, (6) нұсқаулық.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

ЗАРЯДТАУ УАҚЫТЫ: 3 h

ЖҰМЫС УАҚЫТЫ: 60 min

АҚЫЛДЫ ТАЙМЕР: 10 min

ТОК КҮШІ: • ЖҰМСАҚ режим - 590 mA (құрылғы тері бетіне жанасқанда), 278 mA (теріге жанаспай тұрғанда); • ОРТАША режим - 1670 mA (тері бетіне жанасқанда), 570 mA (теріге жанаспай тұрғанда); • КҮШТІ режим - 1820 mA (тері бетіне жанасқанда), 1010 mA (теріге жанаспай тұрғанда)

СУДАН ҚОРҒАНЫСЫ: IPX3



REN - БЕТТІ УЛЬТРАДЫБЫСПЕН ТАЗАЛАУҒА АРНАЛҒАН СКРАББЕР

Тазалау

Микроайналымды жақсартады

Қабыршақтандыру

Күтім құралдарының сіңуін жақсартады

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: терінің қатты майлануы, кеңейген тесіктер, комедондар, безеу, өңсіз әрі сау емес бет реңі, тері серпімділігінің төмендеуі.

МАТЕРИАЛДАРЫ: ABS пластигі, силикон.

САЛМАҒЫ: 140 g.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
«Терең тазалау» режиміндегі жоғары жиілікті ультрадыбыстық діріл мен оң иондар теріні жұмсақ тазартады. Ультрадыбыс толқындары эпидермистің жоғарғы қабатындағы бөлшектерді қабыршақтандырып, беткі кір мен май бездерінің жиналған бөлінділерін кетіреді. Ылғалдандыру режимінде сол ультрадыбыс теріс иондармен бірге қан айналымы мен коллаген/эластин түзілуін арттырып, косметиканың белсенді сіңуіне көмектеседі. Осылайша күтім косметикасының әсері айқынырақ болады.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:
1. Үйде қолдануға арналған ықшам құрылғы.
2. Магниттік қақпақ тазарту бетін қорғайды және гигиеналық қолдану ережелерін сақтауға мүмкіндік береді.
3. Қуатты аккумулятор: қайта зарядтамай 100 минутқа дейін ұзақ дербес жұмыс.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ:
1. Құрылғы 1 батырмамен басқарылады. Қосу үшін «Қосу/өшіру/режим ауыстыру» батырмасын ұзақ басыңыз. Қосылғанда ұзақ дыбыстық белгі естіледі.
2. Алдымен «Терең тазалау» режимі қосылады. Тиісті индикатор жанып, үздіксіз ультрадыбыстық діріл дыбысы естіледі.
3. Режимді ауыстыру үшін «Қосу/өшіру/режим ауыстыру» батырмасын қайта басыңыз. Ауысқанда қысқа дыбыстық белгі естіледі.
4. Құрылғы «Ылғалдандыру» режимінде жұмыс істей бастайды. Тиісті индикатор жанып, пульсациялық ультрадыбыстық діріл дыбысы естіледі.

5. «Қосу/өшіру/режим ауыстыру» батырмасын басып, құрылғыны өшіріңіз.
6. Ақылды таймер скрабберді 10 минут жұмыстан кейін автоматты түрде өшіреді.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
РЕЖИМ: ТЕРЕҢ ТАЗАЛАУ
1. Қолданар алдында макияжды кетіріп, бетті тазартқышпен жуыңыз.
2. Ең жақсы әсер үшін тазалау алдында дезинкрустация гелімен (ультрадыбыстық тазалау гелі) салқын буландыру процедурасы ұсынылады. Көзге тигізбей бетке гель жағып, үлдірмен жабыңыз. 15 минут ұстап, содан кейін скраббермен тазалауға кірісіңіз. Ультрадыбыстық тазалау гелі немесе лосьонынан бөлек физиологиялық ерітінді не термалды суды да қолдануға болады.
3. «Қосу/өшіру/режим ауыстыру» батырмасымен «Терең тазалау» режимін қосыңыз.
4. Құрылғының алдыңғы жағын төмен қаратып, скраббер қалақшасын теріге 40 градус бұрышпен ұстаңыз. Беттің қажетті аймақтарын тазалау үшін аппликаторды массаж сызықтарымен жылжытыңыз.
5. «Терең тазалау» процедурасы 5 минуттан аспауы тиіс.
6. Құрылғыны өшіріңіз немесе келесі режимге ауыстырыңыз.
7. Бетті жылы сумен жуып, аппликаторды құрғатып тазалаңыз.
8. Тазалаудан кейін ылғалдандыру процедурасына кірісу ұсынылады.
1. Бетті тазалағаннан кейін таңдалған күтім құралын біркелкі жағыңыз.
2. Құрылғыны қосып, батырманы қайта басу арқылы ылғалдандыру режиміне ауысыңыз.
3. Құрылғыны алдыңғы жағын жоғары қаратып аударыңыз: скраббер қалақшасы қырымен тірелмей, теріге жалпақ жатуы тиіс. Аппликаторды бетке тигізіп, күтім құралы толық сіңгенше массаж сызықтарымен жоғары қарай жұмсақ сырғытыңыз.
4. Бұл режимде процедураны мойыннан бастап, ортадан шетке қарай жылжыту ұсынылады.
5. Иектен маңдайға қарай массажды жалғастырыңыз: қалақшаны ортадан шетке қарай жүргізіңіз.
6. «Ылғалдандыру» режимінде 3-5 минут жұмыс істеуге болады. Аяқтағанда «Қосу/өшіру» батырмасын ұзақ басып, скраббер өшіріңіз.
7. Аппликаторды сүртіп, скраббер орнына қойыңыз.

ҚОЛДАНУ ЖИІЛІГІ МЕН ҰЗАҚТЫҒЫ:

ТЕРІ ТҮРІ / МӘСЕЛЕ	ТӘУЛІК УАҚЫТЫ	ҰЗАҚТЫҒЫ МЕН РЕТІ	ЖИІЛІГІ	ПРОЦЕДУРАЛАР КУРСЫ
МАЙЛЫ ТЕРІНІ ТАЗАЛАУ / БЕЗЕУ	Кешке жасау ұсынылады. Процедурадан кейін макияж жақпаңыз.	Терең тазалау: 5 минут. Ылғалдандыру: 5 минут. Осы ретпен қолданыңыз. Ылғалдандыру режимі тек терең тазалаудан кейін тиімді.	Аптасына бір реттен асырмаңыз	3-4 апта. 2 апта үзіліс жасаңыз. 3-4 апталық курсты қайталап, осы циклді жалғастырыңыз.
КУПЕРОЗ / КӨРІНЕТІН ҚАН ТАМЫРЛАРЫ			Айына екі реттен асырмаңыз	Қажетіне қарай

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Құрылғы жеке қолдануға арналған. Оны басқа адамдармен ортақ пайдаланбаңыз.
2. Операциядан кейін бір ай бойы немесе бет терісінде ауыр күн күйігі болса, қолданбаңыз.
3. Қабынған немесе зақымдалған теріге қолданбаңыз.
4. Көзге қолданбаңыз.
5. Көктамыр немесе артерия патологиялары бар аймақтарға, тромбофлебиті бар немесе бұрын қан ұюының бұзылыстары болған адамдарға қолдануға тыйым салынады.

ЕСКЕРТУЛЕР:
1. Құрылғыны терінің бір аймағында ұзақ қолданбаңыз.
2. Құрылғыны жоғары температурадан алыс ұстаңыз.
3. Бет импланттары, металл тіс сауыттары, штифтер немесе брекеттер болса, өз сезіміңізді бақылаңыз. Ауырсыну не жайсыздық сезілсе, қолдануды тоқтатыңыз.

ЖИНАҚ ҚҰРАМЫ: (1) ультрадыбыстық скраббер, (2) магниттік қақпақ, (3) USB-Type C кабелі, 4. нұсқаулық, (5) сақтау қабы.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

ЗАРЯДТАУ УАҚЫТЫ: 2 h

ЖҰМЫС УАҚЫТЫ: 100 min

АҚЫЛДЫ ТАЙМЕР: 10 min

УЛЬТРАДЫБЫС ЖИІЛІГІ: 25±5 kHz

СУДАН ҚОРҒАНЫСЫ: IPX4



SARA - ШАШ КЕПТІРГІШ ЖӘНЕ ТҮЗЕТКІШ, 2 ФУНКЦИЯ 1 ҚҰРЫЛҒЫДА

Құрғақ және дымқыл шашқа арналған

Жылдам кептіру

Шашты сәндеп, пішін береді

Жұмсақ әсер

Үлпілдеуді бақылау

Шашты түзетеді

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: кәдімгі түзеткіштерден шаштың зақымдалуы, үлпілдеу, статикалық электр, дымқыл шашты сәндеу қиындығы, жылтырдың жоғалуы.

МАТЕРИАЛДАРЫ: MS пластигі, ABS пластигі.

САЛМАҒЫ: 441 g (сым салмағын қоспағанда), 657 g (сымымен).

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
КЕПТІРУ: ішінде минутына 110000 айналым жасайтын жоғары жылдамдықты BLDC қозғалтқышы бар. Ол қуатты ауа ағынын (12 m/s-қа дейін) жасайды. Шаш жоғары температурада «күйдіру» арқылы емес, бетіндегі ылғалды физикалық үрлеу арқылы кебеді. ИОНДАУ: кептіру кезінде теріс зарядталған иондар ағыны (30 миллионнан астам) түзіледі. Шаштың әдетте оң заряды болады, сондықтан талшықтары бірін-бірі тебеді (үлпілдеу әсері). Теріс иондар бұл зарядты бейтараптандырып, бұрымдарды көнбіс етеді. ТҮЗЕТУ: ауа пластиналардың бойындағы жіңішке саңылаулардан 45 градус бұрышпен шығып, бағытталған қысым жасайды. Пластиналарды қысқанда ағын жылдамдап, шаш қабыршақтарын өзегіне «басады». Жылу мен бағытталған ауа әсерінен дымқыл шаштағы сутектік байланыстар уақытша үзіліп, түзу пішінде қайта құрылады. Ауамен үрленген шаш түзетілген күйінде кеуіп, нәтижені бекітеді. СУЫҚ АУА (БЕКІТУ): соңғы кезеңде суық ағын қызған шашты бірден суытып, кутикуланы «жабады». Бұл айнадай жылтыр беріп, шаш үлгісін тұрақты етеді.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:
1. Кептіру және түзету: 2 функция 1 құрылғыда. SARA оларды бір процедурада біріктіріп, жалпы сәндеу уақытын қысқартады.
2. Шаш қауіпсіздігі: ауамен түзету кәдімгі түзеткіштің қатты қызған пластиналарымен жанасудан әлдеқайда жұмсақ.
3. Жеке баптау. Ағынның 3 жылдамдығы мен 5 температура режимі кез келген шаш түріне оңтайлы күтім таңдауға мүмкіндік береді.
4. Әмбебап кернеу. Кең кернеу ауқымы әлемнің кез келген жерінде тұрақты әрі қауіпсіз жұмысты қамтамасыз етеді.

5. Арнайы DRY (құрғақ) және WET (дымқыл) режимдері: құрғақ және дымқыл шашпен тиімді жұмыс істеуге арналған ойластырылған баптаулар.
6. Ақпараттық LCD дисплейі барынша ыңғайлы қолдану үшін жұмыс параметрлерін толық бақылауға мүмкіндік береді.
7. Көпфункциялы бекіткіш-құлып жиналған құрылғыны толыққанды фен ретінде қолдануға мүмкіндік береді.
8. Ақылды үзіліс. 10 секундтан артық қолданылмаса, құрылғы күту режиміне автоматты түрде өтеді, ал 3 минуттан кейін өшеді.
9. Жад функциясы. Құрылғы соңғы баптауларды есте сақтап, келесі қосылғанда жұмысты бірден бастауға мүмкіндік береді.
10. Қуатты иондау. Генератор 30 миллионнан астам ион шығарып, статикалық электрді бейтараптандырады, шашқа айнадай жылтыр мен жібектей жұмсақтық береді.
11. Қозғалтқыш жылдамдығы. Жоғары жылдамдықты қозғалтқыш (минутына 110000 айналым) ылғалды тез кетіретін қуатты бағытталған ағын жасайды.
12. Өздігінен тазалау режимі. Қозғалтқышты автоматты тазалау функциясы ең жоғары үрлеу қуатын сақтап, қызмет мерзімін ұзартады.
13. Сым ұзындығы: кәсіби немесе үйде қолдануға арналған 2 метр еркін қозғалуға мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ:
1. Фен ашасын розеткаға толық енгізіңіз. Дисплейде OFF белгісі жанады: бұл құрылғының өшірулі екенін білдіреді.
2. Құрылғыда түзеткіш пластиналарын жабық ұстайтын бекіткіш-құлып бар. Пластиналарды ашу үшін жүгірткісін төмен жылжытыңыз. Құлып ашылғанда пластиналар ашылып, түзету үшін арасына шаш бұрымын салуға болады.
3. Пластиналарды бірге ұстау үшін оларды жауып, құлыпты жоғары жылжытыңыз. Жабық күйінде құрылғы фен ретінде жұмыс істейді. Құлыпталған күйі қауіпсіз сақтау мен тасымалдауды да қамтамасыз етеді.
4. Қосу/өшіру батырмасымен құрылғыны қосыңыз. Пластиналар ашық кезде ауа ағыны ең төмен болады. Жұмысқа кірісіп, белгіленген үрлеу жылдамдығын қосу үшін фен-түзеткішті қысыңыз.
5. Режим таңдау батырмасымен кептіру не сәндеуге қажетті баптауларды таңдаңыз.
6. WET режимі жуғаннан кейінгі шашқа арналған және оны бір уақытта кептіріп, түзетуге мүмкіндік береді.
7. DRY режимі кепкен шашты тегістеп, пішінін бекітуге арналған.
8. Температура реттеу батырмасымен қажетті параметрлерді орнатыңыз.
9. WET режимінде ылғалды қарқынды буландырып, бұрым пішінін жылдам қалыптастыру үшін жоғары баптаулар бар: 120 °C, 140 °C және 160 °C.
10. DRY режимінде кепкен шаштың қызып кетуінен қорғау үшін 80 °C, 110 °C және 140 °C температуралары қолжетімді.
11. Температура Цельсиймен немесе Фаренгейтпен көрсетіледі. Өлшем бірлігін өзгерту үшін температура батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз.
12. Жылдамдық батырмасымен 3 ауа үрлеу жылдамдығының 1-еуін таңдаңыз. Белгідегі қалақша саны жылдамдыққа сәйкес келеді: төмен - 1, орташа - 2, күшті ағын - 3 қалақша.

13. Автоматты тазалау режимін қосу үшін жылдамдық батырмасын 5 секунд басып тұрыңыз. Алдын ала магниттік сүзгіні алыңыз. Тазалау 15 секундқа созылып, автоматты түрде тоқтайды. Сүзгіні орнына қойыңыз.
14. Суық режимді қолданғыңыз келсе, суық ауа батырмасын басыңыз.
15. Фен-түзеткіш қосулы, ашық күйінде 10 секундтан артық қолданылмаса, үзіліс режимі автоматты түрде іске қосылып, температура белгісі үздіксіз жыпылықтайды. Үзіліс режимінде 3 минуттан артық тұрса, құрылғы көрсетілген уақыттан кейін автоматты түрде өшеді.
16. SARA фен-түзеткішінде жад функциясы бар. Келесі қосылғанда соңғы қолданылған режим мен баптауларда іске қосылады.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Қолыңыз құрғақ, шашыңыз тым су емес екеніне көз жеткізіңіз (су тамшыламауы тиіс). Алдымен сүлгімен құрғату ұсынылады.
2. Сәндеу кезінде шатаспау үшін шашты сирек тісті тарақпен мұқият тараңыз.
3. Фен-түзеткішті қосыңыз.
4. WET режимін таңдаңыз.
5. Қажетті температура мен әсер жылдамдығын орнатыңыз.
6. Алдымен түбірлерді кептіру үшін SARA құрылғысын құлыпталған күйде (пластиналар жабық, бекіткіш жүгірткісі жоғары) фен ретінде қолданыңыз.
7. Бекіткіш-құлыпты төмен түсіріп, пластиналарды ашыңыз. Бұрымды түбірге барынша жақын салып, ауа шығатын тесіктерді шаш ұшына бағыттаңыз. Пластиналарды жауып, түзеткішті ұшына қарай баяу жүргізіңіз.
8. Құрғақ шашты сәндеуді жалғастырсаңыз, DRY режимін таңдаңыз.
9. Бұрымды пластиналардың арасына салып қысыңыз. Ауа ағыны таңдалған деңгейге дейін автоматты түрде күшейеді. Құрылғыны ұшына қарай бірқалыпты жүргізіңіз.
10. Кірістірілген иондағыш статикалық электрді бейтараптандырып, қозғалыс кезінде шаш кутикуласын тегістейді.
11. Барлық шашты кептіргеннен кейін пішінін бекітіп, қосымша жылтыр беру үшін суық режимді қосыңыз. Суық ауа шаш қабыршақтарын жауып, үлгіні тегіс әрі тұрақты етеді.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Құрылғыны тек адамның табиғи шашын сәндеуге қолданыңыз. Жасанды шашқа немесе жануарлардың жүніне қолданбаңыз.
2. Қыздыру элементтерімен басқа заттарды кептірмеңіз.
3. Жуынатын бөлмеде қолдануға тыйым салынады. Құрылғыны ешқашан ваннада, душта, су толы шұңғылшаның үстінде немесе дымқыл қолмен қолданбаңыз.
4. Құрылғыны суға батырмаңыз және ағын суға ұстамаңыз.
5. Су тамшылайтын тым су шашқа қолданбаңыз.
6. Құрылғы немесе қуат сымы зақымдалса, қоспаңыз. Құлаған, көрінетін зақымы бар немесе дұрыс жұмыс істемейтін құрылғыны да қолданбаңыз.
7. Зақым салдарынан электр бөлшектері ашылып қалса, құрылғыны қуат көзінен дереу ажыратыңыз.

8. Белгілі аурулары (мысалы, эпилепсия) немесе қозғалыс бұзылыстары (дискинезия) бар адамдар құрылғыны қолданудан бас тартуы тиіс.
9. Құрылғы дене, сезу немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдарға (соның ішінде балаларға), сондай-ақ тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдарға арналмаған. Олар тек бақылаумен немесе қолдану нұсқауын алған жағдайда пайдалана алады.

ЕСКЕРТУЛЕР:
1. Құрылғының қызған бөліктерін көз бен теріге тигізбеңіз.
2. Жұмыс кезінде құрылғыны ағаш, қағаз немесе мата беттеріне қоймаңыз. Тек тегіс, ыстыққа төзімді бетті қолданыңыз.
3. Қызып кету мен өрт қаупінің алдын алу үшін құрылғының үстіне немесе астына сүлгі не ұқсас зат қоймаңыз.
4. Құрылғыны жанғыш сұйықтықтар мен газдардың (мысалы, аэрозоль, сәндеу мусы) жанында қолданбаңыз.
5. Пластиналар зақымдалса, кез келген сәндеу майын немесе спрейін қолдануға тыйым салынады.
6. Қосар алдында желі кернеуінің құрылғыға сәйкес келетінін тексеріңіз. Салыстыру параметрлері корпус сабында көрсетілген.
7. Жұмыс кезінде ақау болса, тазалау алдында, өшіргеннен кейін немесе қолданылмай тұрғанда ашаны әрдайым розеткадан суырыңыз.
8. Сымды зақымданудан қорғаңыз. Ешқашан сымның өзінен тартпаңыз: розеткадан суырғанда ашадан ұстаңыз. Сымды құрылғының сыртына орамаңыз.
9. Жөндеуді тек уәкілетті сервистік орталықтар орындай алады. Ішінде пайдаланушы қызмет көрсете алатын бөлшектер болмағандықтан, өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Бұзылса, тұтынушылардың шағымдарын қабылдауға уәкілетті ұйымға хабарласыңыз.
10. Құрылғы қызып кетуден қорғайтын ажыратқышпен жабдықталған.

ЖИНАҚ ҚҰРАМЫ: (1) фен, (2) сақтау қабы, (3) нұсқаулық, (4) шаш қыстырғыштары.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

ҚУАТЫ: 1600 W

НОМИНАЛДЫ КЕРНЕУІ: 220-240 V

ҚОЗҒАЛТҚЫШ ЖЫЛДАМДЫҒЫ: минутына 110000 айналым

Жылдамдығы: секундына 12 метр

ТЕМПЕРАТУРА РЕЖИМДЕРІ: DRY режимі: 80 °C, 110 °C, 140 °C. WET режимі: 120 °C, 140 °C, 160 °C. Суық үрлеу.

ӨЛШЕМІ (Б × Е × Т): 329×55×38 mm

ШУ ДЕҢГЕЙІ: 85,6-86,9 dB

ҚУАТ СЫМЫНЫҢ ҰЗЫНДЫҒЫ: 2 m



UMI - БЕТКЕ АРНАЛҒАН УЛЬТРАДЫБЫСТЫҚ СКРАББЕР

Тазалау

Микроайналымды жақсартады

Қабыршақтандыру

Күтім құралдарының сіңуін жақсартады

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: терінің қатты майлануы, кеңейген тесіктер, комедондар, безеу, өңсіз әрі сау емес бет реңі, тері серпімділігінің төмендеуі.

МАТЕРИАЛДАРЫ: ABS пластигі, силикон.

САЛМАҒЫ: 131 g.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:

«Терең тазалау» режиміндегі жоғары жиілікті ультрадыбыстық діріл мен оң иондар теріні жұмсақ тазартады. Ультрадыбыс толқындары эпидермистің жоғарғы қабатындағы бөлшектерді қабыршақтандырып, беткі кір мен май бездерінің жиналған бөлінділерін кетіреді.

Ылғалдандыру режимінде сол ультрадыбыс теріс иондармен бірге қан айналымы мен коллаген/эластин түзілуін арттырып, косметиканың белсенді сіңуіне көмектеседі. Осылайша күтім косметикасының әсері айқынырақ болады.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:

1. Индукциялық магниттік зарядтау базасы бар тасымалды құрылғы: саяхатқа алып жүруге ыңғайлы.
2. Магниттік қақпақ тазарту бетін қорғайды және гигиеналық қолдану ережелерін сақтауға мүмкіндік береді.
3. Қолданғанда барынша ыңғайлы болатын жұмсақ силикон корпус.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ:

1. Құрылғы бір батырмамен басқарылады. Қосу үшін қосу/өшіру/режим батырмасын басыңыз.
2. «Терең тазалау» режимі іске қосылып, тиісті индикатор жанады.
3. Режимді ауыстыру үшін қосу/өшіру/режим батырмасын қайта басыңыз. «Ылғалдандыру» режимі қосылып, тиісті индикатор жанады.
4. Қосу/өшіру/режим батырмасын басып, құрылғыны өшіріңіз.
5. Скраббердің жұмыс ұзақтығы - 5 минут. 5 минут жұмыстан кейін автоматты түрде өшеді. Режимді ауыстырсаңыз да, жалпы жұмыс уақыты 5 минут болады.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:

РЕЖИМ: ТЕРЕҢ ТАЗАЛАУ:
1. Қолданар алдында макияжды кетіріп, бетті тазартқышпен жуыңыз.
2. Ең жақсы нәтиже үшін теріні дезинкрустация гелімен салқын буландыру процедурасы арқылы дайындаңыз. Көзге тигізбей бетке гель жағыңыз. Үлдірмен жауып, 15 минут ұстаңыз да, ультрадыбыстық тазалауға кірісіңіз. Сондай-ақ ультрадыбыстық тазалау лосьонын, физиологиялық ерітіндіні немесе термалды суды қолдануға болады.
3. Құрылғыны қосыңыз.
4. «Терең тазалау» режимін іске қосыңыз.
5. Құрылғының алдыңғы жағын жоғары қаратып ұстаңыз. Скраббер қалақшасын теріге 40 градус бұрышпен қойып, қажетті аймақтарды тазалау үшін массаж сызықтарымен жылжытыңыз.
6. Құрылғы 5 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.
7. Бетті жылы сумен жуыңыз.
8. Скраббер қалақшасын құрғатып сүртіңіз.

ЫЛҒАЛДАНДЫРУ РЕЖИМІ:
1. Тазалаудан кейін ылғалдандыру процедурасына кірісіңіз. Сарысуды бетке біркелкі жағыңыз.
2. Құрылғыны қосыңыз.
3. Ылғалдандыру режиміне ауысыңыз.
4. Құрылғының алдыңғы жағын төмен қаратып ұстаңыз. Қалақшаның қырын емес, жалпақ бетін теріге тигізіңіз.
5. Күтім құралы толық сіңгенше аппликаторды массаж сызықтарымен жоғары қарай жұмсақ сырғытыңыз.
6. 5 минуттан кейін құрылғы автоматты түрде өшеді.
7. Скраббер қалақшасын құрғатып сүртіңіз.

ҚОЛДАНУ ЖИІЛІГІ МЕН ҰЗАҚТЫҒЫ:

ТЕРІ ТҮРІ / МӘСЕЛЕ	ТӘУЛІК УАҚЫТЫ	ҰЗАҚТЫҒЫ МЕН РЕТІ	ЖИІЛІГІ	ПРОЦЕДУРАЛАР КУРСЫ
МАЙЛЫ ТЕРІНІ ТАЗАЛАУ / БЕЗЕУ	Кешке жасау ұсынылады. Процедурадан кейін макияж жақпаңыз.	Терең тазалау: 5 минут. Ылғалдандыру: 5 минут. Осы ретпен қолданыңыз. Ылғалдандыру режимі тек терең тазалаудан кейін тиімді.	Аптасына бір реттен асырмаңыз	3-4 апта. 2 апта үзіліс жасаңыз. 3-4 апталық курсты қайталап, осы циклді жалғастырыңыз.
КУПЕРОЗ / КӨРІНЕТІН ҚАН ТАМЫРЛАРЫ			Айына екі реттен асырмаңыз	Қажетіне қарай

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Операциядан кейін бір ай бойы немесе бет терісінде ауыр күн күйігі болса, қолданбаңыз.
2. Қабынған немесе зақымдалған теріге қолданбаңыз.
3. Көзге қолданбаңыз.

ЕСКЕРТУЛЕР:
1. Құрылғыны терінің бір аймағында ұзақ қолданбаңыз.
2. Құрылғыны жоғары температурадан алыс ұстаңыз.
3. Бет имплланттары, металл тіс сауыттары, штифтер немесе брекеттер болса, өз сезіміңізді бақылаңыз. Ауырсыну не жайсыздық сезілсе, қолдануды тоқтатыңыз.

ЖИНАҚ ҚҰРАМЫ: (1) ультрадыбыстық скраббер, (2) магниттік қақпақ, (3) сымсыз зарядтау базасы, (4) пайдалану нұсқаулығы, (5) тазалау майлығы.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

ЗАРЯДТАУ УАҚЫТЫ: 5 h

ЖҰМЫС УАҚЫТЫ: 35 min

АҚЫЛДЫ ТАЙМЕР: 5 min

УЛЬТРАДЫБЫС ЖИІЛІГІ: 25±5 kHz

СУДАН ҚОРҒАНЫСЫ: IPX5



VIA GOLD - БЕТТІ ЖАСАРТУҒА АРНАЛҒАН ҚҰРЫЛҒЫ, 3 ФУНКЦИЯ 1 ҚҰРЫЛҒЫДА

Ісінуді азайтады

Беттің V пішінді контурын айқындайды

Тазалау

Лифтинг

Әжімдерді азайтады

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: беттің төменгі үштен бір бөлігінің өзгерістері, салбыраған ұрт, иек асты майы және қартаюдың көрінетін белгілері: әжімдер, босаңсыған тері, кеңейген тесіктер, өңсіз бет реңі.

МАТЕРИАЛДАРЫ: ABS пластигі, металл.

САЛМАҒЫ: 207,5 g.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:

Ультрадыбыс пен діріл: ультрадыбыс толқындары эпидермистің жоғарғы қабатындағы бөлшектерді қабыршақтандырып, беткі кір мен май бездерінің жиналған бөлінділерін кетіреді. Діріл бұл кірді тері бетіне шығарады.

RF - терінің терең қабатын (дерманы) шамамен 40-55 °C-қа дейін қыздыратын радиожиілікті энергия. Бұл коллаген түзілуін ынталандырып, терінің серпімділігін арттырады. Кейбір жағдайларда жылу май жасушаларының зат алмасуын да жеделдетуі мүмкін, мысалы, иек астында. Үйде қолданылатын құрылғыларда қауіпсіз пайдалану үшін тері бетінің температурасы әдетте 38-45 °C болады.

EMS - тіндерге терең енетін төмен жиілікті токпен электрлік миостимуляция. Ол бұлшықеттердің жиырылуы мен тамырлардың кеңеюін туғызады, қан және лимфа ағынын жақсартады, зат алмасуды және терінің қоректенуін ынталандырады. Нәтижесінде бет бірден тартылады, бұлшықет тонусы артып, бет сопағы нығаяды.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:
1. Ең тиімді 3 технологияны біріктіретін ықшам құрылғы.
2. SONIC режимінде мұқият тазарту үшін тазалау дискілерін бекітетін магниттік сақина.
3. Реттелетін EMS әсер деңгейі.
4. Ток өткізгіштігін арттыратын тот баспайтын болат шарлар - электродтар.
5. VIA құрылғысы Live Organic Awards 2021 байқауында «Үздік сұлулық құрылғысы» номинациясының жеңімпазы атанды.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ:
1. Құрылғының қорғаныш қақпағы мен қалпақшасын алыңыз.
2. Қосу/өшіру/режим ауыстыру батырмасын ұзақ басып, массажерді қосыңыз.
3. Құрылғыда 3 режим бар: 1 - SONIC, 2 - RF, 3 - EMS. Қосу/өшіру/режим ауыстыру батырмасын қысқа басқанда осы ретпен ауысады.
4. Өшіру үшін қосу/өшіру/режим ауыстыру батырмасын басып тұрыңыз.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:

SONIC РЕЖИМІ
1. Макияжды кетіріп, бетті тазартқышпен жуыңыз.
2. Мақта дискіге тоник жағыңыз немесе тазалау дискін қолданыңыз.
3. Дискіні аппликаторға магниттік сақинамен бекітіңіз.
4. Құрылғыны қосып, SONIC режимін таңдаңыз.
5. Аппликаторды бетке тигізіп, массаж сызықтарымен иектен маңдайдағы шаш өсу сызығына дейін жоғары жылжытып тазалаңыз. Жақсы нәтиже үшін барлық аймақты бірнеше рет, әсіресе Т-аймақты мұқият тазалау ұсынылады.
6. 3 минут жұмыстан кейін құрылғы автоматты түрде өшеді.
7. Дискіні алып, аппликаторды тазалау майлығымен сүртіңіз.
8. Бетті сумен шайыңыз.

RF РЕЖИМІ
1. Бетке су негізіндегі күтім құралын жағыңыз. Құрамында агрессивті қышқылдар немесе майлар болмауын ескеріңіз.
2. Құрылғыны қосып, RF режиміне ауыстырыңыз.
3. Аппликаторды бет ортасынан шетіне қарай тұрақты жылдамдықпен баяу жылжытыңыз. Бір жерде ұзақ ұстамаңыз.
4. 5 минуттан кейін құрылғы автоматты түрде өшеді.
5. Аппликатордағы косметика қалдықтарын тазалау майлығымен кетіріңіз.

EMS РЕЖИМІ
1. Токтың жақсы өтуі мен барынша жоғары нәтиже үшін бетке су негізіндегі, гель тәрізді күтім құралын жағыңыз.
2. Құрылғыны қосып, EMS режиміне ауыстырыңыз.
3. EMS токтарының әлсіз немесе күшті қарқындылығын таңдау үшін қосу/өшіру/режим ауыстыру батырмасын қайта басыңыз.
4. Роликтерді бет контурына қойып, теріні сәл тарта отырып төменнен жоғары жүргізіңіз. Массаж сызықтарымен ортадан шетке қарай 3-5 рет қайталаңыз. Маңдай мен көз айналасын айналып өтіңіз.
5. 6 минуттан кейін құрылғы автоматты түрде өшеді.
6. Роликтердегі косметика қалдықтарын тазалау майлығымен кетіріңіз.

ҚОЛДАНУ ЖИІЛІГІ МЕН ҰЗАҚТЫҒЫ:

ТЕРІ ТҮРІ / МӘСЕЛЕ	ТӘУЛІК УАҚЫТЫ	ҰЗАҚТЫҒЫ МЕН РЕТІ	ЖИІЛІГІ	ПРОЦЕДУРАЛАР КУРСЫ
ШАРШАҢҚЫ / ГРАВИТАЦИЯЛЫҚ-ІСІНУ ТҮРІНДЕГІ ҚАРТАЮ	Кешке, тазалаудан кейін	Тазартқыш дискілермен SONIC: 3 минут. RF: 5-7 минут. EMS: төмен деңгей - 5 минут; ұрттың төменгі бөлігі мен иекке жоғары деңгей - 3 минут. Бір уақытта емес, осы ретпен қолданыңыз.	Аптасына 2-3 рет	3 апта. 1 апта үзіліс жасаңыз. 3 айға дейін қайталаңыз. Әр 6 ай сайын бір рет.
ҰСАҚ ӘЖІМДЕРІ БАР ТЕРІ	Таңертең	Ылғалдандыратын/лифтинг дискілерімен SONIC: 3 минут. RF: 10 минут. 3-аптадан бастап EMS: төмен қарқындылық, 5-7 минут.	RF және SONIC: 1-аптада екі рет, 2-аптадан бастап аптасына 3 рет. EMS: аптасына екі рет.	10 апта. 2-3 апта үзіліс жасаңыз. 10 апталық курсты қайталаңыз. Әр 6 ай сайын бір рет.
МОЙЫН	Таңертең	Ылғалдандыратын/лифтинг дискілерімен SONIC: 3 минут. RF: 10-15 минут. EMS: төмен деңгей - 5 минут. Процедурадан кейін қызару болуы мүмкін, бұл қалыпты. Мойынның ортасын, қалқанша бездің үстін өңдемеңіз.	Аптасына 2-3 рет	10 апта. 2-3 апта үзіліс жасаңыз. 10 апталық курсты қайталаңыз. Әр 6 ай сайын бір рет.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Денеде электрондық импланттар немесе кардиостимулятор болса, құрылғыны қолдануға тыйым салынады.
2. Соңғы айда қуыстық операция жасалған немесе ұзақ уақыт күн сәулесінің әсерінде болған адамдарға құрылғыны қолдануға болмайды.
3. Терісі зақымдалған, іріңдеу, күйік, тыртық немесе электромагниттік әсерге сезімталдығы бар адамдарға қолдануға болмайды.
4. Металл-керамикалық немесе керамикалық тіс сауыттары, импланттар, брекеттер, сондай-ақ жоғары тіс сезімталдығы болса, қолдану ұсынылмайды.
5. Қан аурулары, туберкулез, ішкі мүшелер аурулары, қатерлі ісік, жоғары қан қысымы, жоғары дене қызуы немесе бет невралгиясы бар адамдарға қолдануға болмайды.
6. Массажерді қолданғанда жасанды талшықтан тігілген киім кимеңіз.
7. EMS режимін көз, ауыз, қалқанша без аймағында, пластикалық операция іздері мен жарақаттар бар жерлерде қолданбаңыз.

8. Көз айналасындағы сезімтал аймаққа қолданбаңыз: ол жердің терісі жұқа әрі нәзік.
9. Шырышты қабықтарға (мысалы, мұрынның, ауыздың ішіне, жыныс мүшелерінің аймағына) қолданбаңыз: жергілікті тітіркену туғызуы мүмкін.

ЕСКЕРТУЛЕР:
1. Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
2. Массажерді жоғары температурада қолданбаңыз.
3. Құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз.
4. Зарядтау кезінде қоспаңыз.
5. Соққыдан немесе құлағаннан кейін қолдануды жалғастырмас бұрын зақым бар-жоғын тексеріңіз.
6. Электр тогы соқпауы үшін аша мен қуат кабелінің бүтіндігіне назар аударыңыз.
7. Қолданар алдында сағатты, көзілдірікті және металл бөлшектері бар басқа заттарды шешіңіз.

ЖИНАҚ ҚҰРАМЫ: (1) құрылғы, (2) EMS роликтерінің қалпақшасы, (3) аппликатордың магниттік сақинасы, (4) USB-C зарядтау кабелі, (5) нұсқаулық, (6) майлық,
7. сақтау қабы.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

ЗАРЯДТАУ УАҚЫТЫ: 3 h

ЖҰМЫС УАҚЫТЫ: SONIC режимі - 150 минут; RF режимі - 40 минут; EMS режимі - 2700 минут

АҚЫЛДЫ ТАЙМЕР: • SONIC режимі - 3 минут; • RF режимі - 5 минут; • EMS режимі - 6 минут

ТОК КҮШІ: SONIC режимі - 100-400 mA; RF режимі - 200-2800 mA; EMS режимі - 3-30 mA

ЖИІЛІГІ:
• SONIC - 3 MHz +/-10%
• RF режимі - 1 MHz

EMS ЖИІЛІГІ: 2,91 KHz

ТОЛҚЫН ПІШІНІ: тікбұрышты толқын

СУДАН ҚОРҒАНЫСЫ: IPX6



YUKI - САЛҚЫНДАТУЫ БАР IPL ЭПИЛЯТОРЫ

Қажетсіз түктерді кетіреді

Түк өсуін баяулатады

Күйік пен ауырсынудан қорғайды

Тегіс тері

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: түктерді кетіру.

МАТЕРИАЛДАРЫ: ABS пластигі, PC пластигі.

САЛМАҒЫ: 298 g.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
Құрылғы жетілдірілген ҚАРҚЫНДЫ ИМПУЛЬСТІК ЖАРЫҚ (IPL) технологиясымен қажетсіз түктерді жылдам, қауіпсіз әрі ауыртпай кетіреді. Екі импульсті сәулелену режимінде фотондардың жоғары энергиялы қабаттасуы түк фолликулына тікелей әсер етіп, түк өсуін баяулатады. IPL ТЕХНОЛОГИЯСЫ табиғи қара, қоңыр және қою ақшыл түктерге жарайды. Ақ, ашық, жирен немесе сұр түктерде тиімділігі төмен болуы мүмкін.

Сапфирлі мұздай салқындатудың инновациялық технологиясы әсер ету аймағының температурасын тиімді төмендетіп, эпидермисті күйіктен қорғайды және ауырсынуды толық басады.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:
1. Тасымалдауға ыңғайлы: құрылғы жеңіл әрі ықшам, жүкте көп орын алмайды және сапарға алып жүруге қолайлы.
2. Салқындататын сапфир жабыны жарқыл кезінде теріні суытып, жайсыздықты азайтады және күйіктен қорғайды.
3. 5 қуат режимі тері түрі мен аймақ сезімталдығына сай қауіпсіз әрі тиімді қарқындылықты оңай таңдауға мүмкіндік береді.
4. Қолмен және автоматты режимдер: қолмен басқару нүктелі өңдеуге (бет, бикини), автоматты режим үлкен аймақтарды (аяқ, қол) жылдам өңдеуге арналған.
5. Жарқыл саны шектелмеген: ауыстырмалы картридж сатып алмай ұзақ қолдануға болады, ресурсы бірнеше жылға жетеді.
6. Термометр құрылғы мен тері температурасын үздіксіз бақылап, қызып кетуден қорғайды және қауіпсіздікті қамтамасыз етеді.
7. Екі импульсті режимді таңдау мүмкіндігі: құрылғы бір өңдеу циклінде 2 жарқылдың жоғары тиімді қабаттасуын жасап, түк фолликулына тереңірек әсер етеді.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ:
1. Қуат адаптерінің сымын фотоэпилятор корпусындағы тиісті ұяға жалғаңыз.
2. Адаптер ашасын розеткаға толық енгізіңіз.
3. Маңызды: көзді жарық жарқылдарынан қорғау үшін жинақтағы қорғаныш көзілдірігін міндетті түрде тағыңыз.
4. Қосу батырмасын 2 секунд басып тұрып, құрылғыны іске қосыңыз. Кірістірілген салқындату желдеткіші қосылады (тән дыбыс естіледі).
5. Әдепкіде құрылғы ең төменгі 1-деңгейде қосылады. Қосу/деңгей батырмасын қысқа басып, қуатты реттеңіз. Деңгей жоғарылаған сайын жарық импульсі күшейіп, әсерге тезірек жетуге болады. Төмен деңгейден бастап, тері бейімделген сайын біртіндеп арттырыңыз.
6. Режим индикаторы: құрылғы қосулы, бірақ жұмыс беті теріге жанаспағанда индикатор тұрақты жанады. Қауіпсіздік үшін бұл күйде жарқыл бұғатталады. Жұмыс беті теріге тығыз тигенде индикатор жыпылықтайды: жанасу орнады, құрылғы дайын. Батырманы басқанда таңдалған режимге сай бір немесе қос импульсті жарқыл шығады.
7. Қажетті жұмыс режимін таңдаңыз:
Қолмен және автоматты жарқыл режимдері: фотоэпилятор әртүрлі міндеттер мен аймақтарға екі жарқыл пішімін ұсынады. Ауыстыру үшін терезені теріден басқа жаққа қаратып, теріге тигізбей, жарқыл батырмасын 2 секунд басып тұрыңыз.
Құрылғы терезесі басқа жаққа бағытталған және теріге тимейді:
• Автоматты режим (жарқыл дайындығының индикаторы жыпылықтайды): сапфир терезе денеге әр тығыз тигенде құрылғы импульсті өзі жасайды; әр жолы батырма басу қажет емес. Аяқ, қол, іш немесе арқа сияқты үлкен аймақтарды жылдам әрі үздіксіз өңдеуге арналған. Уақытты үнемдеп, қолдың шаршауын азайтады.
Қолмен басқару режимі (жарқыл дайындығының индикаторы тұрақты жанады): жарқыл тек жарқыл батырмасын әдейі басқанда шығады. Бет, қолтық, бикини сияқты шағын немесе бедерлі, барынша бақылауды қажет ететін аймақтарды мұқият, жұмсақ әрі нүктелі өңдеуге арналған.
Бір/қос импульс: жарқыл батырмасын
және қосу батырмасын бір уақытта 2 секунд басып тұрыңыз:
- Режим индикаторы жанбаса, бір импульс белсенді (әр басу/жанасуға 1 жарқыл). - Индикатор жанса, екі импульсті режим қосылған: құрылғы бір өңдеу циклінде 2 жарқылдың жоғары тиімді қабаттасуын жасап, түк фолликулына тереңірек әсер етеді.
Салқындату режимі (Sapphire ice care): қолмен жарқыл режимінде (қосылғанда әдепкі), сәулелендіру батырмасын баспай, сапфир әйнекті теріге тығыз тигізіңіз. Бұл режим теріні тез тыныштандыруға, тітіркенуді басуға немесе сезімтал аймақтарды кейінгі эпиляцияға дайындауға арналған жеке мұздай компресс ретінде қолданылады.

Ескерту: жарқылсыз салқындатуды қолданғанда құрылғы белсенді қалуы үшін қарқындылық батырмасын кемінде әр 5 минут сайын басыңыз. Әйтпесе автоматты өшу функциясы іске қосылады.
8. Өшіру батырмасын 2 секунд басып тұрыңыз. Ішкі бөлшектерді қауіпсіз суыту үшін желдеткіш тағы 15 секунд жұмыс істейді.
9. Желдеткіш толық тоқтағаннан кейін адаптерді желіден ажыратыңыз.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
Алғашқы процедура алдында тері сезімталдығын тексеріңіз. Өңделетін аймақтан шағын бөлікті таңдаңыз. 3-деңгейді қосып, екі жарқыл жасаңыз (екі импульсті режимде). 30 минуттан кейін тері күйін бағалаңыз. Қалыпты болса, құрылғыны қолдануға болады. Қатты қызару немесе ісіну болса, процедураны кейінге қалдырып, 24 сағаттан кейін қайта тексеріңіз. ЭПИЛЯЦИЯ ПРОЦЕДУРАСЫН ОРЫНДАУ
1. Дайындық: өңделетін аймақтың түгін толық қырып, теріні тазалап, құрғатыңыз.
2. Көзілдірік тағып, құрылғыны қосыңыз және тиісті қуат пен режимді орнатыңыз.
3. Сәулелендіру терезесін теріге 90° бұрышпен тығыз тигізіңіз. Тері мен сапфир әйнек арасында саңылау қалмағанына көз жеткізіңіз.
4. Қолмен басқаруда дайындық жарық белгісін күтіп, жарқыл батырмасын басыңыз. Келесі бөлікке жылжытыңыз. Автоматты режимде теріге тығыз жанасқанда жарқыл өзі шығады.
5. Күйікке жол бермеу үшін бір сеанста терінің бір нүктесіне 2-3 жарқылдан артық бағыттамаңыз. Фотоэпиляторды бір жерде қозғалтпай ұстасаңыз, үздіксіз сәулелену 8 секундтан кейін бұғатталады.
6. Ұсыным: бір аймақты өңдегеннен кейін сапфирлі салқындату бетін сол теріге 1-2 минут тигізіп, содан кейін ғана келесі аймаққа ауысу ұсынылады.
7. Кейінгі күтім: процедурадан кейін тыныштандыратын алоэ вера гелін немесе жұмсақ ылғалдандырғыш жағыңыз. Спирт не тітіркендіретін косметика жақпаңыз. Аздап күйдіру сезілсе, 30-60 минут салқын компресс қойыңыз.

ҚОЛДАНУ ЖИІЛІГІ МЕН ҰЗАҚТЫҒЫ:
1-АЙ: әр 3-5 күнде 1 рет қолданыңыз. Түктің сыртқы құрылымы мен тері күйі көзге өзгермейді. 2-АЙ: аптасына 1 рет қолданыңыз. Түктер едәуір сиреп, жұмсара бастайды; жуынғанда қара түбірлер түсе бастайды. 3-АЙ: әр 15 күнде 1 рет қолданыңыз. Жаңа түк өсуі дерлік толық басылып, қалған жекелеген түктер оңай кетеді. 4-АЙ: әр 30 күнде 1 рет қолданыңыз. Түк өсуі тоқтап, терінің ұзақ мерзімді мінсіз тегістігіне қол жеткізіледі.

Қолдау күтімі (кейінгі процедуралар): үй фотоэпиляторымен түк кетіру - ұзақ мерзімді процесс. Негізгі 4 айлық курстан кейін дененің кейбір аймақтарына әрі қарай күтім мүлде қажет болмауы мүмкін. Басқа аймақтарда ағзаның жеке ерекшеліктеріне сай нәтижені бекіту үшін 6, 9 немесе 12 айлық аралықпен сирек қолдау сеанстары қажет. Қарқынды курсты әр апта сайын қайталау енді қажет емес.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Өте қою (терең пигменттелген) терісі бар адамдарға қолдануға тыйым салынады. Қою немесе қараторы терісі бар пайдаланушылар тек 1-деңгейден бастауы тиіс.
2. Жүктілік, жүктілікті жоспарлау және бала емізу кезінде қолданар алдында маманмен кеңесу ұсынылады.
3. Тері фотосезімталдығы және фотосезімталдықты арттыратын дәрілерді қабылдау кезінде қолдануға тыйым салынады.
4. Өңделетін аймақта қабыну, аллергия, экзема немесе инфекция болса, қолданбаңыз.
5. Филлер, инъекция немесе токсин (ботокс) енгізілген аймақтарды өңдеуге тыйым салынады.
6. Татуировкаға, перманентті макияжға, ірі секпілдерге, меңдерге, пигменттік дақтарға немесе сүйелдерге тікелей қолдануға тыйым салынады.
7. Шырышты қабықтар мен нәзік тері аймақтарына: құлақ, мойын, емізік, жыныс мүшелері, анус және ерінге қолдануға тыйым салынады.
8. Табиғи күнге қатты күйгеннен, солярийден немесе автокүнге күю кремдерін қолданғаннан кейін құрылғыны қолданбаңыз.
9. Фотоэпиляторды өзіңіз бөлшектеуге, жөндеуге немесе құрылымын өзгертуге тырыспаңыз.
10. Қуат сымы не аша зақымдалса, ұшқын немесе бөлшектердің қызаруы байқалса, қолдануды дереу тоқтатып, уәкілетті ұйымға хабарласыңыз.

ЕСКЕРТУЛЕР:
1. Құрылғыны кардиостимуляторлардан, дефибрилляторлардан, банк карталарынан және дерек сақтау құралдарынан алыс ұстаңыз.
2. Құрылғы мен адаптерге су тигізбеңіз. Жуынатын бөлмеде немесе шұңғылша жанында қолдануға тыйым салынады. Дымқыл қолмен ұстамаңыз.
3. Құрылғы тек 18 жастан асқан адамдарға арналған. Балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз.
4. Жұмыс кезінде желдету тесіктерін жаппаңыз: қызып кетуге әкеледі.
5. Жылудан қорғау: құрылғыда температура датчигі бар. Ішкі температура нормадан асса, қорғаныс тетігі іске қосылып, фотоэпилятор автоматты түрде тоқтайды. Желіден ажыратып, 10 минут суытыңыз; содан кейін қайта қауіпсіз қолдануға дайын болады.
6. Құрылғыны жанғыш газдар, аэрозольдер немесе таза оттегі бар ортада қолданбаңыз.

ЖИНАҚ ҚҰРАМЫ: (1) фотоэпилятор, (2) қуат адаптері, (3) қорғаныш көзілдірігі, 4. бірреттік ұстара, 5) пайдалану нұсқаулығы, 6) сақтау қабы.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

ӨЛШЕМІ (Б × Е × Т): 172×65×40 mm

ҚУАТЫ: 64,8 W

ЖҰМЫС КЕРНЕУІ: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Жарық көзі: қарқынды импульстік жарық (IPL)

ТОЛҚЫН ҰЗЫНДЫҒЫ: 550-1200 nm (қателігі ±20 nm)

Импульс режимі: бір/қос импульс

ЖАРҚЫЛ САНЫ: >999000 импульс

ЕҢ ЖОҒАРЫ ЭНЕРГИЯ ТЫҒЫЗДЫҒЫ: 5.1 J/cm2

ӨҢДЕУ ТЕРЕЗЕСІНІҢ АУДАНЫ: 3.3 cm2



YUTO+ - ДИФФУЗОРЫ БАР ШАШ КЕПТІРГІШ

Жылдам кептіру

Тиімді сәндеу

Үлпілдеуді бақылау

Статикалық электрге қарсы әсер

Шаштың сау жылтырын сақтайды

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: дымқыл шаш, табиғи кепкеннен кейін пішінін жоғалтқан шаш үлгісі, шаштың шамадан тыс үлпілдеуі және электрленуі.

МАТЕРИАЛДАРЫ: ABS пластигі, PC пластигі.

САЛМАҒЫ: 360 g.

ФУНКЦИЯЛАРЫ:
Ауа ағынының 3 жылдамдығы мен 3 температура деңгейі жайлы кептіру баптауын таңдауға мүмкіндік береді. Суық ауа шаш үлгісін бекітуге көмектеседі.

Иондау функциясы ауаны теріс иондармен қанықтырып, статикалық электрді жояды.

Автоматты тазалау функциясы сүзгідегі кірді артық күш жұмсамай кетіруге арналған.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:
1. Жиналмалы құрылым.
2. Өте жеңіл - 360 g.
3. Саптама диаметрі - 42.4 mm.
4. Ұзын сым - 2 m.
5. Төмен шу деңгейі - 64 dB-ге дейін.
6. 3 температура режимі: төмен - 50 °C, орташа - 70 °C, жоғары - 110 °C.
7. Жинақта 3 саптама: кең саптама жылдам кептіру үшін шашқа көбірек ауа береді; жіңішке сәндеу саптамасы бағытталған ағынмен шаш үлгісін жасайды; диффузор бұйра шашты кептіруге арналған. Саптамалар магниттермен бір қалыпта бекітіледі.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ:
1. Қорапта фен жиналған күйде сақталады. Ашу үшін негізінен ұстап, оң қолыңызда ұстай отырып, сабын өзіңізден әрі қарай бұраңыз.
2. Фен ашасын розеткаға толық енгізіп, қажетті саптаманы орнатыңыз. YUTO фенінің магниттік саптамалары ауа шығатын тесікке өздігінен тартылып орналасады. Алу үшін саптаманы тартыңыз.

3. Қосу/өшіру батырмасын басыңыз. Алғаш қосылғанда фен ең төмен температура мен жылдамдықта іске қосылады. Температура деңгейінің 1 және жылдамдық деңгейінің 1 индикаторы жанады.
4. Ауа ағынының жылдамдығын реттеңіз. YUTO фенінде 3 деңгей бар: төмен, орташа, жоғары. Жылдамдық батырмасын бір рет басу деңгейді өзгертеді. Таңдалған режимге сәйкес жарық индикаторлары жанады.
5. Үрленетін ауа температурасын реттеңіз. YUTO фенінде 3 деңгей бар: төмен, орташа, жоғары. Температура батырмасын бір рет басу деңгейді өзгертеді. Таңдалған режимге сәйкес жарық индикаторлары жанады.
6. YUTO фенінде жад функциясы бар. Алғаш қосылғанда жылдамдық та, температура да ең төмен деңгейде болады. Кейінгі қосылуларда фен соңғы қолданылған режимде жұмыс істейді.
7. Суық ауа режимін қосу үшін суық ауа батырмасын басыңыз. Өшіру үшін қайта басыңыз: алдыңғы температураға ораласыз. Суық режимді температура реттеу батырмасымен де өшіруге болады.
8. Фен ішкі бөлшектерді автоматты тазалау функциясымен жабдықталған. Фен жұмыс істеп тұрғанда температура мен ауа ағыны жылдамдығын реттеу батырмаларын бір уақытта басыңыз. Қозғалтқыш кері бағытта жұмыс істеп, ауа кіретін тесіктен ауаны үрлеп шығарып тазартады. Қалыпты режимге оралу үшін кез келген батырманы басыңыз. Өздігінен тазалау режимі 15 секундтан кейін тоқтайды.
9. Өшіру үшін батырманы OFF күйіне ауыстырыңыз. YUTO фенінің жұмысын кешіктіріп аяқтау функциясы бар. Бірден тоқтату қозғалтқышты зақымдап, қызмет мерзімін қысқартуы мүмкін. Кешіктіріп аяқтау қозғалтқышты қорғайды және оның, сәйкесінше феннің де қызмет мерзімін ұзартады.
10. Фенді жинап, розеткадан ажыратыңыз. Оқшауланған бетке қойып, суытыңыз. Құрғақ, таза сақтау орнына қойыңыз.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Кептіру саптамасын орнатыңыз. Фенді қосып, температура мен ауа ағынының жылдамдығын реттеңіз.
2. Шашты түбірден кептіріңіз: ауаны бас терісіне емес, шаш түбіріне бағыттаңыз. Көлем жасау үшін фенді шаштың табиғи өсу бағытына қарсы бағыттаңыз.
3. Содан кейін шашты аймақтарға бөліп, негізгі ұзындығын жоғарыдан төмен ауа ағынымен кептіріңіз.
4. Кептіру саптамасын сәндеу саптамасына ауыстырыңыз. Жеке бұрымның астына брашинг немесе тарақ қойып, саптаманы шашқа бұрышпен жоғарыдан бағыттап, фенмен баяу жүріңіз.
5. Бекіту үшін бұрымдарды суық ауа режимімен өтіңіз.
6. Фенді өшіріп, розеткадан ажыратыңыз.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Фен бас шашын кептіруге арналған. Басқа мақсатта қолданбаңыз.
2. Құрылғыны көзге, теріге немесе жылуға сезімтал басқа бетке қолданбаңыз.

ЕСКЕРТУЛЕР:
Фен саптамаларында магниттер бар. Кардиостимуляторлардан, дефибрилляторлардан, банк карталарынан және дерек сақтау құралдарынан алыс ұстаңыз.
1. Фенді ванна, шұңғылша немесе басқа су ыдыстарының жанында қолданбаңыз.
2. Ванна қабылдау кезінде қолданбаңыз.
3. Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтыққа салмаңыз және түсіріп алмаңыз.
4. Құрылғы суға түссе, дереу розеткадан ажыратыңыз. Суға тимеңіз.
5. Құрылғының ешбір бөлігін дымқыл қолмен ұстамаңыз.
Күйік, электр тогының соғуы, өрт және жарақат қаупін азайту үшін:
1. Фен қолданылмай тұрса, желіден ажыратыңыз. Суытып, қауіпсіз құрғақ жерге сақтаңыз.
2. Қолданғанда фен қызады. Қызған беттерді көзге немесе қорғалмаған теріге тигізбеңіз.
3. Ыстық фенді жылуға төзімді тұғырдан немесе басқа қолайлы беттен өзге жерге тікелей қоймаңыз.
4. Желіге қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Балалар қолданғанда немесе балалар мен мүмкіндігі шектеулі адамдардың жанында қолданғанда қатаң бақылау қажет.
5. Құрылғыны тек мақсаты бойынша, осы нұсқаулықта сипатталғандай қолданыңыз.
6. Қуат сымы немесе аша зақымдалса, қолданбаңыз.
7. Қуат сымын, әсіресе аша жанын тартпаңыз, жұлқымаңыз, созбаңыз, бұрамаңыз және күрт бүкпеңіз. Бұл сымды зақымдауы немесе үзуі мүмкін. Ұқыпты ұстап, ыстық беттерден алыс сақтаңыз. Сымды құрылғыға орамаңыз.
8. Құрылғыны құлатпаңыз және тесіктеріне бөгде зат салмаңыз.
9. Құрылғыда қызып кетуден қорғайтын, өздігінен қалпына келмейтін жылу сақтандырғышы бар. Жұмыс кезінде құрылғы өшіп, екінші LED (температура режимдері) жыпылықтаса, розеткадан ажыратып, суытыңыз.
10. Ылғалдылығы жоғары жерде сақтауға тыйым салынады.
11. Құрылғының желдету тесіктерінде шаш немесе түк қалдырмаңыз.
12. Жұмыс істеп тұрған құрылғыны ешбір заттың бетіне қоймаңыз.
13. Ақау пайда болса немесе тым қатты қызса, қолдануды дереу тоқтатып, розеткадан ажыратыңыз.

ЖИНАҚ ҚҰРАМЫ: (1) фен, (2) кептіру саптамасы, (3) сәндеу саптамасы, (4) диффузор, 5. нұсқаулық, (6) сақтау қабы.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

ҚОЗҒАЛТҚЫШ ЖЫЛДАМДЫҒЫ: минутына 110000 айналым

Жылдамдығы: секундына 32 литр

АУА АҒЫНЫНЫҢ ЖЫЛДАМДЫҒЫ:
• Төмен жылдамдық - 80000 rpm
• Орташа жылдамдық - 95000 rpm
• Жоғары жылдамдық - 110000 rpm

ТЕМПЕРАТУРА РЕЖИМДЕРІ: • Төмен температура - 50 °C; орташа температура - 70 °C; жоғары температура - 110 °C

Аксессуарлар



МАССАЖ СЫЗЫҚТАРЫ



RENGA GOLD - КОСМЕТИКА СӨМКЕСІ

Күтім құралдары мен косметиканы реттейді

Үйде және жолда сақтау

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: ретсіз сақтау.

МАТЕРИАЛДАРЫ: полиуретан (сырты), полиэстер (іші).

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:
1. Сырты сәнді, іші эргономикалық: косметика сөмкесінің сыртқы және ішкі дизайны оны қолдануға барынша ыңғайлы әрі әдемі ету үшін ойластырылған.
2. Қолайлылық: ішкі астары полиэстерден жасалған. Бұл өте жеңіл әрі берік мата пішінін жақсы сақтайды, аз мыжылады және кірге төзімді. Ішіне косметика төгілсе де, дағын дымқыл шүберекпен немесе майлықпен оңай кетіруге болады.
3. Нығайтылған корпус: қаттылық беру үшін ішіне жұқа пластиналар орнатылған, сондықтан косметика сөмкесі пішінін жақсы сақтайды.
4. Сыйымдылық: ішкі ғана емес, сыртқы қалталарының арқасында барлық қажетті зат сыяды.
5. Ішкі тұтқалар: 2 берік тұтқамен косметика сөмкесін ашық күйінде оңай тасуға, қажет болса ілмекке ілуге болады.
6. 3 түс: енді сатып алушылар өздеріне ең қолайлы түсті таңдай алады.

КҮТІМ ҰСЫНЫМДАРЫ:
Жеткізу кезінде косметика сөмкесінде қатпарлар пайда болуы мүмкін, олар уақыт өте жазылады. Қатпарлар тым қатты болса, ақ мақта сүлгі арқылы булап кетіруге болады.



WAU
TEPI KYTIMI



AQUA PURIFYING REGENCY CREAM

БЕТКЕ АРНАЛҒАН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРЕТІН КҮТІМ КРЕМІ

Терінің қорғаныш тосқауылын қалпына келтіреді

Серпімділікті жақсартады

Қарқынды қоректендіреді

Тыныштандырады

Терең ылғалдандырып жұмсартады

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: терінің сусыздануы, құрғақтығы мен өңсіздігі, тітіркену.

ӘСЕРІ: тыныштандырады, терінің серпімділігі мен созылғыштығын арттырады, қарқынды қоректендіріп ылғалдандырады, қалпына келу процестерін белсендіреді.

ҚҰРАМЫ: Water, Cetyl Ethylhexanoate, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Dipropylene Glycol, Glycerin, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Cyclopentasiloxane, Xanthan Gum, Allantoin, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Dimethicone, Cetearyl Glucoside, Dimethiconol, Fragrance, Polyacrylate-13, Polyisobutene, Disodium EDTA, Butylene Glycol, Polysorbate 20, Arginine, Sorbitan Isostearate, Pentylene Glycol, Tea Tree Extract, 1,2-Hexanediol, Asiatic Plantain Extract, Magnolia Kobus Bark Extract, Eclipta Prostrata Extract, Persimmon Leaf Extract, Angelica Gigas Root Extract, Undaria Pinnatifida Extract (Algae), Purslane Extract, Lavender Extract, Lactobacillus Ferment Lysate, Witch Hazel Water, Chamomile Flower Extract, Green Tea Leaf Extract, Sacred Lotus Germ Extract, Sacred Lotus Flower Extract, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Benzyl Benzoate, Geraniol, Citral.

БЕЛСЕНДІ ҚҰРАМДАСТАРЫ:

1. Аллантоин (Allantoin) - қуатты тыныштандырғыш құрамдас, тітіркенуді басып, қалпына келуге ықпал етеді.
2. Аргинин (Arginine) - микроайналым мен терінің қорғаныш қызметін жақсартатын аминқышқылы.
3. Melaleuca Alternifolia (шай ағашы) сығындысы - антисептикалық және қабынуға қарсы қасиеттерімен белгілі.
4. Lactobacillus Ferment Lysat (пробиотиктер) - тері микробиомын қалпына келтіріп, қорғаныш қызметін жақсартуға көмектеседі.
5. Hamamelis Virginiana (гамамелис) суы - тесіктерді тарылтып, тері майының түзілуін реттейді.
6. Lavandula Angustifolia (лаванда) + Chamomilla Recutita (түймедақ) - теріні тыныштандырып, қызаруды басады.
7. Nelumbo Nucifera (лотос) + Camellia Sinensis (көк шай) - теріні ерте қартаюдан және сыртқы орта әсерінен қорғайтын антиоксиданттар.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: кремнің белсенді құрамдастары алғашқы қолданудан кейін теріні жұмсақ, барқыттай және күтімді етіп, жел мен төмен температурадан ұқыпты қорғайды. Көк шай, түймедақ, лаванда және шай ағашының өсімдік сығындылары теріні дәрумендер мен антиоксиданттарға қанықтырып, тонусы мен табиғи жарқырауын сақтайды. Жеңіл, жайлы құрылымы тез сіңіп, жабысқақ сезім қалдырмайды.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Бет терісін тазалаңыз.
2. Қажетті мөлшерде крем жағып, толық сіңгенше саусақ ұштарымен уқалаңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ:
1. Қолданар алдында аллергия сынағын жасау ұсынылады.
2. Құралды терінің зақымдалған жерлеріне жақпаңыз.
3. Көзге тікелей тигізбеңіз. Тисе, жылы сумен шайыңыз.

САҚТАУ: жабық қаптамада +5 °С-тан +25 °С-қа дейін, тікелей күн сәулесінен алыс, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

КӨЛЕМІ: 100 ml.



BODY MOISTURE MASSAGE GEL

ДЕНЕГЕ АРНАЛҒАН ЫЛҒАЛДАНДЫРАТЫН МАССАЖ ГЕЛІ

Қалпына келтіреді | Ылғалдандырады | Ток өткізеді

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: құрғақ тері, микротокты массаж қажеттілігі.

ӘСЕРІ: ылғалдандыру, қалпына келтіру, тиімді микротокты массаж.

ҚҰРАМЫ: Water, Glycerin, Propanediol, Niacinamide, 1,2-Hexanediol, Betaine, Trehalose, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Hydrolyzed Collagen, Centella Asiatica Extract, Adenosine, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Disodium EDTA, Hyaluronic Acid, Pentylene Glycol, Madecassoside, Sodium DNA, Acetyl Glucosamine, Broussonetia Kazinoki Root Extract, Morus Alba Bark Extract, Apple Fruit Extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Octapeptide-7, Acetyl Hexapeptide-8, Camellia Sinensis Leaf Extract, Copper Tripeptide-1, Ethylhexylglycerin, Galactoarabinan (Larch Resin Extract), sh-Decapeptide-7, sh-Octapeptide-4, sh-Oligopeptide-9, sh-Pentapeptide-19, Tricholoma Matsutake Extract, glutamine, leucine, phenylalanine, Arginine, Lysine hydrochloride, proline, aspartic acid, valine, glycine, isoleucine, threonine, histidine, serine, Alanine, methionine, tryptophan, tyrosine.

БЕЛСЕНДІ ҚҰРАМДАСТАРЫ:

1. Трегалоза (1%) ылғалды тиімді ұстап, теріні ылғалданған күйде сақтайды, сыртқы тітіркендіргіштерден қорғайды және тотығу күйзелісін азайтады. Тері тосқауылын нығайтады, сезімтал теріге жарайды.
2. Бетаин (1%) - белсенді ылғалдандыруға арналған табиғи құрамдас. Тітіркенуді басып, теріні тыныштандырады, тегіс әрі серпімді етеді.
3. Ниацинамид (3%) меланин түзілуін баяулатып, тері реңін жақсартады және ағартады. Артық тері майын реттеп, қабынудың алдын алады. Қорғаныш қызметін күшейту үшін керамид синтезіне ықпал етеді. Тері құрылымын тегістеп, ұсақ әжімдерді азайтады.
4. Аденозин (0.04%) тері серпімділігі мен жастығы үшін коллаген түзілуін ынталандырады. Тітіркенген теріні тыныштандырып, қабынуды басады және қалпына келуіне ықпал етеді.
5. 7 пептид кешені (0.1%) коллаген мен эластин түзілуін күшейтіп, терінің серпімділігін арттырады. Қартаю белгілерінің алдын алып, ұсақ әжімдер санын азайтады, тері жасушаларының жаңаруы мен қалпына келуіне ықпал етеді.
6. Гидролизденген коллаген (0.1%) ылғалды терең жеткізіп, теріні ұзақ әрі терең ылғалдандырады. Серпімділігі мен созылғыштығын арттырады. Зақымдалған теріні қалпына келтіруге көмектеседі.

7. Мадекассосид (0.1%) сезімтал теріні тыныштандырып, қабынуды басады. Сау тері тосқауылын қорғайды және сақтайды, терінің қалпына келуі мен жараның жазылуын жеделдетеді.
8. 22 аминқышқылы кешені (0.1%) тері саулығына қажетті аминқышқылдарын жеткізеді. Ылғалды сақтап, теріні жұмсақ әрі серпімді етеді. Құрылымын жақсартып, жасушалардың қалпына келуіне ықпал етеді.
9. Гиалурон қышқылы (0.1%) алынған ылғалды ұстап, құрғақтықтың алдын алады. Теріні серпімді әрі тегіс сақтайды. Сезімтал теріні тыныштандырып, ылғал теңгерімін қолдайды.
10. PDRN (полинуклеотидтер, 0.01%) жасушалық зат алмасуды күшейтіп, зақымдалған теріні қалпына келтіреді. Теріні нығайтып, әжімдерді азайтады. Қызаруды басып, теріні сауықтырады.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: денеге арналған ылғалдандыратын массаж гелі микротокты терапия, электрлік миостимуляция және RF-лифтинг кезінде ток өткізу үшін арнайы жасалған. Гель құрылымы массажерлермен қолдануға өте қолайлы: ылғалдандырады, ұзақ кеппейді, жабысқақтық пен тартылу сезімін қалдырмайды. Белсенді құрамдастары терінің тегістігін, серпімділігі мен жастығын сақтайды.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Құралды дененің құрғақ, тазаланған терісіне жағыңыз.
2. WAU дене массажерімен процедураны орындап, гельді толық сіңгенше қалдырыңыз.
3. Процедурадан кейін ылғалдандырғыш (крем немесе сарысу) жағуға болады.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ:
1. Аллергиялық реакцияның алдын алу үшін қолданар алдында шынтақ бүгілісінің ішкі жағында сынау ұсынылады. Тітіркену немесе бөртпе болса, қолдануды тоқтатыңыз.
2. Құралды терінің зақымдалған жерлеріне жақпаңыз.
3. Көзге тікелей тигізбеңіз. Тисе, жылы сумен шайыңыз.
4. Қолданғаннан кейін күн сәулесінен қорғау үшін SPF кремін жағу ұсынылады.

САҚТАУ: жабық қаптамада +5 °C-тан +25 °C-қа дейін, тікелей күн сәулесінен алыс, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

КӨЛЕМІ: 300 ml.



CAFFEINE BRIGHTENING EYE CREAM

КӨЗ АЙНАЛАСЫНДАҒЫ ТЕРІГЕ АРНАЛҒАН СЕРГІТЕТІН КРЕМ

Терең ылғалдандырып жұмсартады

Шаршау белгілерін азайтады

Сергітеді

Ісінуді азайтады

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: қара шеңберлер, ісіну, күйзеліс пен ұйқысыздық іздері, жасқа байланысты өзгерістер.

ӘСЕРІ: реңді айқын тегістейді, ісінуді азайтады, терінің тығыздығы мен серпімділігін арттырады, көз бұрышындағы ұсақ әжімдерді тегістейді.

ҚҰРАМЫ: Water, dexpanthenol, Polyglycerin-3, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Caffeine, Diisostearyl Malate, Tranexamic acid, Betaine, glucosylrutin, Trehalose, glutathione, Green Tea Leaf Extract, Candida Bombicola/Glucose/Methyl Rapeseedate Ferment, Coconut oil, Rice Germ Oil, Hydrogenated polydecene, Biosaccharide Gum-1, Ural Licorice Root Extract, Caprylyl/Capryl Glucoside, Dioscorea Japonica Root Extract, Okra Fruit Extract, Sacred Lotus Root Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Ascorbyl Phosphate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Propanediol, Cetearyl Olivate, Pentylene Glycol, Xanthan Gum, Polysorbate 60, Sorbitan Isostearate, Caprylyl Glycol, Butylene Glycol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, isoniacinamide, Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Hydroxypropylcyclodextrin, Cyclodextrin, Sorbitan Olivate, carbomer, Arginine, Allantoin, Dimethicone, Adenosine, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin.

БЕЛСЕНДІ ҚҰРАМДАСТАРЫ:

1. Декспантенол (жоғары концентрация) зақымдалған эпидермисті қарқынды сауықтырады, тыныштандырады және қалпына келтіреді.
2. Транексам қышқылы + глутатион - меланин синтезін бұғаттайтын қуатты үйлесім; пигменттік дақтарды кетіріп, қара шеңберлерді ағартады.
3. Кофеин лимфа дренажын ынталандырып, артық сұйықтықты шығарады және таңертеңгі ісінуді жылдам басады.
4. Глюкозилрутин (Р дәрумені) капилляр қабырғаларын нығайтып, олардың көрінуін (көгілдір реңді) азайтады және тамырлардың сынғыштығының алдын алады.
5. Өсу факторлары кешені (sh-Polypeptide / Oligopeptide 6 түрі) жасушалық жаңаруды іске қосып, терінің өз коллагенін өндіруін ынталандырады және лифтинг әсерін береді.

6. Дәрумендер кешені (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) қоректендіреді, жасушалардағы зат алмасуды жақсартып, теріге сау жарқырауды қайтарады.
7. Ниацинамид қорғаныш тосқауылының қызметін нығайтып, тері құрылымын жақсартады.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: крем көз айналасындағы нәзік теріге кешенді күтім береді. Кофеиннің, ниацинамидтің және транексам қышқылының жоғары концентрациясы қара шеңберлердің, ісіну мен ұсақ әжімдердің көрінуін азайтуға көмектеседі. Белсенді құрамдастар жаңаруды ынталандырады, терең ылғалдандырып қоректендіреді, теріге серпімділік және тегіс, жарқыраған рең береді.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Құрғақ, тазаланған теріге аз мөлшерде жағыңыз: көздің ішкі жағынан самайға қарай алдымен төменгі, содан кейін жоғарғы көз ұясы сүйегінің бойымен жүргізіңіз.
2. Кремді таратып, саусақ ұштарымен уқалаңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ:
1. Қолданар алдында аллергия сынағын жасау ұсынылады.
2. Құралды терінің зақымдалған жерлеріне жақпаңыз.
3. Көзге тікелей тигізбеңіз. Тисе, жылы сумен шайыңыз.

САҚТАУ: жабық қаптамада +5 °C-тан +25 °C-қа дейін, тікелей күн сәулесінен алыс, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

КӨЛЕМІ: 25 g.



CLEANSING BALM

ЖУЫНУҒА АРНАЛҒАН ГИДРОФИЛЬДІ БАЛЬЗАМ

Жұмсақ тазартады

Терең қоректендіреді

Қарқынды ылғалдандырады

Тері тосқауылын нығайтады

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: тұрақты макияж, SPF сүзгілерінің қалдықтары, кірленген тесіктер, тазалаудан кейінгі құрғақтық пен тартылу сезімі, липидтік тосқауылдың бұзылуы.

ӘСЕРІ: тері таза әрі ылғалданған болады, тартылу сезімі жоқ.

ҚҰРАМЫ: Ethylhexyl palmitate, Cetyl Ethylhexanoate, Synthetic wax, PEG-20 Glyceryl Triisostearate, PEG-10 isostearate, Silica Dimethyl Silylate, Synthetic beeswax, Castor Seed Oil, Hydrogenated castor oil, Jojoba Seed Oil, Sunflower seed oil, Tocopherol (vitamin E), Hazelnut seed oil, Argan Kernel Oil, Shea Butter, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, Ceramide NP, Ceramide EOP, Chamomile Flower Water, Green Tea Leaf Extract, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Sodium hyaluronate, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Hydrolyzed sodium hyaluronate, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Hydroxypropyltrimonium hyaluronate, Sodium hyaluronate crosspolymer, Sodium Acetylated Hyaluronate, Dimethylsilanol hyaluronate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Sorbitan sesquioleate, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Pentylene Glycol, Water, Caprylyl Glycol, Fragrance, Hexamethylindanopyran.

БЕЛСЕНДІ ҚҰРАМДАСТАРЫ:

1. Табиғи майлардың бай кешені (майсана, жожоба, күнбағыс, орман жаңғағы, арган, ши) майда еритін кірді (тері майы, тұрақты макияж, SPF) оңай ерітеді, терең қоректендіріп жұмсартады.
2. Гиалурон қышқылының жеті түрі (соның ішінде Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Hyaluronic Acid және т.б.) көп деңгейлі қарқынды ылғалдандыруды қамтамасыз етіп, жуынғанда терінің шамадан тыс құрғауына жол бермейді.
3. Керамид кешені (NS, AP, AS, NP, EOP) эпидермистің липидтік (қорғаныш) тосқауылын тиімді қалпына келтіріп нығайтады.
4. Е дәрумені (Tocopherol) мен ниацинамид - теріні қорғайтын, тыныштандыратын және реңін тегістеуге көмектесетін қуатты антиоксиданттар.
5. Дәрумендер кешені (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) қосымша қоректендіреді, жасушалық зат алмасуды жақсартады және терінің сау жарқырауын сақтайды.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: бальзам теріні тиімді әрі жұмсақ тазартып, макияжды, SPF пен кірді оңай ерітеді. Табиғи майлардың бай кешені терең қоректендіріп жұмсартады. Гиалурон қышқылының жеті түрі мен керамидтер қарқынды ылғалдандырып, қорғаныш тосқауылын нығайтады. Е дәрумені мен ниацинамид теріні қорғайды және тыныштандырады. Қолданғаннан кейін тері таза, ылғалданған болады, тартылу сезімі қалмайды.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Құрғақ қолмен гидрофильді бальзамның аз мөлшерін құрғақ бетке жағып, массаж қозғалыстарымен біркелкі таратыңыз.
2. Қолды сулап, бальзамды жылы сумен жуыңыз. Сумен жанасқанда бальзам сүтше құрылымына айналады.
3. Тазалаудың екінші кезеңіне (жуыну көбігі немесе гелі) көшіңіз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ:
1. Қолданар алдында аллергия сынағын жасау ұсынылады.
2. Құралды терінің зақымдалған жерлеріне жақпаңыз.
3. Көзге тікелей тигізбеңіз. Тисе, жылы сумен шайыңыз.

САҚТАУ: жабық қаптамада +5 °С-тан +25 °С-қа дейін, тікелей күн сәулесінен алыс, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

КӨЛЕМІ: 50 g.



COLD & TONED BODY MILK

КРИО ӘСЕРІ БАР ДЕНЕ СҮТШЕСІ

Ісінуді азайтады

Теріні ылғалдандырып жаңартады

Целлюлитке қарсы күтім

Тонус пен серпімділікті қалпына келтіреді

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: тері серпімділігінің төмендеуі мен босаңсуы, ісінуге бейімділік және аяқтағы ауырлық, өңсіз реңк пен біркелкі емес микробедер, сусыздану мен тартылу сезімі, дене жүктемесінен кейін қалпына келу қажеттілігі.

ӘСЕРІ: салқындату, жеңілдік сезімі және терең ылғалдандыру, тартылған дене пішіні, тері тургорының артуы және целлюлиттің аз байқалуы, тегіс әрі барқыттай тері.

ҚҰРАМЫ: Water, Aloe Vera leaf juice, Menthyl Lactate, Glycerin, Shea Butter, Caffeine, Sodium hyaluronate, Horse chestnut extract, Ivy Extract, Menthol, Laminaria extract, Niacinamide (Vitamin B3), Centella Asiatica Extract, Lemon Peel Extract, lecithin, Cetearyl Alcohol, Jojoba Oil, Sweet Almond Oil, Grape seed oil, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

БЕЛСЕНДІ ҚҰРАМДАСТАРЫ:

Салқындату және тонус

1. Ментиллактат + ментол: таза ментол мен оның жұмсақ туындысы теріні тітіркендірмей, кәдімгі ментолдан ұзағырақ сақталатын жағымды салқындық береді. Аяқтағы ауырлық сезімін басуға көмектеседі.
2. Кофеин (Caffeine) лимфа дренажын қамтамасыз етеді, микроайналымды ынталандырып, артық сұйықтықты шығаруға көмектеседі.

Ісінуге қарсы және сергітетін кешен

1. Aesculus Hippocastanum (атталшын) - тамыр қабырғаларын нығайтып, ісінумен күресетін үздік құрамдастардың бірі.
2. Hedera Helix (шырмауық) + Laminaria (ламинария) терінің серпімділігін арттыруға ықпал етеді. Шырмауық майларды ыдыратып, токсиндерді шығару үшін целлюлитке қарсы құралдарда жиі қолданылады.
3. Citrus Medica Limonum (лимон) сергітіп, капиллярларды нығайтуға көмектеседі.

Қалпына келтіру және ылғалдандыру

1. Aloe Barbadensis (алоэ вера) - құрамның негізі (екінші орында), қуатты тыныштандырғыш және ылғалдандырғыш.
2. Sodium Hyaluronate (гиалурон қышқылы) терінің жоғарғы қабаттарында ылғалды ұстайды.
3. Ниацинамид (В3 дәрумені) қорғаныш тосқауылын жақсартып, реңді тегістейді және микрозақымдарға көмектеседі.

Қоректендіретін негіз (майлар)
1. Ши, жожоба, тәтті бадам және жүзім сүйегінің майлары - теріні барқыттай әрі жұмсақ ететін тиімді қоректік майлар жиынтығы.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: жеңіл құрылымды салқындататын дене сүтшесі теріні бірден сергітіп, терең ылғалдандырады. Кофеин, ламинария және азиялық центелла сығындыларына негізделген белсенді кешен қуатты лимфа дренажын береді. Табиғи сығындылар мен майлар липидтік тосқауылды қалпына келтіріп, теріні жұмсақ әрі тегіс етеді. Тұрақты қолдану теріні айқын тартып, кемшіліктердің көрінуін азайтады.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Таза, құрғақ дене терісіне аз мөлшерде сүтше жағыңыз.
2. Толық сіңгенше жеңіл қозғалыстармен уқалаңыз. Мәселелі аймақтарға ерекше назар аударыңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ: тек сыртқа қолдануға арналған. Құрамында салқындататын заттар бар. Көзге және шырышты қабықтарға тигізбеңіз. Зақымдалған немесе тітіркенген теріге жақпаңыз. Жеке көтере алмау белгілері болса, қолдануды тоқтатыңыз.

САҚТАУ: жабық қаптамада +5 °C-тан +25 °C-қа дейін, тікелей күн сәулесінен алыс, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

КӨЛЕМІ: 250 ml.



COLD & TONED BODY SCRUB

КРИО ӘСЕРІ БАР ДЕНЕ СКРАБЫ

Ісінуді азайтады

Терең тазалау және теріні жаңарту

Целлюлитке қарсы күтім

Тонус пен серпімділікті қалпына келтіреді

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: тері серпімділігінің төмендеуі мен босаңсуы, ісінуге бейімділік және аяқтағы ауырлық, біркелкі емес тері микробедері.

ӘСЕРІ: тегіс микробедер мен тері, ісінудің көрінуін азайту, дене контурын нығайту.

ҚҰРАМЫ: Sea salt, Glycerin, Betaine, Caprylic/Capric Triglyceride, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Sodium Lauroyl Oat Amino Acids, Jojoba Seed Oil, Apricot Kernel Oil, Polysorbate 80, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Menthyl Lactate, Menthol, Caffeine, Horse chestnut seed extract, Ivy Extract, L-Carnitine, Dipotassium Glycyrrhizate, Witch Hazel Water, Cetearyl Alcohol, Sodium cetearyl sulfate, panthenol, Tocopherol (Vitamin E), Citric Acid, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

БЕЛСЕНДІ ҚҰРАМДАСТАРЫ:
Тазалау және салқындату
1. Maris Sal (теңіз тұзы) абразив ретінде мүйізденген жасушаларды кетіреді.
2. Ментиллактат + ментол: таза ментол мен оның жұмсақ туындысы теріні тітіркендірмей, кәдімгі ментолдан ұзағырақ сақталатын жағымды салқындық береді. Аяқтағы ауырлық сезімін басуға көмектеседі.

Ісінуге қарсы және сергітетін кешен
1. Кофеин + L-карнитин: кофеин сұйықтықты шығарып, сергітеді, ал L-карнитин көлемді азайтуға көмектеседі.
2. Aesculus Hippocastanum (атталшын) + Hedera Helix (шырмауық) капиллярлар мен көктамыр қабырғаларын нығайтып, лимфа іркілісінің алдын алады.
3. Hamamelis Virginiana (гамамелис) тұтқыр және тыныштандыратын әсер беріп, тесіктерді тарылтады және тамыр торын нығайтады.

Қоректендіретін негіз (майлар мен пантенол)
1. Жожоба мен өрік майлары тұз әсерін жұмсартып, шамадан тыс құрғауға жол бермейді және қабыршақтандырудан кейін липидтік тосқауылды қалпына келтіреді.
2. Пантенол теріні тыныштандырып, белсенді массаж бен тұздан болуы мүмкін тітіркенуді басады.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: теңіз тұзы мен кофеинге негізделген салқындататын скраб теріні терең тазартып, қабыршақтандырады, микробедерді тиімді тегістеп, ісінуді азайтады. Өсімдік сығындылары мен L-карнитин үйлесімі қуатты лимфа дренажын беріп, тамыр қабырғаларын нығайтады және тері серпімділігін арттыруға көмектеседі. Тұрақты қолдану серпімділікті айтарлықтай арттырып, теріні тартылған әрі тегіс етеді.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Дененің дымқыл терісіне жағып, 2-3 минут айналмалы қозғалыстармен уқалаңыз да, жылы сумен жуыңыз.
2. Аптасына 1-2 рет қолданыңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ: тек сыртқа қолдануға арналған. Құрамында салқындататын заттар бар. Көзге және шырышты қабықтарға тигізбеңіз. Зақымдалған немесе тітіркенген теріге жақпаңыз. Жеке көтере алмау белгілері болса, қолдануды тоқтатыңыз.

САҚТАУ: жабық қаптамада +5 °С-тан +25 °С-қа дейін, тікелей күн сәулесінен алыс, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

КӨЛЕМІ: 300 g.



DEEP MOISTURE BODY CREAM

ДЕНЕГЕ АРНАЛҒАН ЫЛҒАЛДАНДЫРАТЫН КРЕМ

Тыныштандырады | Ылғалдандырады | Жұмсартады

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: терінің құрғақтығы, сусыздануы, тітіркенуі.

ӘСЕРІ: тыныштандырады, тері серпімділігі мен созылғыштығын арттырады, қарқынды қоректендіріп ылғалдандырады, қалпына келу процестерін белсендіреді.

ҚҰРАМЫ: Water, Butylene Glycol, Glycerin, Meadowfoam Seed Oil, Isopropyl Myristate, Shea butter, Betaine, Glyceryl Stearate, Cetearyl Olivate, Squalane, Cetearyl Alcohol, Sorbitan Olivate, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Tromethamine, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Allantoin, Dipotassium Glycyrrhizate, Vinyl Dimethicone, Disodium EDTA, Propanediol, Bergamot fruit oil, Polyglutamic acid, beta-glucan, Thyme leaf extract, Applemint leaf extract, Cynanchum Extract, Tea leaf extract, Extract of mulberry fruit, Goji berry extract, Strawberry fruit extract, Barberry Root Extract.

БЕЛСЕНДІ ҚҰРАМДАСТАРЫ:

1. Бета-глюкан терең ылғалдандырады, терінің жергілікті иммунитетін арттырады, айқын жасартатын әсер береді, теріні «жандандырып», серпімділік пен созылғыштық береді.
2. Жебіршөп жапырағының сығындысы ылғалдың булануына қарсы әсер етіп, теріні ұзақ ылғалданған күйде сақтайды, сау көрініс пен серпімділік береді. Сондай-ақ ағартатын және антиоксиданттық әсері бар.
3. Алма жалбызы жапырағының сығындысы бактерияға қарсы және тыныштандыратын әсер береді, теріні сергітіп, тітіркенумен күреседі.
4. Шай жапырағының сығындысы (Camellia Sinensis) зат алмасуды жеделдетіп, тері күйін қалыпқа келтіреді. Шай жапырағындағы заттар ісінудің алдын алып, тесіктерді тазартады. Полифенолдардың антиоксиданттық қасиеттері терінің ерте қартаюына жол бермеуі мүмкін.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: крем PTD (Protein Transduction Domain) технологиясымен жасалған. Бұл белсенді құрамдастарды тері жасушаларына жеткізудің ең тиімді әдісі деп саналып, қоректік заттардың барынша сіңуін қамтамасыз етеді. Жібектей құрылымы тез сіңіп, жабысқақтық қалдырмайды. Табиғи майлар мен сығындылар терең қоректендіреді, тыныштандырады және ылғалдың булануына жол бермейді, сондықтан тері ұзақ тегіс әрі ылғалданған болып қалады.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:

1. Құралды жағар алдында теріні тазалаңыз.
2. Қажетті мөлшерде жағып, толық сіңгенше саусақ ұштарымен уқалаңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ:
1. Аллергиялық реакцияның алдын алу үшін қолданар алдында шынтақ бүгілісінің ішкі жағында сынау ұсынылады. Тітіркену немесе бөртпе болса, қолдануды тоқтатыңыз.
2. Құралды терінің зақымдалған жерлеріне жақпаңыз.
3. Көзге тікелей тигізбеңіз. Тисе, жылы сумен шайыңыз.
4. Қолданғаннан кейін күн сәулесінен қорғау үшін SPF кремін жағу ұсынылады.

САҚТАУ: жабық қаптамада +5 °С-тан +25 °С-қа дейін, тікелей күн сәулесінен алыс, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

КӨЛЕМІ: 300 ml.



IRRIGATOR RINSE + MOUTHWASH

ЦЕТИЛПИРИДИНИЙ ХЛОРИДІ МЕН ШАЛФЕЙ ҚОСЫЛҒАН АУЫЗ ШАЮ ЖӘНЕ ИРРИГАТОРҒА АРНАЛҒАН КОНЦЕНТРАТ

Ауыз қуысын тиімді тазалау

Тыныстысергітеді

Шырышты қабық пен қызыл иек саулығын қолдайды

Ирригатор әсерін күшейтеді

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: тіс қағы, қызыл иек аурулары, ауыздан жағымсыз иіс, тісжегінің алдын алу.

ӘСЕРІ: ауыз қуысының зиянды микрофлорасымен күреседі, тыныштандыратын және қабынуға қарсы әсер береді, ирригатормен тазалауды массаж және профилактикалық әсермен біріктіруге мүмкіндік береді.

ҚҰРАМЫ: Water, sorbitol, propylene glycol, xylitol, Glycerin, Ginseng Cell Extract (Neovitin®), PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Cetylpyridinium chloride, Sage leaf extract, Flavouring, Peppermint oil, methylparaben, Ethylparaben, Tromethamine, Limonene, eugenol, Linalool.

БЕЛСЕНДІ ҚҰРАМДАСТАРЫ:

1. Цетилпиридиний хлориді - тиімді бактерияға қарсы құрамдас. Тіс қағын, тісжегін, гингивит пен жағымсыз иісті туғызатын бактериялармен күресіп, ұзақ сергектік береді.
2. Шалфей сығындысы мен женьшеньнің Neovitin® биоантиоксиданттық кешені шырышты қабықты тыныштандырып қалпына келтіреді. Қабынуға қарсы әсер беріп, тіндердің жазылуы мен қызыл иек саулығын нығайтуға көмектеседі.
3. Ксилитол тісжегі қаупін азайтады, ауыздағы патогенді бактериялардың өсуін басады, тіс эмалінің реминералдануына және сау pH теңгеріміне ықпал етеді.
4. Жалбыз эфир майы тынысты сергітеді, салқындататын және жеңіл ауырсынуды басатын әсер береді. Бактерияға қарсы әсер етіп, ауызды тазартады және тазалық сезімін береді.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: 2 функция 1 құралда біріктірілген ауыз шаю және ирригатор сұйықтығы ауыз микрофлорасын қалыпқа келтіріп, шырышты қабық күйін жақсартады және тісжегінің алдын алады. Кәдімгі шаю құралы ретінде қауіпті микрофлорадан тазартады, қақ пен жағымсыз иістің алдын алады, шырышты қабық пен қызыл иекті жақсартып, сергектік сезімін береді. Ирригатор сұйықтығы ретінде тазалауды массаж және профилактикалық әсермен біріктіреді.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Ауыз шаю құралы ретінде: концентратты жылы сумен 1:2 қатынасында араластырып, қажетті мөлшерде ерітінді дайындаңыз. Ауыз қуысын 30 секунд шайыңыз. Күн сайын әр тамақтан кейін қолданыңыз.
2. Ирригаторда қолдану үшін: концентратты жылы сумен 1:10 қатынасында араластырыңыз (қызыл иек жағдайы ауыр болса, қатынасты 1:3-ке жеткізуге болады). Құрылғы нұсқаулығына сәйкес ауыз қуысын шайыңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ:
1. Қолданар алдында шайқаңыз. Табиғи құрамдастарға байланысты тұнба түсуі және түсі өзгеруі мүмкін. Жағымсыз сезім болса, қолдануды тоқтатыңыз.
2. Жұтпаңыз.
3. Ересектер мен 14 жастан асқан балаларға арналған.

САҚТАУ: жабық қаптамада +5 °С-тан +25 °С-қа дейін, тікелей күн сәулесінен алыс, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

КӨЛЕМІ: 430 ml.



MILKY ESSENCE TONER

ПРОБИОТИКТЕРІ БАР БЕТ ТОНЕРІ

Қоректендіреді және тыныштандырады

Тері реңін тегістейді

Тері тосқауылын нығайтады

Қарқынды ылғалдандырады

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: липидтік тосқауылдың бұзылуы, сусыздану, жуынғаннан кейінгі құрғақтық пен тартылу, өңсіз бет, сезімталдық, тері микробиомының теңгерімсіздігі.

ӘСЕРІ: тері терең ылғалданып, тыныштанады және келесі күтімге дайындалады; қорғаныш тосқауылы қалпына келіп, реңі тегіс әрі жарқыраған болады.

ҚҰРАМЫ: Water, Glycerin, Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, dexpanthenol, Betaine, Canola oil, Sunflower seed oil, Meadowfoam Seed Oil, Argan Kernel Oil, Trehalose, Allantoin, Centella Asiatica Leaf Water, Green Tea Leaf Water, Dioscorea Japonica Root Extract, Biosaccharide Gum-1, Pentylene Glycol, Aloe vera leaf extract, Laminaria Japonica Extract, Okra Fruit Extract, Sacred Lotus Root Extract, Aloe vera leaf juice, Bifida Ferment Lysate, Lactococcus Ferment Lysate, Lactobacillus Ferment Lysate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Ceramide NP, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Ceramide EOP, Polyglyceryl-10 stearate, Polyglyceryl-10 laurate, Polyglyceryl-10 Myristate, Propanediol, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

БЕЛСЕНДІ ҚҰРАМДАСТАРЫ:

1. Лизаттар кешені (Bifida, Lactococcus, Lactobacillus Ferment Lysate) - сау тері микробиомын қалпына келтіретін, сезімталдықты азайтып, жергілікті иммунитетті нығайтатын пробиотиктер.
2. Керамид кешені (Ceramide NP, NS, AP, AS, EOP) - мүйізді қабаттың зақымдалған жерлеріне кірігіп, қорғаныш тосқауылын тиімді қалпына келтіретін және ылғал жоғалуына жол бермейтін физиологиялық липидтер.
3. Азиялық центелла жапырағының сығындысы - теріні тыныштандырып, қызару мен тітіркенуді басатын қуатты табиғи құрамдас.
4. Ниацинамид қорғаныш тосқауылының қызметін нығайтып, тері құрылымын жақсартады.
5. Өсу факторлары кешені (sh-Polypeptide / Oligopeptide) жасушалық жаңаруды іске қосып, терінің өз коллагенін өндіруін ынталандырады және лифтинг әсерін береді.

6. Дәрумендер кешені (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) мен декспантенол қоректендіреді, жасушалық зат алмасуды жақсартады, сау жарқырауды қайтарады және эпидермисті қарқынды сауықтырып қалпына келтіреді.
7. Табиғи майлар кешені (канола, күнбағыс, шалғындық лимнантес, арган) қарқынды қоректендіреді, жұмсартады және құрғақтықты жояды.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: тонер қарқынды ылғалдандырып қалпына келтіреді, теріні келесі күтімге дайындайды. Лактобактерия лизаттары мен керамидтер кешені қорғаныш тосқауылын тиімді нығайтып, микробиомның табиғи теңгерімін сақтайды. Азиялық центелла, ниацинамид, пептидтер мен өсімдік сығындылары тыныштандырады, қоректендіреді және реңді тегістеп, сау жарқыраған көрініс береді.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Жуынғаннан кейін бетке қалыпты мөлшерде тонер шашыңыз.
2. Кебуін күтіп, күтімді сарысу немесе креммен аяқтаңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ:
1. Қолданар алдында аллергия сынағын жасау ұсынылады.
2. Құралды терінің зақымдалған жерлеріне жақпаңыз.
3. Көзге тікелей тигізбеңіз. Тисе, жылы сумен шайыңыз.

САҚТАУ: жабық қаптамада +5 °C-тан +25 °C-қа дейін, тікелей күн сәулесінен алыс, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

КӨЛЕМІ: 150 ml.



MOISTURE MASSAGE GEL

ЭЛЕКТРЛІК СТИМУЛЯЦИЯ ПРОЦЕДУРАЛАРЫНА АРНАЛҒАН ЫЛҒАЛДАНДЫРАТЫН ГЕЛЬ

Қарқынды ылғалдандырады

Қалпына келтіреді

Ток өткізеді

Пигментацияны ағартады

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: құрғақ тері, микротокты массаж қажеттілігі.

ӘСЕРІ: ылғалдандыру, қалпына келтіру, тиімді микротокты массаж.

ҚҰРАМЫ: Unshiu Mandarin Extract (Citrus Unshiu), Glycerin, Propanediol, Niacinamide, 1,2-Hexanediol, Betaine, Water, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Caprylyl Glycol, Pentylene Glycol, Scots Pine Needle Extract, Adenosine, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Tranexamic acid, Hydrolyzed Collagen, Centella Asiatica Extract, Hydrogenated lecithin, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydroxydecyl Ubiquinone (Idebenone), Soy Sterols, Madecassoside, Acetyl glucosamine, panthenol, Broussonetia Kazinoki Root Extract, White mulberry bark extract, Apple extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Octapeptide-7, Acetyl Hexapeptide-8 (Argireline), Camellia Sinensis Leaf Extract, Andrographis Paniculata Extract, Copper Tripeptide-1, Ethylhexylglycerin, galactoarabinan, sh-Decapeptide-7, sh-Octapeptide-4, sh-Oligopeptide-9, sh-Pentapeptide-19, Matsutake mushroom extract, Black Mulberry Extract, Goji Berry Extract (Lycium Chinense), Chilean strawberry extract, Barberry Root Extract, glutamine, leucine, phenylalanine, Arginine, Lysine hydrochloride, proline, aspartic acid, valine, glycine, isoleucine, threonine, histidine, serine, Alanine, methionine, tryptophan, tyrosine, asparagine, Glutamic acid, cysteine, taurine, carnitine.

БЕЛСЕНДІ ҚҰРАМДАСТАРЫ:

1. Citrus Unshiu Fruit Extract (уншиу мандаринінің сығындысы) - гельдің ылғалдандыратын негізі (судың орнына). Пигментацияны ағартатын қуатты табиғи антиоксидант.
2. Ниацинамид (Niacinamide) - B3 дәрумені. Қорғаныш қызметін жақсартып, тесіктерді тарылтады және реңді тегістейді.
3. Транексам қышқылы (Tranexamic Acid) - пигментация мен қызаруға қарсы ең тиімді заманауи құрамдастардың бірі.
4. Acetyl Hexapeptide-8 (аргирелин) - белгілі пептидтік миорелаксант. Бет бұлшықеттерін босаңсытып, мимикалық әжімдердің тереңдігін азайтады.
5. Copper Tripeptide-1 (мыс пептиді) қалпына келу процестерін іске қосады, коллаген мен эластин синтезін ынталандырады және зақымдарды жазады.
6. sh-пептидтер тобы (sh-Oligopeptide, sh-Decapeptide және т.б.) - терінің тезірек жаңарып, құрылымының тығыздалуына ықпал ететін сигналдық молекулалар.

7. Аденозин (Adenosine) - уақытпен тексерілген жасартатын құрамдас, терінің өз коллагенін өндіруін арттырады.
8. Hydroxydecyl Ubiquinone (идебенон) - косметика әлеміндегі ең қуатты антиоксидант (Q10 коэнзиміне ұқсас), жасушаларды тотығу күйзелісінен қорғайды.
9. Гидролизденген коллаген (Hydrolyzed Collagen) бірден лифтинг әсерін және терең ылғалдандыруды қамтамасыз етеді.
10. Centella Asiatica (азиялық центелла) + Madecassoside (мадекассосид) теріні жұмсақ тыныштандырады, тамырларды нығайтады және қабынуды басады.
11. Пантенол (Panthenol) сауықтырады және ылғалды сақтайды.
12. Аминқышқылдар жиынтығы (глутамин, аргинин, лизин, валин және т.б., барлығы 20-дан астам) - тері ақуыздарының құрылыс бөлшектері. Микротоктармен бірге тері серпімділігі мен өздігінен қалпына келу қабілетін сақтауға көмектеседі.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: микротокты және EMS процедураларына арналған, жеңіл әрі жайлы құрылымды ылғалдандыратын гельдің мандарин сығындысы, ниацинамид, коллаген, пантенол және өсімдік сығындыларына негізделген белсенді кешені терең ылғалдандырады, жұмсартады және тыныштандырады. Құрылғылардың мінсіз сырғуын қамтамасыз етіп, жабысқақтық пен тартылу сезімін қалдырмайды.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Құралды құрғақ, тазаланған бет терісіне жағыңыз.
2. Электрлік стимуляция массажерімен процедураны орындаңыз. Гельді толық сіңгенше қалдырыңыз.
3. Ылғалдандырғыш (крем немесе сарысу) жағып, күтімді аяқтаңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ:
1. Қолданар алдында аллергия сынағын жасау ұсынылады.
2. Құралды терінің зақымдалған жерлеріне жақпаңыз.
3. Көзге тигізбеңіз. Көздің шырышты қабығына тисе, сумен мұқият шайыңыз.

САҚТАУ: жабық қаптамада +5 °C-тан +25 °C-қа дейін, тікелей күн сәулесінен алыс, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

КӨЛЕМІ: 150 ml.



PEPTIDE GOLD-LIFT SERUM

ЛИФТИНГ ӘСЕРІ БАР БЕТКЕ АРНАЛҒАН ПЕПТИДТІ САРЫСУ

Әжімдерді азайтады

Тері құрылымын тегістейді

Лифтинг әсері

Терең ылғалдандырады

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: бет сопағының айқындығы мен тері серпімділігінің жоғалуы, мимикалық әжімдер мен қатпарлар, «шаршаған» тері.

ӘСЕРІ: теріні айқын тегістеп тығыздайды, реңді біркелкі етеді, тесіктерді тарылтып, іштен «жарықтану» әсерін береді.

ҚҰРАМЫ: Water, Butylene Glycol, Glycerin, Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Diethylhexyl Succinate, Betaine, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Arginine, Allantoin, Sodium hyaluronate, Cellulose gum, Sodium Polyacrylate, Polyglyceryl-6 Caprylate, Polyglyceryl-4 Caprate, Adenosine, Gold, Bergamot oil, Lavender oil, Grapefruit oil, Propanediol, Disodium EDTA, Frankincense Oil, Geranium Oil, Cocoa extract, Sodium Hyaluronate crosspolymer, Dextrin, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Soy Isoflavones, Undaria Pinnatifida Extract, Kudzu Extract, Laminaria Japonica Extract, Ecklonia Cava Extract, Akebia Quinata Extract, Pueraria Mirifica Extract, Japanese Knotweed Extract, Black Cohosh Extract, Clover Extract, Pomegranate extract, Chinese Angelica Extract, Madecassoside, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Asiaticoside, Caprylyl Glycol, Sodium phosphate, Madecassic Acid, Ethylhexylglycerin, Asiatic Acid, Palmitoyl Tripeptide-5, Hydrogenated Lecithin, Hyaluronic Acid, Copper Tripeptide-1, Acetyl Hexapeptide-8, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-1, Citronellol, Limonene, Linalool.

БЕЛСЕНДІ ҚҰРАМДАСТАРЫ:

1. Алтын микроайналымды жақсартып, теріге сау жарқырау береді.
2. Acetyl Hexapeptide-8 (аргирелин) - бет бұлшықеттерін жұмсақ босаңсытып, мимикалық әжімдердің тереңдігін азайтатын пептидтік миорелаксант.
3. Өсу факторлары кешені (sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-1) жасуша бөлінуі мен коллаген синтезін ынталандырып, қалпына келу процестерін іске қосады.
4. Palmitoyl Tripeptide-5 теріге терең еніп, I және III типті коллаген түзілуін ынталандырады, дерма құрылымын нығайтады.
5. Фитоэстрогендер (соя, пуэрария, беде, цимицифуга) - жасқа байланысты өзгерістерді түзететін өте қуатты кешен. Терінің өз ресурстарының жетіспеуін толықтырып, серпімділігін қайтарады.

6. Copper Tripeptide-1 (мыс трипептиді) қуатты сауықтыратын және антиоксиданттық әсер беріп, теріні тығыздайды.
7. Ниацинамид пен аденозин - пигментацияны ағартуға және әжімдерге қарсы классикалық корейлік «дуэт».

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: белсенді құрамдастарының концентрациясы жоғары бетке арналған пептидті сарысу тонусты жақсартып, әжімдерді айқын тегістейді. Алтын микробөлшектері жасушалық белсенділікті ынталандырып, теріні тегіс, тартылған әрі сау көрсетеді.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Сарысудың аз мөлшерін бетке, мойын мен декольтеге жағыңыз.
2. Толық сіңгенше теріде қалдырыңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ:
1. Қолданар алдында аллергия сынағын жасау ұсынылады.
2. Құралды терінің зақымдалған жерлеріне жақпаңыз.
3. Көзге тікелей тигізбеңіз. Шырышты қабыққа тисе, сумен мұқият шайыңыз.

САҚТАУ: жабық қаптамада +5 °С-тан +25 °С-қа дейін, тікелей күн сәулесінен алыс, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

КӨЛЕМІ: 30 ml.



PORE CLEANSING GEL

ДЕЗИНКРУСТАЦИЯҒА (ТАЗАЛАУҒА) АРНАЛҒАН ГЕЛЬ

Өлі тері жасушаларын қабыршақтандырады

Тесіктерді ашады

Тыныштандырады

Ылғалдандырады

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: кеңейген тесіктер, ашық және жабық комедондар, безеу.

ӘСЕРІ: мүйізденген жасушаларды қабыршақтандырады, тесіктерді кеңейтеді, ылғалдандырады.

ҚҰРАМЫ: Purified Water, Glycerin, propylene glycol, carbomer, Aloe juice, Polyvinylpyrrolidone, Potassium hydroxide, potassium chloride, Kathon, Neolone, Disodium EDTA, Fragrance, Food Colouring.

БЕЛСЕНДІ ҚҰРАМДАСТАРЫ:
1. Поливинилпирролидон кірді сіңіреді, антисептикалық қасиеті бар.
2. Алоэ вера шырыны қабынуға қарсы әсер береді.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: гель ультрадыбыстық және қолмен бет тазалау алдында салқын буландыруға қолданылады. Барлық тері түріне, соның ішінде сезімтал теріге жарайды.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:

Бірінші тәсіл: гальваникалық токпен дезинкрустация кезінде гельді теріге жағып, теріс полюстен 7-10 минут жұмыс істеңіз. Гель қалдығын толық кетіріңіз. Содан кейін таза сумен оң полюстен 1-2 минут жұмыс істеңіз. Бір процедураға 5-7 ml гель жұмсалады.

Екінші тәсіл: ультрадыбыстық пилинг кезінде гельді тазаланған теріге жағып, процедура хаттамасына сай қалақшамен жұмыс істеңіз. Гель қалдығын толық кетіріңіз. Бір процедураға 7-10 ml гель жұмсалады.

Үшінші тәсіл: салқын буландыруда макияжды кетіргеннен кейін гельді қалың қабатпен 15 минутқа жағып, үлдірмен жабыңыз. Гель қалдығын жуып тастаңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ:
1. Күйік, қышу, қызару және ісінуге жол бермеу үшін қолданғаннан кейін тікелей күн сәулесінен сақтаныңыз.
2. Жарақаттанған теріге жақпаңыз.

САҚТАУ: жабық қаптамада +5 °C-тан +25 °C-қа дейін, тікелей күн сәулесінен алыс, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

КӨЛЕМІ: 100 ml.



THERMAL PROTECTION

ШАШҚА АРНАЛҒАН ЖЫЛУДАН ҚОРҒАЙТЫН КРЕМ-ФЛЮИД

Сәндеу кезіндегі жылудан қорғайды

Шашты қоректендіріп қалпына келтіреді

Шашты сау әрі күтімді етеді

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: жоғары температура әсері, өңсіз, сынғыш және жансыз шаш.

ӘСЕРІ: жоғары температурадан қорғау, шашты нығайту және қоректендіру.

ҚҰРАМЫ: Purified Water, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Behentrimonium Chloride, cetrimonium chloride, D-panthenol, Wheat germ oil, Pomegranate extract, Birch leaf extract, Chamomile extract, Horsetail Extract, Nettle extract, Aloe vera extract, Burdock root extract, Green tea extract, Hop extract, Henna extract, Millet Seed Extract, Sage extract, Biotin, niacin, lecithin, Hydroxyacetophenone, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Citric Acid, potassium sorbate, Sodium benzoate, Phenylethyl alcohol, Fragrance, Hydroxycitronellal.

БЕЛСЕНДІ ҚҰРАМДАСТАРЫ:
1. D-пантенол (B5 провитамині) шаш құрылымына терең еніп, шаш пен бас терісін қарқынды ылғалдандырады. Зақымдалған жерлерді қалпына келтіріп, шашты тегіс, серпімді әрі жылтыр етеді. Құрғаудан және жылулық әсерден қорғайды.
2. Бидай ұрығының майы дәрумендерге (E, A, D) және май қышқылдарына бай. Құрғақ, зақымдалған шашты терең қоректендіріп қалпына келтіреді, жібектей жұмсақтық пен сау көрініс береді. Сыртқы агрессивті әсерлерден қорғайтын тосқауыл түзеді.
3. Өсімдік сығындыларының кешені (анар, қайың, түймедақ, қырықбуын, қалақай, алоэ вера, түйежапырақ тамыры, көк шай, құлмақ, қына, тары, шалфей):
Анар сығындысы - шашты сыртқы орта мен бос радикалдардың теріс әсерінен қорғайтын қуатты антиоксидант. Боялған шаш түсін сақтап, жылтыр мен өміршеңдік береді. Қырықбуын, қалақай, түйежапырақ тамыры, тары және құлмақ сығындылары фолликулдарды нығайтуға, шаштың түсуін азайтып, өсуін ынталандыруға көмектеседі. Алоэ вера, түймедақ пен қайың терең ылғалдандырып жұмсартады, шашты көнбіс әрі тегіс етеді, бас терісін тыныштандырып, тітіркенуді азайтады. Көк шай, қына мен шалфей антиоксиданттық қасиетке ие: зақымнан қорғайды, табиғи жылтыр мен сау көрініс береді.
4. Биотин (H / B7 дәрумені) фолликулдарды нығайтып, сау әрі күшті шаштың өсуіне ықпал етеді, сынғыштық пен түсудің алдын алады. Шашқа көлем мен өміршеңдік береді.

5. Ниацин (B3 / PP дәрумені) бас терісінің микроайналымын жақсартып, фолликулдарға қоректік заттардың жақсы жеткізілуіне көмектеседі. Шаш өсуін белсендіреді, құрылымын нығайтады және сау жылтыр береді.
6. Лецитин (табиғи эмульгатор) зақымдалған шашты қалпына келтіруге көмектесіп, жұмсақтық пен тегістік береді. Басқа белсенді құрамдастардың сіңуін жақсартады.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: крем-флюид сәндеу кезінде (фен, стайлер, түзеткіш) жоғары температурадан тиімді қорғап қана қоймай, кешенді күтім береді: қарқынды ылғалдандырады, қоректендіреді, зақымдалған жерлерді қалпына келтіреді, фолликулдарды нығайтады, шаш өсуін ынталандырады, жылтыр, жібектей жұмсақтық және сау, күтімді көрініс береді.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Таза, сүлгімен құрғатылған шашқа жағыңыз.
2. Түбірге жақпаңыз. Шаймаңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ:
1. Жағымсыз сезім болса, қолдануды тоқтатыңыз.
2. Көзге тисе, сумен мұқият шайыңыз.

САҚТАУ: жабық қаптамада +5 °C-тан +25 °C-қа дейін, тікелей күн сәулесінен алыс, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

КӨЛЕМІ: 100 ml.



TRICHO SOLUTION HAIR MASK

ШАШ ӨСУІНЕ АРНАЛҒАН КОНЦЕНТРЛЕНГЕН МАСКА

Бас терісі мен шашты қоректендіреді

Бас терісін қорғайды және қалпына келтіреді

Шаш өсуін ынталандырады

Оңай таралу

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: шаш түсуі, сиреуі, жұқа әрі сынғыш шаш.

ӘСЕРІ: шаштың түсуімен күреседі, жаңа шаштың өсуіне ықпал етеді, нығайтып, қалың, берік әрі серпімді етеді, бас терісін тыныштандырады.

ҚҰРАМЫ: Water, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Ethyl esters of shea butter, Behenamidopropyl Dimethylamine, Hydrolyzed keratin, Coconut oil, Fragrance, Caffeine, Lactic Acid, Butylene Glycol, PPG-26-Buteth-26, Biotinoyl Tripeptide-1, apigenin, Oleanolic acid, Ceteareth-20, Hydrolyzed Collagen, Hydrolyzed Wheat Proteins, Laminaria Digitata Extract, Hydrogenated lecithin, Cetyl-PG hydroxyethyl palmitamide, Ceramide EOP, Ceramide NS/Ceramide NG, Ceramide NP, Ceramide AS, Ceramide AP, Cholesterol, 1,2-Hexanediol, panthenol, Disodium EDTA, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, BHT (Butylated Hydroxytoluene).

БЕЛСЕНДІ ҚҰРАМДАСТАРЫ:

Өсуді ынталандыру және түсумен күресу

1. Кофеин (Caffeine) қан микроайналымын жақсартып, түбірлерді қоректік заттармен қамтамасыз етеді және гормондардың шаш түсуіне теріс әсерін бұғаттауға көмектеседі.
2. Procapil - 3 белсенді молекуладан тұратын пептидтік кешен:

Biotinoyl Tripeptide-1 (биотиноил трипептид-1) - фолликулдың дерманың терең қабаттарында бекінуін нығайтып, жасуша бөлінуін жеделдететін, жаңа шаш өсуіне ықпал ететін арнайы пептид.

Oleanolic Acid (олеанол қышқылы) зәйтүн жапырағынан алынады. 5-альфа-редуктаза ферментін бұғаттап, шаш түсуінің алдын алады.

Apigenin (апигенин) - цитрустан алынатын флавоноид. Тамырларды кеңейтіп, фолликулдар айналасындағы қан айналымын ынталандырады, қоректенуін қамтамасыз етеді.

Шаш құрылымын қалпына келтіру

1. Hydrolyzed Keratin (гидролизденген кератин) шаштың бос қуыстарына еніп, іштен қалпына келтіреді, кеуектілікті жояды.
2. Hydrolyzed Wheat Protein (бидай ақуыздары) шаш бетінде суды ұстайтын жұқа үлдір түзіп, терең ылғалдандыруға ықпал етеді.
3. Hydrolyzed Collagen (гидролизденген коллаген) шаш серпімділігін арттырып, көнбіс әрі жылтыр етеді.

Бас терісінің күтімі
1. Керамид кешені (Ceramide EOP, NS, NG, NP, AS, AP): 6 түрі тері мен шаштың өз липидтері жетіспеуін толықтырып, қорғаныш тосқауылын нығайтады.
2. Hydrogenated Lecithin (гидрогенделген лецитин) керамид әсерін күшейтеді, теріні жұмсартып, сыртқы ортаның агрессивті әсерінен қорғайды.
3. Пантенол (Panthenol) бас терісін бірден тыныштандырып, микрозақымдардың жазылуына көмектеседі.

Қоректендіру және жылтыр
1. Cocos Nucifera Oil - шаштың терең қабаттарына (медуллаға) еніп, іштен қоректендіре және липидтік қабатын қалпына келтіре алатын жалғыз май. Жуу мен жылулық сәндеу кезінде ақуыз жоғалуын айтарлықтай азайтып, құрылымын тұтас әрі берік сақтауға көмектеседі.
2. Laminaria Digitata Extract тері мен шашты минералдар және микроэлементтермен қанықтырып, қосымша ылғалдандыруға ықпал етеді.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: Procapil пептидтік кешеніне негізделген маска фолликулдарға тікелей әсер етіп, түбірлердің нығаюы мен шаш өсуіне көмектеседі. Керамид кешені зақымдалған шашты қалпына келтіреді, бас терісін терең ылғалдандырып, құрғақтықты жояды, сыртқы ортаның теріс әсерінен қорғаныш тосқауылын түзеді. Кофеин сергітіп, бас терісінің қан айналымын ынталандырады және шаш түсуінің алдын алады. Кокос майы қоректендіріп, жылтыр мен күш береді. Кератин мен бидай ақуыздары зақымдалған шаш кутикуласын қалпына келтіреді, сынғыштықты азайтып, ұштардың айырылуына жол бермейді. Маска фолликулдарды нығайтып, шаш түсуін тоқтатады және жаңа шаш өсуін белсендіреді.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Бас терісіне массаж қозғалыстарымен жағып, шаш ұзындығына таратыңыз.
2. 5-10 минут ұстап, жылы сумен жуыңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ: тек сыртқа қолдануға арналған. Көзге тисе, мол сумен шайыңыз. Жекелеген құрамдастарды көтере алмау болуы мүмкін.

САҚТАУ: құрғақ, жарықтан қорғалған жерде, +5 °C-тан +25 °C-қа дейін, балалардың қолы жетпейтін жерде.

КӨЛЕМІ: 300 ml.



TRICHO SOLUTION HAIR TONIC

ШАШ ӨСУІНЕ АРНАЛҒАН САРЫСУ

Бас терісінің қабынуы, қышуы мен құрғақтығының алдын алуға көмектеседі

Шаш өсуін ынталандырады

Шаш қалыңдығын арттырады

Шаш түсуіне қарсы әсер етеді

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: алопеция, шаш түсуі, сиреуі, жұқа әрі сынғыш шаш.

ӘСЕРІ: шаш түсуімен күреседі, жаңа шаш өсуіне ықпал етеді, нығайтады және қалыңдатады.

ҚҰРАМЫ: Water, Acetyl tetrapeptide-3, dextran, Meadow Clover Flower Extract, Biotinoyl Tripeptide-1, Butylene Glycol, PEG-40 hydrogenated castor oil, apigenin, Oleanolic acid, Poloxamer 188, Hydrolyzed Wheat Proteins, Rosemary extract, Adenosine, Copper Tripeptide-1, Menthol, Succinic acid, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

БЕЛСЕНДІ ҚҰРАМДАСТАРЫ:

Өсуді ынталандыру және түсумен күресу

1. Capixyl (3%) - Acetyl Tetrapeptide-3 пен Trifolium Pratense сығындысының үйлесімі. Кешен түбірге әсер етіп, көлемін ұлғайтады және теріде бекінуін нығайтады, микроқабынуды басады.
2. Procapil - 3 белсенді молекуладан тұратын пептидтік кешен:

Biotinoyl Tripeptide-1 (биотиноил трипептид-1) - фолликулдың дерманың терең қабаттарында бекінуін нығайтып, жасуша бөлінуін жеделдететін, жаңа шаш өсуіне ықпал ететін арнайы пептид.

Oleanolic Acid (олеанол қышқылы) зәйтүн жапырағынан алынады. 5-альфа-редуктаза ферментін бұғаттап, шаш түсуінің алдын алады.

Apigenin (апигенин) - цитрустан алынатын флавоноид. Тамырларды кеңейтіп, фолликулдар айналасындағы қан айналымын ынталандырады, қоректенуін қамтамасыз етеді.

Copper Tripeptide-1 (мыс пептиді) бас терісін «жасартады», шаштың өсу кезеңін (анагенді) ұзартады және фолликул айналасында коллаген түзілуін ынталандырады.

Жасушалық энергия және зат алмасу

1. Аденозин (Adenosine) жасушалық деңгейде өсу факторларының түзілуін белсендіріп, шаштың қалың әрі күшті өсуіне көмектеседі.
2. Succinic Acid (янтарь қышқылы) тері жасушаларындағы зат алмасуды ынталандырып, фолликулдардың күйзелістен кейін тезірек қалпына келуіне көмектеседі.

Микроайналымды жақсарту және детокс
1. Ментол жұмсақ салқындату арқылы түбірлерге бірден қан ағынын қамтамасыз етіп, пептидтердің әсерін күшейтеді.
2. Rosmarinus Officinalis Extract (розмарин сығындысы) антисептикалық әсер береді және қан айналымын қуатты табиғи ынталандырады.
3. Hydrolyzed Wheat Protein шаш құрылымын түбінен нығайтып, сынғыштықтың алдын алады.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: Capixyl және Procapil пептидтік кешендеріне негізделген сарысу фолликулдарға тікелей әсер етіп, түбірлерді нығайтады және белсенді шаш өсуіне ықпал етеді. Мыс-1 пептиді мен аденозин үйлесімі бас терісін жасушалық деңгейде жасартады, тығыздықты арттырады және әр шаштың өмірлік цикл кезеңін ұзартады. Янтарь қышқылы мен ментол сергітеді, жасушалық тынысты жақсартып, қан айналымын ынталандырады, қоректік заттарды түбірлерге дереу жеткізеді. Розмарин сығындысы мен бидай ақуыздары бас терісін сауықтырып, зақымдалған шаш құрылымын түбінен қалпына келтіреді және сынғыштықты азайтады. Тұрақты қолдану фолликулдарды тиімді нығайтып, ерте түсуді тоқтатады және жаңа, сау шаш өсуін белсендіреді.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Сарысуды бас терісіне шашыңыз.
2. Жеңіл массаж қозғалыстарымен теріге сіңіріңіз. Шаймаңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ: тек сыртқа қолдануға арналған. Бас терісі мен сақалға жағыңыз. Тітіркенсе, қолдануды тоқтатыңыз. Жекелеген құрамдастарды көтере алмау болуы мүмкін.

САҚТАУ: құрғақ, жарықтан қорғалған жерде, +5 °C-тан +25 °C-қа дейін, балалардың қолы жетпейтін жерде.

КӨЛЕМІ: 200 ml.



TRICHO SOLUTION SCALP GEL

БАС ТЕРІСІНЕ АРНАЛҒАН ТАЗАРТАТЫН ГЕЛЬ-ПИЛИНГ

Бас терісін терең тазалау

Қайызғақтың алдын алуға көмектеседі

Шаш өсуін ынталандырады

Эпидермисті жаңартады

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: майлы бас терісі, кірлену, қышу, құрғақтық және қайызғаққа бейімділік, фолликулдардың нашар қоректенуі.

ӘСЕРІ: шаш түбірі ұзағырақ таза әрі сусымалы болып қалады, түбір маңында көлем пайда болады, шаш өсуі жеделдейді.

ҚҰРАМЫ: Water, Lactic Acid, Hydroxyethylurea, Glycolic acid, Salicylic acid, Xanthan Gum, Hydroxyethylcellulose, Sodium hydroxide, Calendula Flower Extract, Menthol, Citric Acid, Peppermint oil, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

БЕЛСЕНДІ ҚҰРАМДАСТАРЫ:
Тазалау
1. Lactic Acid (сүт қышқылы) - мүйізденген жасушаларды қабыршақтандыратын, түбір маңында жұмсақ жаңару мен жылтыр беретін жұмсақ AHA қышқылы.
2. Glycolic Acid (гликоль қышқылы) AHA қышқылдарының ішінде ең кіші молекулаға ие, сондықтан тереңірек әрі тезірек енеді. Өлі қабыршақтар арасындағы ақуыздық байланыстарды тиімді бұзып, гиперкератоздың алдын алады.
3. Salicylic Acid (салицил қышқылы) - құрамдағы жалғыз BHA қышқылы. Майда еритіндіктен, фолликулға еніп, май тығындарын (себумды) ерітеді. Майлылықпен күресу мен қабынудың алдын алудағы негізгі құрамдас.
4. Citric Acid қосымша қабыршақтандырғыш және pH реттегіші ретінде жұмыс істейді.

Ылғалдандыру және қорғау
1. Hydroxyethyl Urea (гидроксиэтилмочевина) - косметикадағы ең жақсы ылғалдандырғыштардың бірі. Эпидермистің терең қабаттарында ылғалды сақтайды, қышқылдардың әсерін жұмсартып, процедурадан кейін тартылу сезімін болдырмайды.
2. Calendula Officinalis Flower Extract - белгілі тыныштандырғыш құрамдас. Тітіркенуді басады, антисептикалық әсер береді және тері микрозақымдарының қалпына келуін жеделдетеді.

Шашты нығайтып, өсуін ынталандырады
1. Ментол + Mentha Piperita Oil (жалбыз майы) айқын салқындататын әсер береді. Бұл жағымды ғана емес, пайдалы да: ментол фолликулдарға қан ағынын ынталандырып, шаштың нығаюы мен өсуіне көмектесуі мүмкін.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: AHA және BHA қышқылдары кешеніне негізделген бас терісінің тазарту гелі мүйізденген жасушаларды, артық май мен сәндеу қалдықтарын терең тазартады, гидролипидтік теңгерімді қалыпқа келтіріп, қарқынды күтімге дайындайды. Тұрақты қолдану бас терісін сауықтырады, құрғақтық пен қабыршақтанудың алдын алып, шашқа көлем мен саулық береді.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Құрғақ немесе сәл дымқыл бас терісіне айырықтар бойымен аз мөлшерде гельді біркелкі жағыңыз.
2. Біркелкі таралуы үшін саусақ ұштарымен 1-2 минут жұмсақ уқалаңыз.
3. Әсер етуі үшін 5-10 минут қалдырыңыз (алғаш қолданғанда 5 минуттан бастау ұсынылады).
4. Сусабынмен жылы сумен мұқият жуыңыз. Аптасына 1-2 рет қолдану ұсынылады.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ: тек сыртқа қолдануға арналған. Көзге тисе, мол сумен шайыңыз. Жекелеген құрамдастарды көтере алмау болуы мүмкін.

САҚТАУ: құрғақ, жарықтан қорғалған жерде, +5 °C-тан +25 °C-қа дейін, балалардың қолы жетпейтін жерде.

КӨЛЕМІ: 150 ml.



UV SHIELD SPF 50+ CREAM

SPF50+ КҮННЕН ҚОРҒАЙТЫН КРЕМ

Ультракүлгіннен қорғау

Майлы жылтырсыз ылғалдандырады

Жасқа байланысты өзгерістердің алдын алуға көмектеседі

Тері реңін түзетеді

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: ультракүлгін әсері, фотоқартаю, пигментация, біркелкі емес реңк, күннен терінің құрғауы мен тітіркенуі.

ӘСЕРІ: тері күн сәулесінен сенімді қорғалған, терең ылғалданған, реңі тегіс және фотоқартаюға ұшырамайды.

ҚҰРАМЫ: Water, Dipropylene Glycol, Homosalate, Cetyl Ethylhexanoate, Cetearyl Alcohol, Butylmethoxydibenzoylmethane (Avobenzone), glyceryl stearate, Niacinamide, PEG-100 Stearate, Dimethicone, Betaine, Polyacrylate-13, Silica, Cetearyl Glucoside, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Arginine, Polyisobutene, Fragrance, tocopheryl acetate, Polysorbate 20, Adenosine, Sorbitan Isostearate, Disodium EDTA, Butylene Glycol, Centella Asiatica Extract, Extract of Passiflora (Passionflower), Stinging Nettle Extract, Polygonum Multiflorum Root Extract, Black Bamboo leaf extract, Houttuynia Cordata Extract, Eclipta Prostrata Extract, Alpine Edelweiss Extract, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Purslane Extract, Lavender Extract, Witch Hazel Water, Fig Fruit/Leaf Extract, Chamomile Flower Extract, Green Tea Leaf Extract, Algae Extract, Saussurea Involucrata Extract, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Benzyl Benzoate, Geraniol, Citral.

БЕЛСЕНДІ ҚҰРАМДАСТАРЫ:

1. Химиялық күн сүзгілері (Homosalate, Butyl Methoxydibenzoylmethane / Avobenzone) ультракүлгінді тиімді сіңіріп, фотоқартаюдың негізгі себептері UVA және UVB сәулелерінен сенімді қорғайды.
2. Ниацинамид қорғаныш қызметін нығайтып, реңді тегістейді және тері құрылымын жақсартады.
3. Өсімдік сығындыларының кешені (азиялық центелла, түймедақ, көк шай, гамамелис, портулак) теріге жұмсақ күтім береді, қарқынды тыныштандырады, қызаруды басады және тітіркендірмейді.
4. Аденозин жасартатын әсер беріп, әжімдерді тегістеуге және тері серпімділігін жақсартуға көмектеседі.
5. Е дәрумені (Tocopheryl Acetate) - жасушаларды бос радикалдар мен сыртқы ортаның теріс әсерінен қосымша қорғайтын қуатты антиоксидант.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: күннен қорғайтын сарысу жұмсақ күтім береді, тыныштандырады және фотоқартаюдың негізгі себептері UVA мен UVB сәулелерінен сенімді қорғайды. Өсімдік сығындылары мен ниацинамидке негізделген формула тітіркендірмей, қарқынды ылғалдандырады және реңді тегістейді.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Крем-сарысуды құрғақ теріге жағып, бет пен мойынға біркелкі таратыңыз.
2. 15 минут сіңуін күтіңіз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ:
1. Қолданар алдында аллергия сынағын жасау ұсынылады.
2. Құралды терінің зақымдалған жерлеріне жақпаңыз.
3. Көзге тікелей тигізбеңіз. Шырышты қабыққа тисе, сумен мұқият шайыңыз.

САҚТАУ: жабық қаптамада +5 °С-тан +25 °С-қа дейін, тікелей күн сәулесінен алыс, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

КӨЛЕМІ: 50 ml.



VITAMIN C BRIGHTENING SERUM

БІРКЕЛКІ, ЖАРҚЫРАҒАН ТЕРІ РЕҢІНЕ АРНАЛҒАН САРЫСУ

Тері реңін тегістейді

Жарқырауды күшейтеді

Ылғалдандырады

Тері тосқауылын нығайтады

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: беттің өңсіз реңі, пигментация, біркелкі емес реңк, сусыздану, әлсіреген қорғаныш тосқауылы, серпімділіктің төмендеуі.

ӘСЕРІ: тері тегіс, серпімді, жарқыраған әрі ылғалданған болып, реңі біркелкіленеді.

ҚҰРАМЫ: Water, Glycereth-26, Glycerin, dexpanthenol, Tremella (ice mushroom) extract, methylpropanediol, Polyglycerin-3, Diethoxyethyl succinate, Betaine, glutathione, Canola oil, Sunflower seed oil, Meadowfoam Seed Oil, Argan Kernel Oil, Trehalose, Lemon Balm Leaf Extract, Tremella polysaccharides, Biosaccharide Gum-1, Madecassoside, Asiaticoside, Sodium hyaluronate, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Hydrolyzed sodium hyaluronate, Ceramide NP, Asiatic Acid, Madecassic Acid, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Hydroxypropyltrimonium hyaluronate, Sodium hyaluronate crosspolymer, Sodium Acetylated Hyaluronate, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, Dimethylsilanol hyaluronate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Ceramide EOP, Polyglyceryl-10 stearate, Caprylyl Glycol, Caprylhydroxamic acid, Butylene Glycol, Sodium Polyacrylate, Polysorbate 60, Propanediol, Xanthan Gum, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Allantoin, 1,2-Hexanediol, Ethylhexylglycerin, Sorbitan Isostearate, Pentylene Glycol, Disodium EDTA, Fragrance.

БЕЛСЕНДІ ҚҰРАМДАСТАРЫ:

1. С дәрумені (Sodium Ascorbyl Phosphate, Ascorbic Acid) мен глутатион - пигментацияны ағартатын, реңді тегістеуге көмектесетін және сау жарқырау беретін қуатты үйлесім.
2. Ниацинамид қорғаныш тосқауылының қызметін нығайтып, тері құрылымын жақсартады.
3. Гиалурон қышқылының жеті түрі эпидермистің әртүрлі қабатына еніп, көп деңгейлі терең ылғалдандыруды қамтамасыз етеді.
4. Керамид кешені (NP, NS, AP, AS, EOP) мен тремелла сығындысы қоректендіреді, қорғаныш липидтік тосқауылын тиімді қалпына келтіріп нығайтады.
5. Азиялық центелла (Madecassoside, Asiaticoside, Asiatic Acid, Madecassic Acid) қарқынды тыныштандырады, сауықтырады және қызаруды басады.

6. Өсу факторлары кешені (sh-Polypeptide / Oligopeptide) жасушалық жаңаруды іске қосып, терінің өз коллагенін өндіруін ынталандырады және лифтинг әсерін береді.
7. Дәрумендер кешені (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) қоректендіреді, жасушалардағы зат алмасуды жақсартып, теріге сау жарқырауды қайтарады.
8. Декспантенол зақымдалған эпидермисті қарқынды сауықтырады, тыныштандырады және қалпына келтіреді.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: глутатион, С дәрумені, ниацинамид және азиялық центелла қосылған белсенді кешен тері реңін тегістеп, жарқырау береді. Гиалурон қышқылының жеті түрі көп деңгейлі терең ылғалдандырады. Керамидтер мен тремелла сығындысы қорғаныш тосқауылын нығайтып қоректендіреді, теріні тегіс, серпімді әрі жарқыраған етеді.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Бетке аз мөлшерде сарысу жағыңыз.
2. Толық сіңгенше теріде қалдырыңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ:
1. Қолданар алдында аллергия сынағын жасау ұсынылады.
2. Құралды терінің зақымдалған жерлеріне жақпаңыз.
3. Көзге тікелей тигізбеңіз. Тисе, жылы сумен шайыңыз.

САҚТАУ: жабық қаптамада +5 °С-тан +25 °С-қа дейін, тікелей күн сәулесінен алыс, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

КӨЛЕМІ: 30 ml.



PETIT RA
TEPI KYTIMI



ANTI-AGING CARE MTS SERUM

PETIT RA ЖАСАРТАТЫН ТЕРІ КҮТІМІ

Қартаюды баяулатады

Қарқынды қоректендіреді және ылғалдандырады

Қалпына келуді қолдайды

Серпімділікті жақсартады

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: бет терісінің қартаю белгілері, құрғақтық, ылғал мен серпімділіктің жоғалуы.

ӘСЕРІ: қартаюды баяулатады, қарқынды қоректендіріп ылғалдандырады, қалпына келуге ықпал етеді, серпімділік пен созылғыштықты арттырады.

ҚҰРАМЫ: Water, Propanediol, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Hydrolyzed Collagen, Palmitoyl Tripeptide-5, Acetyl Hexapeptide-8, Hexapeptide-10, Centella Asiatica Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Birch bud extract, Hazelnut Bud Extract, Olive Bud Extract, Walnut leaf extract, Sodium hyaluronate, Glycerin, Allantoin, Adenosine, Caprylyl Glycol, Disodium EDTA.

БЕЛСЕНДІ ҚҰРАМДАСТАРЫ:
1. Гидролизденген коллаген теріні ылғалмен қанықтырып, серпімділігі мен созылғыштығын арттырады.
2. AcePep-6TM (ацетилгексапептид-8) Botox (Botoxin) орнына тиімді балама деп танылған, әжімдермен күреседі. Сондай-ақ бұлшықет жиырылуын әлсіретіп, әжім іздерін азайтады.
3. Palmitoyl tripeptide-5 коллаген синтезін іске қосып, тері құрылымын қалпына келтіруге көмектеседі.
4. Hexapeptide-10 - терінің pH теңгерімін қалпына келтіруге қажетті құрамдас, серпімділігін, тығыздығы мен тонусын арттырады.
5. Аденозин қабынуға және әжімге қарсы әсер етеді, коллаген синтезін ынталандырады, тері серпімділігі мен өткізгіштігін арттырады.
6. Азиялық центелла қалпына келтіретін әсерімен белгілі. Жапырағы мен сабағындағы мадекассосид тітіркену, қызару және зақымдарды кетіруге көмектеседі.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: сарысудың бірегей құрамында қартаю белгілеріне қарсы жоғары тиімді заттар бар. Пептидтер, коллаген және гиалурон қышқылының ерекше кешені тері кемшіліктерімен күресуге бағытталған. Әжімдерді азайтады, айқын лифтинг береді, бет реңін жақсартып, зақымдарды қалпына келтіреді және жалпы тері күйіне оң әсер етеді.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:

Бірінші тәсіл: бет терісін мұқият тазалап, аз мөлшерде сарысуды жеңіл шапалақтау қозғалыстарымен жағыңыз. Толық сіңгенше қалдырыңыз.

ЕКІНШІ ТӘСІЛ: бет терісін мұқият тазалап, құрғақ теріге қалыпты мөлшерде жағыңыз. WAU бет массажерімен процедура жасап, сарысуды толық сіңгенше қалдырыңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ:
1. Аллергиялық реакцияның алдын алу үшін қолданар алдында шынтақ бүгілісінің ішкі жағында сынау ұсынылады. Тітіркену немесе бөртпе болса, қолдануды тоқтатыңыз.
2. Құралды терінің зақымдалған жерлеріне жақпаңыз.
3. Көзге тікелей тигізбеңіз. Тисе, жылы сумен шайыңыз.
4. Қолданғаннан кейін күн сәулесінен қорғау үшін SPF кремін жағу ұсынылады.

САҚТАУ: жабық қаптамада +5 °C-тан +25 °C-қа дейін, тікелей күн сәулесінен алыс, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

КӨЛЕМІ: 50 ml.



ANTI-AGING CARE STEM CELL

РЕТІТ RA БАҒАНАЛЫ ЖАСУШАЛАРЫ БАР ЖАСАРТАТЫН КҮТІМ КРЕМІ

Қартаюды баяулатады

Қарқынды қоректендіреді және ылғалдандырады

Қалпына келуді қолдайды

Серпімділікті жақсартады

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: терінің қартаю белгілері, серпімділіктің төмендеуі.

ӘСЕРІ: қартаюды баяулатады, қарқынды қоректендіріп ылғалдандырады, қалпына келуге ықпал етеді, серпімділік пен созылғыштықты арттырады.

ҚҰРАМЫ: Water, Dipropylene Glycol, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Niacinamide, Human Stem Cell Conditioned Medium (2.0%), Cetearyl Alcohol, Stearic acid, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Polyglyceryl-3-methylglucose distearate, Meadowfoam Seed Oil, glyceryl stearate, Jojoba Seed Oil, Hydrogenated lecithin, Galactomyces Ferment Filtrate, Hydrolyzed Collagen, Suaeda Japonica Leaf/Root/Stem Extract, Butylene Glycol, Poncirus Trifoliata Fruit Extract, Mistletoe extract, Psoralea Corylifolia Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Shea Butter, Paper Mulberry Extract, Japanese Coptis Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Hydroxyethylcellulose, Sodium hyaluronate, Rheum Palmatum Root Extract, Propanediol, Phellodendron Amurense Bark Extract, Dipotassium Glycyrrhizate, Allantoin, Sodium hyaluronate crosspolymer, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Schizonepeta Tenuifolia Extract, Saposhnikovia Divaricata Root Extract, Platycodon Grandiflorus Root Extract, Gardenia Florida Fruit Extract, Forsythia Suspensa Fruit Extract, Celery rhizome extract, Atractylodes Japonica Rhizome Extract, Canadian mint extract, glycine, serine, Glutamic acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Cocoa bean extract, aspartic acid, leucine, Alanine, lysine, Arginine, Caprylhydroxamic acid, tyrosine, phenylalanine, valine, threonine, proline, isoleucine, histidine, methionine, cysteine, Hyaluronic Acid, Palmitoyl Tripeptide-5, Vinyl Dimethicone, Adenosine, Tromethamine, carbomer, Disodium EDTA, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Ethylhexylglycerin.

БЕЛСЕНДІ ҚҰРАМДАСТАРЫ:

1. Бағаналы жасушалар өсірілген орта 2% - әжімдерді тегістейді.
2. Ниацинамид терінің қорғаныш қызметін қалпына келтіреді.
3. Каприл қышқылының бактериостатикалық қасиеті бар.
4. Гиалурон қышқылы ылғалды жинап, буланууына жол бермейді.
5. Омела сығындысының антисептикалық қасиеті бар.
6. Galactomyces (galactomyces ferment filtrate) жақсы қабыршақтандырып ылғалдандырады, ал ұзақ қолданғанда тері құрылымын жақсартады,

серпімділігі мен тонусын арттырады.
7. Acetyl Hexapeptide-8 (ацетилгексапептид-8) - теріге оңай енетін төмен молекулалы пептид. Адреналин мен норадреналин бөлінуін бақылайды, әжімдерді тегістеп, тері серпімділігін арттыруға көмектеседі.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: көпфункциялы крем-сарысуда бағаналы жасушалар және әжімді тегістеп, теріні тартып, тегіс әрі жарқыраған ететін басқа 56 белсенді құрамдас бар. Кремде IRB мақұлдаған, 100% сұйылтылмаған адам бағаналы жасушаларын өсіру ортасы қолданылады. Ол зақымдалған тіндердің қалпына келуі мен тері серпімділігінде маңызды рөл атқарады.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Крем-сарысуды жағар алдында бет терісін мұқият тазалаңыз.
2. Қажетті мөлшерде жағып, толық сіңгенше саусақ ұштарымен уқалаңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ:
1. Аллергиялық реакцияның алдын алу үшін қолданар алдында шынтақ бүгілісінің ішкі жағында сынау ұсынылады. Тітіркену немесе бөртпе болса, қолдануды тоқтатыңыз.
2. Құралды терінің зақымдалған жерлеріне жақпаңыз.
3. Көзге тікелей тигізбеңіз. Тисе, жылы сумен шайыңыз.
4. Қолданғаннан кейін күн сәулесінен қорғау үшін SPF кремін жағу ұсынылады.

САҚТАУ: жабық қаптамада +5 °С-тан +25 °С-қа дейін, тікелей күн сәулесінен алыс, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

КӨЛЕМІ: 40 g.



LIPO JEUNE

PETIT RA КӨЗ АСТЫНДАҒЫ ҚАРА ШЕҢБЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН КРЕМ

Бағаналы жасушалардың зат алмасуын ынталандырады

Әжімдерді тегістейді

Көз айналасындағы терінің күйі мен тонусын жақсартады

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: көз астындағы қара шеңберлер, қартаюдың алғашқы белгілері, әжімдер.

ӘСЕРІ: көз айналасындағы тері тонусын жақсартады, бағаналы жасушалардың зат алмасуын ынталандырып, әжімдерді тегістеуге көмектеседі, зақымнан қорғайды.

ҚҰРАМЫ: Water, Glycerin, Niacinamide, Cetearyl Alcohol, Glycereth-26, Caprylic/caprine triglyceride, Diisostearyl Malate, Butylene Glycol, Cetearyl Olivate, glyceryl stearate, Meadowfoam Seed Oil, Vinyl Dimethicone, Sorbitan Olivate, Cetyl Ethylhexanoate, Betaine, Tri-C14-15 Alkyl Citrate, Cetearyl Glucoside, Shea Butter, Phytosteryl/octyldodecyl lauroyl glutamate, Extract of Japanese Camellia Flowers, Japanese Camellia Seed Extract, bisabolol, Acetyl glucosamine, Japanese Camellia Seed Oil, Broussonetia Kazinoki Root Extract, White mulberry bark extract, Apple Fruit Extract, Andrographis Paniculata Extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Centella Asiatica Extract, Yuzu Peel Extract, Hydrolyzed Collagen, Citrus Unshiu Peel Extract, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Bitter Orange Peel Extract, Galactoarabinan, Matsutake mushroom extract, Alpine Edelweiss Extract, Acetyl Hexapeptide-8, Sodium hyaluronate, tocopherol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Arginine, Polyisobutene, Xanthan Gum, PEG-7 Trimethylolpropane Coconut Ether, Sorbitan Isostearate, Adenosine, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol, Disodium EDTA.

БЕЛСЕНДІ ҚҰРАМДАСТАРЫ:

1. Ниацинамид - В3 дәруменінің тамаша ағартатын әсері бар түрі. Тері реңін жақсартады, қабынудың алдын алады және тосқауылын қалпына келтіреді.
2. Бисаболол меланиннің бірігу процесін бұғаттап, ерте кезеңде түзілуін басады.
3. WhiteTen™ (ниацинамид, ацетилглюкозамин, мадекассосид, ақ тұт қабығының сығындысы, Malus pumila жемісінің сығындысы, мацутакэ саңырауқұлағының сығындысы, Oxalis triangularis сығындысы, Camellia sinensis жапырағының сығындысы, Broussonetia kazinoki тамырының сығындысы, Camellia japonica гүлінің сығындысы) - 10 өсімдік сығындысына негізделген бірегей ағарту кешені. Меланоциттердің кератиноциттерге өтуін бұғаттап, теріні ағартады және жарықтандырады.
4. Эдельвейс фитобағаналы жасушалары: эдельвейс бағаналы жасушаларының өсіріндісі тотығу күйзелісін басатын антиоксиданттарға бай.

Өсірінді тітіркенуді азайтып, тері тіндерін қалпына келтіруде тиімді.
5. LotuStem™ (бутиленгликоль, су, Andrographis paniculata сығындысы) жасуша бөлінуін белсендіреді.
6. AcePep-6TM (ацетилгексапептид-8) Botox (Botoxin) орнына тиімді балама деп танылған, әжімдермен күреседі. Сондай-ақ бұлшықет жиырылуын әлсіретіп, әжім іздерін азайтады.
7. Гидролизденген коллаген теріні ылғалмен қамтамасыз етіп, серпімділігі мен тығыздығын арттырады.
8. Eosidin® (пропандиол, су, уншиу мандарині қабығының сығындысы) - цитрустағы антиоксиданттар мен флавоноидтардың арқасында қабынуға қарсы әсер ететін бірегей кешен.
9. Аденозин қабынуға қарсы және жасартатын әсер етеді, коллаген синтезіне ықпал етіп, тері серпімділігін жақсартады.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: бірегей құрамы көз айналасын ағартып сергітеді және әжімдерді тегістейді. Эдельвейс өсіріндісінің сығындысы мен патенттелген LotuStem™ бағаналы жасушалардың зат алмасуын ынталандырып, көз айналасындағы әжімдерді тегістеуге көмектеседі. FDA мақұлдаған, 10 өсімдік сығындысы бар White Ten формуласы көз айналасындағы тері реңін жақсартады.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Крем жағар алдында бет терісін мұқият тазалаңыз.
2. Қажетті мөлшерде жағып, толық сіңгенше саусақ ұштарымен уқалаңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ:
1. Аллергиялық реакцияның алдын алу үшін қолданар алдында шынтақ бүгілісінің ішкі жағында сынау ұсынылады. Тітіркену немесе бөртпе болса, қолдануды тоқтатыңыз.
2. Құралды терінің зақымдалған жерлеріне жақпаңыз.
3. Көзге тікелей тигізбеңіз. Тисе, жылы сумен шайыңыз.
4. Қолданғаннан кейін күн сәулесінен қорғау үшін SPF кремін жағу ұсынылады.

САҚТАУ: жабық қаптамада +5 °C-тан +25 °C-қа дейін, тікелей күн сәулесінен алыс, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

КӨЛЕМІ: 50 ml.



O2 DETOX CLEANSING GEL

РЕТІТ RA БЕТ ТЕРІСІН ТАЗАЛАУҒА АРНАЛҒАН ОТТЕГІ ГЕЛІ

Тазартады | Тері тесіктерін тарылтады | Тыныштандырады | Серпімділікті жақсартады

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: кеңейген тесіктер, тері майының көп бөлінуі.

ӘСЕРІ: тазартады, тесіктерді тарылтады, серпімділікті арттырады, тыныштандырады.

ҚҰРАМЫ: Water, Glycerin, Acrylates Copolymer, Methyl perfluoroisobutyl ether, Cocamidopropyl Betaine, 1,2-Hexanediol, Cocamide Dea, Ammonium Lauryl Sulfate, Disodium Cocoamphodiacetate, PEG-7 Glyceryl cocoate, Sodium chloride, Xanthan Gum, Polyhydroxystearic acid, isononyl isononanoate, Ethylhexyl Isononanoate, Potassium Cocoyl Glycinate, Potassium hydroxide, Cocamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate Sodium, Disodium EDTA, Sodium benzoate, Butylene Glycol, Apple extract, hexylene glycol, Chamomile Flower Extract, Lemon extract, Orange extract, Yellow Gentian Root Extract, Wormwood extract, Mountain arnica extract, Yarrow extract, Fragrance, Linalool, Limonene.

БЕЛСЕНДІ ҚҰРАМДАСТАРЫ:
1. Акрилат сополимері теріде жұқа қабат түзіп, қоректік заттардың жабысуын/өтуін арттырады және ұзақ әсер береді. Жуынғаннан кейін теріні ылғалдандырып, жұмсақ қаптайды.
2. Кокамидопропилбетаин жұмсақ көбік түзеді және тазартады.
3. Disodium Cocoamphodiacetate - сезімтал теріге жарайтын, тітіркендірмейтін жұмсақ тазартқыш құрамдас.
4. Лимон жемісінің сығындысы ылғалдың буланууын бұғаттап, ылғалдандыруға көмектеседі. Тыныштандырады, өнсіздіктің алдын алып, реңді жақсартады.
5. Үй алмасының жеміс сығындысы теріні тотығудан қорғап, реңін жарқыратады.
6. Тәтті апельсин жемісінің сығындысы қартаюдың негізгі себебі - бос радикалдардың тотығу әсерінен теріні қорғауға көмектеседі.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: оттегімен әрекеттескенде гель көбік түзіп, теріге жұмсақ әсер етеді. Кірді тиімді кетіріп, макияж бен артық тері майын тазалауға көмектеседі, тесіктерді тарылтады. Барлық тері түріне жарайды, кез келген жастағы әйелдерге ұсынылады.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Құрғақ бет терісіне аз мөлшерде жағып, Т-аймаққа назар аударыңыз.
2. Бірнеше секундта оттегі көпіршіктері пайда болып, 1 минуттан кейін ең көп мөлшерге жетеді. Қоюырақ көбік үшін саусақ ұштарымен немесе жуыну щеткасымен уқалаңыз.

3. Сумен мұқият жуыңыз. Әдеттегі күндізгі немесе түнгі күтімге көшіңіз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ:
1. Аллергиялық реакцияның алдын алу үшін қолданар алдында шынтақ бүгілісінің ішкі жағында сынау ұсынылады. Тітіркену немесе бөртпе болса, қолдануды тоқтатыңыз.
2. Құралды терінің зақымдалған жерлеріне жақпаңыз.
3. Көзге тікелей тигізбеңіз. Тисе, жылы сумен шайыңыз.
4. Қолданғаннан кейін күн сәулесінен қорғау үшін SPF кремін жағу ұсынылады.

САҚТАУ: жабық қаптамада +5 °С-тан +25 °С-қа дейін, тікелей күн сәулесінен алыс, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

КӨЛЕМІ: 120 ml.



PAD CYPRESS TONIC

РЕТІТ RA БЕТКЕ АРНАЛҒАН ТЫНЫШТАНДЫРАТЫН КОСМЕТИКАЛЫҚ ДИСКІЛЕРІ

Тазартады | Сергітеді | Тері тесіктерін тарылтады | Тыныштандырады | Ылғалдандырады

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: кеңейген тесіктер, артық тері майы, құрғақтық пен тартылу сезімі.

ӘСЕРІ: тазалау, сергіту, тесіктерді тарылту, тыныштандыру, ылғалдандыру.

ҚҰРАМЫ: Hinoki Cypress Water, Glycerin, 1,2-Hexanediol, 1,3-Butylene Glycol, Aloe vera leaf extract, Laminaria Japonica Extract, Japanese Dioscorea Root Extract, Ulmus Davidiana Root Extract, Manchurian Violet Flower Extract, Hinoki Cypress Oil, Disodium EDTA, Water, Centella Asiatica Extract, Japanese Knotweed Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Licorice Root Extract, Chamomile Flower Extract, Rosemary Leaf Extract.

БЕЛСЕНДІ ҚҰРАМДАСТАРЫ:

1. Алоэ вера жапырағының сығындысы дерманы жұмсартып ылғалдандырады, құрылымын қалпына келтіреді. Қабыршақтану мен құрғақтықты кетіреді, күн немесе басқа тітіркендіргіштер зақымдаған теріні қалпына келтіреді.
2. Жапон диоскореясы тамырының сығындысы терідегі қауіпті элементтерге қарсы әсер етіп, мәселелі тері зақымын азайтады.
3. Ulmus davidiana тамырының сығындысы сезімтал теріні тыныштандырып, реңін тегістейді.
4. Жабайы ямс тамырының сығындысы антиоксиданттық және қабынуға қарсы қасиеттерге ие, безеу мен қабынудың кез келген түрімен күресуге көмектеседі, теріні жасартып, тонусын арттырады.
5. Күлгін гүл сығындысы күйзеліс пен сыртқы ортаның агрессивті әсерінен қорғайды, тыныштандырады, жарқырау мен серпімділік береді. Қабынған, мәселелі және қабыршақтанған теріге жарайды.
6. Мия тамырының сығындысы теріні ағартып, ерте қартаюға себеп болатын бос радикалдармен күреседі. Қабынуға қарсы және антисептикалық қасиеті бар. Майлы теріге өте қолайлы.
7. Дәріханалық түймедақ гүлінің сығындысы сезімтал, қызаруға бейім теріні тиімді тыныштандырып жұмсартады. NF-KB ақуызының белсенуін басып, қабыну процестерін реттейді.
8. Азиялық центелла сығындысы қалпына келтіретін әсерімен белгілі. Жапырағы мен сабағындағы мадекассосид

терінің тітіркенуін, қызаруы мен зақымдарын кетіруге көмектеседі.
9. HerbExTM Rosemary Extract (розмарин жапырағының сығындысы, су, 1.3-бутиленгликоль) теріні қартаюдың негізгі себебі - бос радикалдардан қорғайды.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: кипарис негізіндегі қоректік тоник сіңірілген бет дискілері тазартады, тыныштандырады, ылғалдандырады, косметика қалдықтары мен кірді ұқыпты әрі жұмсақ кетіреді. 100% мақта материалы жақсы жанасуды қамтамасыз етеді. Жұмсақ мата теріге тығыз тиіп, тониктің тиімділігін арттырады. Алоэ мен азиялық центелла жасушалардың қалпына келуін жеделдетеді, тітіркенуді басады, ультракүлгіннен кейін тыныштандырады, сондай-ақ суық пен жел қаққан бетке көмектеседі. Барлық тері түріне жарайды, кез келген жастағы әйелдерге ұсынылады.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:

Бірінші тәсіл: дискіні құтыдан алып, тазалау үшін бет терісін сүртіңіз.

ЕКІНШІ ТӘСІЛ: дискіні құтыдан алып, қоректік заттар тиімдірек сіңуі үшін Sonic технологиясы бар WAU бет массажерімен қолданыңыз.

Үшінші тәсіл: аптасына 1-2 рет маска ретінде қолданыңыз. Дискілерді беттің қажетті жеріне 5-10 минут қойып, содан кейін алыңыз және құрал қалдығын теріге таратыңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ:

1. Аллергиялық реакцияның алдын алу үшін қолданар алдында шынтақ бүгілісінің ішкі жағында сынау ұсынылады.
2. Құралды терінің зақымдалған жерлеріне жақпаңыз.
3. Көзге тікелей тигізбеңіз. Тисе, жылы сумен шайыңыз.
4. Қолданғаннан кейін күн сәулесінен қорғау үшін SPF кремін жағу ұсынылады.

САҚТАУ: жабық қаптамада +5 °C-тан +25 °C-қа дейін, тікелей күн сәулесінен алыс, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

КӨЛЕМІ: 200 ml (70 дана).



PAD TIGHTENING PEPTIDE ESSENCE

PETIT RA БЕТКЕ АРНАЛҒАН ЛИФТИНГ ДИСКІЛЕРІ

Тыныштандырады

Тері серпімділігін жақсартады

Лифтинг әсері

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: құрғақ тері, қартаюдың алғашқы белгілері.

ӘСЕРІ: тыныштандырады, тері серпімділігін арттырады.

ҚҰРАМЫ: Ginseng Root Extract, Citrus Unshiu Peel Extract, Butylene Glycol, Mandarin Unshiu Fruit Extract, 1,2-Hexanediol, Water, Niacinamide, Angelica Gigas Extract, Grapefruit fruit extract, Lemon fruit extract, Glycerin, Dipropylene Glycol, Betaine, Curly Sparassis Extract, dexpanthenol, Sophora Flavescens Root Extract, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer, White mistletoe extract, Suaeda Japonica Leaf/Root/Stem Extract Ferment Filtrate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Adenosine, Andrographis Paniculata Extract, Disodium EDTA, Sodium Polystyrene Sulfonate, Sodium hyaluronate, Citric Acid, Sodium silicate, Ethylhexylglycerin, Tripeptide-10 Citrulline, Tripeptide-1.

БЕЛСЕНДІ ҚҰРАМДАСТАРЫ:

1. Уншиу мандарині мен грейпфрут жемістерінің сығындылары тыныштандырады, серпімділікті арттырады, қабынуға қарсы әсер етеді, пигментациямен күресіп ағартады.
2. Sparassis crispa сығындысы ультракүлгіннің теріс әсеріне қарсы тұрады, қарқынды ылғалдандырады, қорғаныш қызметін нығайтады, тіндердің сезімталдығын төмендетеді және тері ылғалын сақтауға көмектеседі.
3. Sophora flavescens тамырының сығындысы, Suaeda japonica жапырағы/тамыры/сабағы сығындысының ферменттелген сүзіндісі, Camellia sinensis жапырағы және лимон жемісінің сығындылары теріні тыныштандырып, табиғи тосқауылын нығайтады.
4. Andrographis paniculata сығындысы тері серпімділігі мен коллаген синтезін қолдайды.
5. Ақ омела сығындысы теріде түзілген белсенді оттегіні кетіреді, қартаюдың алдын алып, баяулатады және тері тосқауылын нығайтады.
6. 2 түрлі пептид (трипептид-10 цитруллин, трипептид-1) теріні серпімді етеді.
7. Аденозин қабынуға және әжімге қарсы әсер етеді, коллаген синтезін ынталандырады, тері серпімділігі мен өткізгіштігін арттырады.

8. Ниацинамид - В3 дәруменінің тамаша ағартатын әсері бар түрі. Тері реңін жақсартады, қабынудың алдын алады және тосқауылын қалпына келтіреді.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: пептидтік кешен негізіндегі лифтинг тонигі сіңірілген бет дискілері пигментациямен және жасқа байланысты өзгерістермен күреседі. 100% мақта материалы жақсы жанасуды қамтамасыз етеді. Жұмсақ мата теріге тығыз тиіп, тониктің тиімділігін арттырады. Женьшень тамырының сығындысы әжімді тегістеуге көмектеседі, ультракүлгіннің теріс әсеріне қарсы тұрып, қабынуды басады. Барлық тері түріне жарайды, кез келген жастағы әйелдерге ұсынылады.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:

Бірінші тәсіл: дискіні құтыдан алып, тазалау үшін бет терісін сүртіңіз.

ЕКІНШІ ТӘСІЛ: дискіні құтыдан алып, қоректік заттар тиімдірек сіңуі үшін Sonic технологиясы бар WAU бет массажерімен қолданыңыз.

Үшінші тәсіл: аптасына 1-2 рет маска ретінде қолданыңыз. Дискілерді беттің қажетті жеріне 10-20 минут қойып, содан кейін алыңыз және құрал қалдығын теріге таратыңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ:
1. Аллергиялық реакцияның алдын алу үшін қолданар алдында шынтақ бүгілісінің ішкі жағында сынау ұсынылады.
2. Құралды терінің зақымдалған жерлеріне жақпаңыз.
3. Көзге тікелей тигізбеңіз. Тисе, жылы сумен шайыңыз.
4. Қолданғаннан кейін күн сәулесінен қорғау үшін SPF кремін жағу ұсынылады.

САҚТАУ: жабық қаптамада +5 °С-тан +25 °С-қа дейін, тікелей күн сәулесінен алыс, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

КӨЛЕМІ: 200 ml (70 дана).



SOS BODY FIT

PETIT RA ЦЕЛЛЮЛИТКЕ ҚАРСЫ КРЕМІ

Целлюлитпен күреседі

Зат алмасу процестерін белсендіреді

Серпімділікті қалпына келтіреді

Серпімділікті жақсартады

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: целлюлит, дене терісінің серпімділігі мен созылғыштығының төмендеуі, құрғақтық пен тартылу сезімі.

ӘСЕРІ: целлюлитті кетіреді, зат алмасуды жеделдетеді, серпімділікті қалпына келтіріп, созылғыштықты арттырады.

ҚҰРАМЫ: Water, methylpropanediol, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Betaine, Arginine, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Vanillyl Butyl Ether, carbomer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Polyisobutene, Olive oil, Sunflower seed oil, Sorbitan Isostearate, Polysorbate 60, PEG-7 Trimethylolpropane Coconut Ether, Butylene Glycol, Sorbitan Laurate, Lauroyl Proline, Hydrogenated phosphatidylcholine, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Lactobacillus/Soybean Ferment Extract, White mistletoe leaf extract, Imperata Cylindrica Root Extract, 1,2-Hexanediol, Sesame seed extract, Purslane Extract, Rice extract, Lavender extract, Witch Hazel Juice, Soybean seed extract, Chamomile Flower Extract, Tea leaf extract, Algae Extract.

БЕЛСЕНДІ ҚҰРАМДАСТАРЫ:

1. Лактобактериялар/сояның ферменттелген сығындысы тамаша ылғалдандырады.
2. Күріш сығындысындағы антоциан, С дәрумені және β-каротин күшті антиоксиданттық қызмет атқарады. Күріш қауызының майы ылғалдандырып, бактериялармен күреседі.
3. Жабайы соя тұқымының сығындысы тері жасушаларының қалпына келуіне көмектеседі, антиоксидант ретінде жұмыс істейді және жасушалық зат алмасуды жақсартады.
4. Үнді күнжітінің тұқым сығындысында кәдімгі күнжітке қарағанда селен, токоферол және басқа антиоксиданттар көбірек, сондықтан әжіммен күресіп, тері серпімділігін нығайтады.
5. Біржылдық күнбағыс тұқымының майы қабыну мен тітіркенуді тыныштандырады.
6. Зәйтүн жемісінің майы қартаюды баяулатып, ультракүлгіннен қорғайды. Антиоксиданттық әсер береді, жұмсартып ылғалдандырады және терінің иммундық қызметін күшейтеді.
7. HerbExTM Green tea Extract (бутиленгликоль, су, көк шай - қытай камелиясы жапырағының сығындысы) антиоксиданттық, қабынуға қарсы әсер береді және әжімдермен күреседі.

8. HerbExTM Lavender Extract (су, бутиленгликоль, жіңішке жапырақты лаванда сығындысы) жасушалардың өмірлік циклін белсендіріп, жаңа тері қабатына тезірек өтуіне көмектеседі және тыныштандырады. Қабыну процестерімен күресіп, қабыну санын азайтады.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: бірегей табиғи құрамдастарға негізделген целлюлитке қарсы мүсіндейтін крем зат алмасуды белсендіреді, серпімділік пен созылғыштықты арттыруға көмектеседі, лимфа ағынын жақсартып, терең ылғалдандырады.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:

Бірінші тәсіл: массаж жасайтын дене аймақтарына скраб қолданып душ қабылдаңыз. Мәселелі жерлерге крем жағып, EMS/RF функциясы бар дене массажерімен уқалаңыз. LED терапиясы бар массажбен аяқтаңыз. Крем қалдығын қолмен таратып, толық сіңгенше қалдырыңыз.

Екінші тәсіл: денеге жағып, айналмалы қозғалыстармен таратыңыз. Теріңізде айқын жылу сезіледі. Мәселелі аймақтарды (мысалы, сан, іш, арқа) шапалақтау қозғалыстарымен өтіңіз. Түзету қажет жерлерге қарай жылжып, теріні қолмен қысып, қан айналымын ынталандырыңыз. Крем қалдығын толық сіңгенше қалдырыңыз. Қолдағы қалдықты сумен мұқият жуыңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ:
1. Аллергиялық реакцияның алдын алу үшін қолданар алдында шынтақ бүгілісінің ішкі жағында сынау ұсынылады. Тітіркену немесе бөртпе болса, қолдануды тоқтатыңыз.
2. Жүктілік кезінде немесе сояға аллергия болса, кремді қолдануға тыйым салынады.
3. Құралды терінің зақымдалған жерлеріне жақпаңыз.
4. Көзге тікелей тигізбеңіз. Тисе, жылы сумен шайыңыз.
5. Қолданғаннан кейін күн сәулесінен қорғау үшін SPF кремін жағу ұсынылады.

САҚТАУ: жабық қаптамада +5 °C-тан +25 °C-қа дейін, тікелей күн сәулесінен алыс, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

КӨЛЕМІ: 200 ml.



SPICULE EYE CREAM

РЕТІТ RA КӨЗ АЙНАЛАСЫНДАҒЫ ТЕРІГЕ АРНАЛҒАН КРЕМІ

Қартаюды баяулатады

Микроайналымды жақсартады

Антиоксиданттық әсер

Әжімдерді тегістейді

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: қартаю белгілері, көз астындағы қара шеңберлер, әжімдер.

ӘСЕРІ: қартаюды баяулатады, микроайналымды жақсартады, антиоксиданттық әсер береді, қалпына келуге ықпал етеді, ағартады және әжімді тегістейді.

ҚҰРАМЫ: Water, Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Cetearyl Alcohol, Sponge Spicules, Polyglyceryl-3 Methylglucose distearate, Macadamia Ternifolia Fruit Oil, Diisostearyl Malate, Hydrogenated polydecene, Hydrogenated C6-14 Olefin Polymers, Glyceryl Stearate, Propanediol, Trehalose, Beeswax, Shea Butter, Vinyl Dimethicone, Human Stem Cell Conditioned Medium, Sodium DNA, Hydrolyzed Collagen, Hibiscus Sabdariffa Flower Extract, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Sodium hyaluronate, Ceramide NP, Citrus Unshiu Peel Extract, Hydrogenated lecithin, Andrographis Paniculata Extract, Madecassoside, Asiaticoside, sh-Oligopeptide-1, sh-Polypeptide-94, Dipeptide-35, sh-Polypeptide-94, sh-Polypeptide-95, Asiatic Acid, Madecassic Acid, Acetyl Hexapeptide-8, Cyanocobalamin, Adenosine, Palmitic acid, Stearic acid, Myristic acid, Arginine, carbomer, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid.

БЕЛСЕНДІ ҚҰРАМДАСТАРЫ:
1. Ниацинамид - B3 дәруменінің тамаша ағартатын әсері бар түрі. Кеңейген тесіктерді аз байқалатын етеді, ылғалдандырады және пигменттік дақтардың алдын алады.
2. STeMiN™ - адам бағаналы жасушаларымен кондицияланған орта. Құрамында 50-ден астам өсу факторы бар бағаналы жасуша майлары арқылы терінің жасаруын күшейтеді.
3. PDRN (полидезоксирибонуклеотидтер) - жасқа байланысты тері жасушаларының зақымдалған DNA-сын қалпына келтіруге арналған құрылыс бөлшектері. Теріге жаққанда тесіктерді тарылтуға, әжімді тегістеуге және қалпына келуге көмектеседі.
4. Гидролизденген коллаген теріні ылғалмен қамтамасыз етіп, серпімділігі мен тығыздығын арттырады.
5. HerbExTM Hyaluron (бутиленгликоль, су, sodium hyaluronate crosspolymer): гиалурон қышқылы өзінен 1000 есе үлкен су молекулалары көлемін ұстай алады, сондықтан қорғау, ылғалдандыру, майлау және нығайтуда маңызды рөл атқарады.

6. Eosidin® (пропандиол, су, уншиу мандарині қабығының сығындысы) - цитрустағы антиоксиданттар мен флавоноидтардың арқасында қабынуға қарсы әсер ететін бірегей кешен.
7. LotuStem™ (бутиленгликоль, су, Andrographis paniculata сығындысы) жасуша бөлінуін белсендіреді.
8. Super Centella (Madecassoside, Asiaticoside) зақым аймағында жасушалардың жылдам көбеюі мен коллаген синтезіне ықпал етеді. Тітіркену мен қабынуға қарсы жоғары тиімді, жасқа байланысты терінің қалпына келуін қолдайды.
9. SUPER EGF (EGF - эпидермалық өсу факторы, sh-oligopeptide-1): эпидермалық өсу факторы бар пептидтер коллаген қамтитын фибробласттардың көбеюіне көмектесіп, теріні қоректендіреді.
10. AcePep-6TM (ацетилгексапептид-8) Botox (Botoxin) орнына тиімді балама деп танылған, әжімдермен күреседі. Сондай-ақ бұлшықет жиырылуын әлсіретіп, әжім іздерін азайтады.
11. Аденозин қабыну мен әжімге қарсы әсер етеді, коллаген синтезін ынталандырып, тері серпімділігі мен өткізгіштігін арттырады.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: жасартатын көз кремінде тұщы су губкаларының табиғи микроинелері (спикулалар) бар. Олар теріде мыңдаған микроарна ашып, белсенді құрамдастарды ең терең қабаттарға жеткізеді және айқын лифтинг береді. Micro Needling Treatment (микроинелермен жасарту) жұмсақ тітіркендіру арқылы терінің қалпына келу қызметтерін белсендіруге көмектеседі.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:
1. Құралды 3-10 күндік циклдермен, 1-2 апталық үзіліспен қолдану ұсынылады.
2. Құрғақ, тазаланған теріге аз мөлшерде жағыңыз: көздің ішкі жағынан самайға қарай алдымен төменгі, содан кейін жоғарғы көз ұясы сүйегінің бойымен жүргізіңіз.
3. Кремді таратып, саусақ ұштарымен уқалаңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ:
1. Аллергиялық реакцияның алдын алу үшін қолданар алдында шынтақ бүгілісінің ішкі жағында сынау ұсынылады. Тітіркену немесе бөртпе болса, қолдануды тоқтатыңыз.
2. Құралды терінің зақымдалған жерлеріне жақпаңыз.
3. Көзге тікелей тигізбеңіз. Тисе, жылы сумен шайыңыз.
4. Қолданғаннан кейін күн сәулесінен қорғау үшін SPF кремін жағу ұсынылады.

САҚТАУ: жабық қаптамада +5 °C-тан +25 °C-қа дейін, тікелей күн сәулесінен алыс, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

КӨЛЕМІ: Әрқайсысы 10 g болатын 2 қаптама.



Биологиялық белсенді қоспалар



A + E COMPLEX

А ЖӘНЕ Е ДӘРУМЕНДЕРІНІҢ КЕШЕНІ (ЖҰМСАҚ КАПСУЛАЛАР, 700 mg)

Сүйек, бұлшықет және жүйке жүйесінің қызметін қолдайды

Қалыпты зат алмасуды қолдайды

Иммунитетті қолдайды

Сау шаш, тері және тырнақ

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: терінің құрғақтығы мен қабыршақтануы, тырнақ сынғыштығы және табиғи жылтырдың жоғалуы, әлсіздік, иммунитеттің бұзылуы.

ҚҰРАМЫ: DL-альфа-токоферил ацетаты (Е дәрумені), Тазартылған өсімдік майы (күнбағыс), Капсула қабығы (желатин, глицерин (қоюландырғыш), су), А дәрумені.

1 КАПСУЛАДАҒЫ БЕЛСЕНДІ ЗАТ МӨЛШЕРІ:
• А дәрумені - 2.6 mg
• Е дәрумені - 100 mg

ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ: тамақтану кезінде, сумен ішіңіз.

ҰСЫНЫЛАТЫН МӨЛШЕРІ: Күніне 1 рет 1 капсула. А және Е гипервитаминозының алдын алу үшін ұсынылған мөлшерден аспаңыз.

ҰСЫНЫЛҒАН ТӘУЛІКТІК МӨЛШЕРДЕГІ ТӘУЛІКТІК ТҰТЫНУ НОРМАСЫНЫҢ ПАЙЫЗЫ (1 КАПСУЛА):
А дәрумені - 325%
Е дәрумені - 1000%

ҰСЫНЫЛАТЫН ҚАБЫЛДАУ КУРСЫ: 2-3 апта. 1-2 айлық аралықпен жылына 3-4 рет қайталаңыз.

ҚАПТАМАДАҒЫ КАПСУЛА САНЫ: 60.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Жоғары сезімталдық, А және Е гипервитаминозы, балалар жасы (18 жасқа дейін), жүктілік, бала емізу.
2. Аса сақтықпен: тиреотоксикоз, холецистит, тамыр өткізгіштігі жоғарылайтын жағдайлар (созылмалы жүрек жеткіліксіздігі, созылмалы гломерулонефрит және т.б.), бауыр циррозы, вирустық гепатит, бүйрек жеткіліксіздігі, алкоголизм, қарттық жас, гипопротромбинемия.

Элемент түрі: майда ериді.

Өзара толықтыратын элементтер: Q10 коэнзимі, темір, мырыш, С дәрумені.

Үйлеспейтін элементтер: антикоагулянттар. Суда еритін дәрумендермен біріктіргенде 2-3 сағат аралық сақтаңыз.

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ: 2 жыл.



ALPHA LIPOIC ACID

АЛЬФА-ЛИПОЙ ҚЫШҚЫЛЫ (HPMC КАПСУЛАЛАРЫ, 450 mg)

Жүрек-тамыр жүйесі мен бауыр саулығын қолдайды

Салмақты бақылау және зат алмасуды қолдау

Қартаюды баяулатады

Қандағы қантты бақылау

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: көмірсу және липид алмасуының бұзылуы, тотығу күйзелісі, шаршау мен энергия жоғалуы, баяу зат алмасу.

ҚҰРАМЫ: Микрокристалды целлюлоза (тасымалдағыш), Мальтодекстрин (тасымалдағыш), Альфа-липой қышқылы, Желатин капсуласы, Кремний диоксиді (жабысып қалуға қарсы агент).

1 КАПСУЛАДАҒЫ БЕЛСЕНДІ ЗАТ МӨЛШЕРІ:
Альфа-липой қышқылы - 100 mg

ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ: Күніне 1 рет 1 капсула тамақпен бірге.

ҰСЫНЫЛАТЫН МӨЛШЕРІ: Күніне 1 рет 1 капсула.

ҰСЫНЫЛҒАН ТӘУЛІКТІК МӨЛШЕРДЕГІ ТӘУЛІКТІК ТҰТЫНУ НОРМАСЫНЫҢ ПАЙЫЗЫ (1 КАПСУЛА):
Альфа-липой қышқылы - 333%

ҰСЫНЫЛАТЫН ҚАБЫЛДАУ КУРСЫ: 1 ай (4 апта), қажет болса қайталауға болады.

ҚАПТАМАДАҒЫ КАПСУЛА САНЫ: 60.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Құрамдастарды жеке көтере алмау.
2. Жүктілік, бала емізу.

Элемент түрі: май қышқылы.

Өзара толықтыратын элементтер: Q10 коэнзимі, темір, мырыш, С дәрумені.

ҮЙЛЕСПЕЙТІН ЭЛЕМЕНТТЕР: қандағы қантты төмендететін дәрілер, темір.

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ: 2 жыл.



ARTHRO ACTIVE

БУЫНДАРДЫ ҚОЛДАУ КЕШЕНІ (ҚАТТЫ ЖЕЛАТИН КАПСУЛАЛАРЫ, 450 mg)

Жарақаттан немесе операциядан кейін сіңірлер мен байламдардың қалпына келуі

Буын қозғалғыштығын жақсартады

Шеміршектің қалпына келуін қолдайды

Сүйек тінін нығайтады

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: буындардағы жайсыздық пен ауырсыну, қозғалыстың шектелуі, шеміршек тінінің бұзылуы.

ҚҰРАМЫ: Метилсульфонилметан, Гидролизденген балық коллагені, Капсула қабығы (желатин), L-аскорбин қышқылы (С дәрумені), Астаксантин.

1 КАПСУЛАДАҒЫ БЕЛСЕНДІ ЗАТ МӨЛШЕРІ:
• Метилсульфонилметан - 250 mg
• Коллаген - 167.5 mg
• С дәрумені - 22.5 mg
• Астаксантин - 0.5 mg

ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ: Күніне 2 рет 2 капсула тамақтану кезінде, сумен ішіңіз.

ҰСЫНЫЛАТЫН МӨЛШЕРІ: Күніне 4 капсула.

ҰСЫНЫЛҒАН ТӘУЛІКТІК МӨЛШЕРДЕГІ ТӘУЛІКТІК ТҰТЫНУ НОРМАСЫНЫҢ ПАЙЫЗЫ **(4 КАПСУЛА):**
• Метилсульфонилметан - норма белгіленбеген
• Коллаген - норма белгіленбеген
• С дәрумені - 90%
• Астаксантин - 100%

ҰСЫНЫЛАТЫН ҚАБЫЛДАУ КУРСЫ: 1 ай (4 апта). Қажет болса, қабылдауды 3-4 аптадан кейін қайталауға болады.

ҚАПТАМАДАҒЫ КАПСУЛА САНЫ: 80.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Құрамдастарды жеке көтере алмау.
2. Жүктілік, бала емізу.

ЭЛЕМЕНТ ТҮРІ:
• Метилсульфонилметан - құрамында күкірті бар табиғи органикалық зат.
• Коллаген суда ериді.
• С дәрумені суда ериді.
• Астаксантин майда ериді.

Өзара толықтыратын элементтер: омега-3, D дәрумені, кальций.

Үйлеспейтін элементтер: антикоагулянттар. Стероидты емес қабынуға қарсы дәрілермен бірге қабылдағанда қоспа нашар сіңеді.

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ: 2 жыл.



B-COMPLEX

В ТОБЫ ДӘРУМЕНДЕРІНІҢ КЕШЕНІ (ҚАТТЫ ЖЕЛАТИН КАПСУЛАЛАРЫ, 360 mg)

Энергия алмасуын қолдайды

Жүйке жүйесін қолдау

Сау шаш, тері және тырнақ

Жүрек пен тамырларды қолдайды

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: шаршау, әлсіздік, аяқ-қолдың ұюы, мазасыздық, тері, шаш және шырышты қабық мәселелері.

ҚҰРАМЫ: Микрокристалды целлюлоза (тасымалдағыш), Капсула қабығы (желатин), B8 дәрумені (инозитол), B3 дәрумені (никотинамид), B5 дәрумені (кальций D-пантотенаты), B2 дәрумені (рибофлавин), B6 дәрумені (пиридоксин гидрохлориді), B1 дәрумені (тиамин гидрохлориді), B12 дәрумені (цианокобаламин), B9 дәрумені (фолий қышқылы), B7 дәрумені (биотин).

1 КАПСУЛАДАҒЫ БЕЛСЕНДІ ЗАТ МӨЛШЕРІ:
• B8 дәрумені - 50 mg
• B3 дәрумені - 30 mg
• B5 дәрумені - 8 mg
• B2 дәрумені - 4 mg
• B6 дәрумені - 4 mg
• B1 дәрумені - 3 mg
• B9 дәрумені - 0.4 mg
B7 дәрумені - 0.15 mg
• B12 дәрумені - 0.002 mg

ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ: Күніне 1 рет 1 капсула тамақпен бірге.

ҰСЫНЫЛАТЫН МӨЛШЕРІ: Күніне 1 рет 1 капсула.

ҰСЫНЫЛҒАН ТӘУЛІКТІК МӨЛШЕРДЕГІ ТӘУЛІКТІК ТҰТЫНУ НОРМАСЫНЫҢ ПАЙЫЗЫ **(1 КАПСУЛА):**
B8 дәрумені - 10%
B3 дәрумені - 166.7%
B5 дәрумені - 133.3%
B2 дәрумені - 250%
B6 дәрумені - 200%
B1 дәрумені - 214%
B9 дәрумені - 200%
B7 дәрумені - 300%
B12 дәрумені - 200%

ҰСЫНЫЛАТЫН ҚАБЫЛДАУ КУРСЫ: 1 ай (4 апта), қажет болса қайталауға болады.

ҚАПТАМАДАҒЫ КАПСУЛА САНЫ: 60.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Құрамдастарды жеке көтере алмау.
2. Жүктілік, бала емізу.

Элемент түрі: суда ериді.

Өзара толықтыратын элементтер: магний, С дәрумені, мырыш, темір, кальций, пробиотиктер.

Үйлеспейтін элементтер: кофеин.

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ: 2 жыл.



BIOTIN

БИОТИН (ҚАТТЫ ЖЕЛАТИН КАПСУЛАЛАРЫ, 385 mg)

Шаш өсуін ынталандырады

Теріні, шаш пен тырнақты нығайтады

Қандағы қантты тұрақты ұстауға көмектеседі

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: шаштың сиреуі мен түсуі, тырнақ сынғыштығы мен қабаттануы, терінің құрғақтығы мен қабыршақтануы.

ҚҰРАМЫ: Микрокристалды целлюлоза (тасымалдағыш), Желатин капсуласы (желатин, мырыш оксиді - бояғыш), Биотин (В7 дәрумені), Кальций стеараты (жабысып қалуға қарсы агент).

1 КАПСУЛАДАҒЫ БЕЛСЕНДІ ЗАТ МӨЛШЕРІ:
Биотин (В7 дәрумені) - 5000 mcg

ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ: Күніне 1 рет 1 капсула тамақпен бірге.

ҰСЫНЫЛАТЫН МӨЛШЕРІ: Күніне 1 рет 1 капсула.

ҰСЫНЫЛҒАН ТӘУЛІКТІК МӨЛШЕРДЕГІ ТӘУЛІКТІК ТҰТЫНУ НОРМАСЫНЫҢ ПАЙЫЗЫ (1 КАПСУЛА):
Биотин (В7 дәрумені) - 10000%

ҰСЫНЫЛАТЫН ҚАБЫЛДАУ КУРСЫ: 1 ай (4 апта), қажет болса қайталауға болады.

ҚАПТАМАДАҒЫ КАПСУЛА САНЫ: 60.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Өнім құрамдастарына жоғары сезімталдық.
2. Жүктілік, бала емізу кезеңі.
3. Бүйрек жеткіліксіздігі.

Элемент түрі: суда ериді.

Өзара толықтыратын элементтер: В тобы дәрумендері, мырыш, селен, магний.

Үйлеспейтін элементтер: жоғары дозалы С дәрумені.

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ: 2 жыл.



CHLOROPHYLL

ХЛОРОФИЛЛ (СҰЙЫҚ КОНЦЕНТРАТ, 500 ml)

Бактерияға қарсы әсер

Иммунитетті қолдайды

Ас қорыту қызметін қолдайды

Жасарту және детокс

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: асқазан-ішек жолы мен иммунитет қызметінің бұзылуы.

ҚҰРАМЫ: Тазартылған су, Өсімдік глицерині (қоюландырғыш), Твин 60 (эмульгатор), Хлорофиллиндердің мыс кешендері (табиғи тағамдық бояғыш), Калий сорбаты (консервант), Табиғи бұрыш жалбыз майы.

1 порциядағы (15 мл) БЕЛСЕНДІ ЗАТТЫҢ МАЗМҰНЫ:
- **Хлорофилл - 50 mg**
- **Мыс - 2 mg**

ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ: ас қасық мөлшерін (15 ml) 100 ml суда немесе шырында сұйылтып, күніне 1 рет тамақтан 30 минут бұрын ішіңіз. Қолданар алдында құтыны шайқаңыз.

ҰСЫНЫЛАТЫН МӨЛШЕРІ: Күніне 1 рет 1 порция (15 ml).

ҰСЫНЫЛҒАН ТӘУЛІКТІК МӨЛШЕРДЕГІ ТӘУЛІКТІК ТҰТЫНУ НОРМАСЫНЫҢ ПАЙЫЗЫ (15 ml):
- **Хлорофилл - 50%**
- **Мыс - 200%**

ҰСЫНЫЛАТЫН ҚАБЫЛДАУ КУРСЫ: 1 ай (4 апта), қажет болса қайталауға болады.

КӨЛЕМІ: 500 ml.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Өнім құрамдастарына жоғары сезімталдық.
2. Жүктілік, бала емізу кезеңі.
3. Ағзада мыстың артық болуымен байланысты аурулар.

Элемент түрі: суда ериді.

Өзара толықтыратын элементтер: В тобы дәрумендері, С дәрумені, пробиотиктер.

Үйлеспейтін элементтер: кальций, жоғары дозалы темір.

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ: 2 жыл.



CHROMIUM PICOLINATE

ХРОМ ПИКОЛИНАТЫ (HPMC КАПСУЛАЛАРЫ, 410 mg)

Тәттіге құмарлықты азайтады

Салмақ пен зат алмасуды қолдау

Оңтайлы сіңу үшін С дәрумені

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: көмірсу және липид алмасуының бұзылуы, баяу зат алмасу, бауыр қызметінің бұзылуы, холестериннің жоғарылауы.

ҚҰРАМЫ: Микрокристалды целлюлоза (тасымалдағыш), Целлюлоза капсуласы (гидроксипропилметилцеллюлоза), L-аскорбин қышқылы (С дәрумені), Хром пиколинаты.

1 КАПСУЛАДАҒЫ БЕЛСЕНДІ ЗАТ МӨЛШЕРІ:
• С дәрумені - 60 mg
• Хром (III) - 250 μg

ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ: таңертең тамақпен бірге күніне 1 рет 1 капсула, сумен ішіңіз.

ҰСЫНЫЛАТЫН МӨЛШЕРІ: Күніне 1 капсула.

ҰСЫНЫЛҒАН ТӘУЛІКТІК МӨЛШЕРДЕГІ ТӘУЛІКТІК ТҰТЫНУ НОРМАСЫНЫҢ ПАЙЫЗЫ (1 КАПСУЛА):
• С дәрумені - 100%
• Хром (III) - 500%

ҰСЫНЫЛАТЫН ҚАБЫЛДАУ КУРСЫ: 1 ай (4 апта), қажет болса қайталауға болады.

ҚАПТАМАДАҒЫ КАПСУЛА САНЫ: 60.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Құрамдастарды жеке көтере алмау.
2. Жүктілік, бала емізу кезеңі.
3. Өнім 18 жасқа толмаған адамдарға арналмаған.

ЭЛЕМЕНТ ТҮРІ:
Хром - минерал.
• С дәрумені суда ериді.

Өзара толықтыратын элементтер: альфа-липой қышқылы, Q10 коэнзимі, В тобы дәрумендері, омега-3, магний.

ҮЙЛЕСПЕЙТІН ЭЛЕМЕНТТЕР: қандағы қантты төмендететін дәрілер, антикоагулянттар, қан қысымын төмендететін дәрілер.

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ: 2 жыл.



COENZYME Q10 — 100 MG

Q10 КОЭНЗИМІ, 100 mg (ҚАТТЫ ЖЕЛАТИН КАПСУЛАЛАРЫ, 450 mg)

Қартаюды баяулатады

Ағзаны нығайтады

Қалпына келу мен жазылуды қолдайды

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: жасқа байланысты өзгерістер, жүктемеге төзімділіктің төмендеуі, бұлшықет әлсіздігі, шаршаудың артуы, жұмыс қабілетінің төмендеуі.

ҚҰРАМЫ: Карбоксиметилцеллюлоза (тасымалдағыш), Убихинон (Q10 коэнзимі), Капсула (желатин, тазартылған ауызсу).

1 КАПСУЛАДАҒЫ БЕЛСЕНДІ ЗАТ МӨЛШЕРІ:
Q10 коэнзимі - 100 mg

ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ: таңертең тамақтану кезінде қабылдаған жөн. Q10 коэнзимін майлы тамақпен қабылдау сіңуін арттыруы мүмкін.

ҰСЫНЫЛАТЫН МӨЛШЕРІ: Күніне 1 рет 1 капсула.

ҰСЫНЫЛҒАН ТӘУЛІКТІК МӨЛШЕРДЕГІ ТӘУЛІКТІК ТҰТЫНУ НОРМАСЫНЫҢ ПАЙЫЗЫ (1 КАПСУЛА):
Q10 коэнзимі - 333%

ҰСЫНЫЛАТЫН ҚАБЫЛДАУ КУРСЫ: 1 ай (4 апта). 1-2 айлық аралықпен жылына 3-4 рет қайталаңыз.

ҚАПТАМАДАҒЫ КАПСУЛА САНЫ: 60.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Өнім құрамдастарына жоғары сезімталдық.
2. Жүктілік, бала емізу кезеңі.
3. Асқазан ойық жарасы, қышқылдығы жоғары гастрит.
4. Q10 коэнзимі қан қысымын төмендетуі мүмкін, сондықтан гипотониясы бар адамдарға сақтықпен қолдану ұсынылады. Онсыз да төмен қысымды одан әрі түсіруі мүмкін.

Элемент түрі: майда ериді.

Өзара толықтыратын элементтер: С, Е дәрумендері, омега-3, альфа-липой қышқылы және карнитин.

ҮЙЛЕСПЕЙТІН ЭЛЕМЕНТТЕР: антикоагулянттар, гипертензияға қарсы дәрілер, диабетке және холестеринді азайтуға арналған кейбір дәрілер Q10 коэнзимімен бірге қатты бұлшықет ауырсынуын туғызуы мүмкін.

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ: 2 жыл.



GINSENG

NEOVITIN FORTE (ТАБЛЕТКАЛАР, 750 mg)

Иммунитетті қолдайды

Ерлер саулығын қолдайды

Ми қызметі мен жұмыс қабілетін қолдайды

Антиоксиданттық ферменттердің түзілуін ынталандырады

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: жасқа байланысты өзгерістер, шаршаудың артуы, жұмыс қабілетінің төмендеуі, гипотонияның алдын алу, иммунитеттің төмендеуі.

ҚҰРАМЫ: Микрокристалды целлюлоза (толтырғыш), Женьшень сығындысы, Өсімдік текті кальций стеараты (жабысып қалуға қарсы агент), Рутин (Р дәрумені), Никотинамид (РР дәрумені), Женьшень биомассасы.

1 ТАБЛЕТКАДАҒЫ БЕЛСЕНДІ ЗАТ МӨЛШЕРІ:
- **Панаксозид - 3 mg**
- **Рутин - 2 mg**
- **Никотинамид - 2 mg**

ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ: тамақтану кезінде күніне 3 рет 1 таблетка; кешке қабылдамаңыз.

ҰСЫНЫЛАТЫН МӨЛШЕРІ: Күніне 3 рет 1 таблетка.

ҰСЫНЫЛҒАН ТӘУЛІКТІК МӨЛШЕРДЕГІ ТӘУЛІКТІК ТҰТЫНУ НОРМАСЫНЫҢ ПАЙЫЗЫ (3 ТАБЛЕТКА):
Панаксозид - норма белгіленбеген
- **Рутин - 23%**
- **Никотинамид - 30%**

ҰСЫНЫЛАТЫН ҚАБЫЛДАУ КУРСЫ: 2-3 апта, қажет болса 1 айдан кейін қайталаңыз.

ҚАПТАМАДАҒЫ ТАБЛЕТКА САНЫ: 90 дана.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Өнім құрамдастарына жоғары сезімталдық.
2. Жүктілік, бала емізу кезеңі.
3. Кешкі уақытта қабылдау.
4. Жүйке қозғыштығының жоғарылауы, ұйқысыздық.
5. Жоғары қан қысымы, жүрек жұмысының бұзылыстары.
6. Ауыр атеросклероз.
7. Бүйрек жеткіліксіздігі.

Элемент түрі: женьшень жасушаларының өсіріндісі.

Өзара толықтыратын элементтер: С, Е дәрумендері.

ҮЙЛЕСПЕЙТІН ЭЛЕМЕНТТЕР: антикоагулянттар, қан қысымын төмендететін дәрілер.

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ: 3 жыл.



GLUCOSAMINE

ХОНДРОИТИН ҚОСЫЛҒАН ГЛЮКОЗАМИН (ҚАТТЫ ЖЕЛАТИН КАПСУЛАЛАРЫ, 1100 mg)

Буын қабынуын азайтады

Буын икемділігі мен қозғалғыштығын жақсартады

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: буындардағы жайсыздық пен ауырсыну, қозғалыстың шектелуі.

ҚҰРАМЫ: Глюкозамин гидрохлориді, Хондроитин сульфаты, Капсула қабығы (желатин, титан диоксиді (бояғыш)), Магний стеараты (жабысып қалуға қарсы агент).

1 КАПСУЛАДАҒЫ БЕЛСЕНДІ ЗАТ МӨЛШЕРІ:
- **Глюкозамин - 465 mg**
- **Хондроитин - 360 mg**

ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ: тамақтану кезінде, сумен ішіңіз.

ҰСЫНЫЛАТЫН МӨЛШЕРІ: Күніне 3 рет 1 капсула.

ҰСЫНЫЛҒАН ТӘУЛІКТІК МӨЛШЕРДЕГІ ТӘУЛІКТІК ТҰТЫНУ НОРМАСЫНЫҢ ПАЙЫЗЫ (3 КАПСУЛА):
- **Глюкозамин - 199%**
- **Хондроитин - 180%**

ҰСЫНЫЛАТЫН ҚАБЫЛДАУ КУРСЫ: 1 ай (4 апта). 2 апта үзілістен кейін курсты қайталауға болады.

ҚАПТАМАДАҒЫ КАПСУЛА САНЫ: 60.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Өнімнің негізгі және қосымша құрамдастарына жоғары сезімталдық.
2. Белсенді зат глюкозамин ұлулар мен шаянтәріздерден алынатындықтан, ұлуларға аллергиясы бар адамдарға препаратты тағайындауға болмайды.
3. Балалар жасы.
4. Жүктілік және бала емізу кезеңі.

Элемент түрі: суда ериді.

Өзара толықтыратын элементтер: омега-3, D дәрумені, кальций.

Үйлеспейтін элементтер: антикоагулянттар; стероидты емес қабынуға қарсы дәрілермен бірге қабылдағанда глюкозамин нашар сіңеді.

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ: 3 жыл



IRON CHELATE

ХЕЛАТТЫ ТЕМІР (ТҮТІКШЕДЕ 20 КӨПІРШИТІН ТАБЛЕТКА, 3.8 g)

Шаршауды азайтып, жұмыс қабілетін арттырады

Иммундық жүйенің белсенділігін қолдайды

Темір, ферритин және гемоглобиннің қалыпты деңгейін сақтайды

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: әлсіздік, ұйқышылдық, шаршаудың артуы, тәбеттің төмендеуі.

ҚҰРАМЫ: Глюкоза, Сусыз лимон қышқылы (қышқылдықты реттегіш), Натрий бикарбонаты (қышқылдықты реттегіш), Темір бисглицинаты, Табиғи алма хош иістендіргіші, Полиэтиленгликоль (тұрақтандырғыш), Аспартам (тәттілендіргіш). Құрамында фенилаланин көзі бар.

1 ТАБЛЕТКАДАҒЫ БЕЛСЕНДІ ЗАТ МӨЛШЕРІ:
Темір - 14 mg

ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ: таңертең аш қарынға немесе түскі уақытта, сумен, алма не апельсин шырынымен ішіңіз.

ҰСЫНЫЛАТЫН МӨЛШЕРІ: Күніне 1 рет 1 таблетка.

ҰСЫНЫЛҒАН ТӘУЛІКТІК МӨЛШЕРДЕГІ ТӘУЛІКТІК ТҰТЫНУ НОРМАСЫНЫҢ ПАЙЫЗЫ (1 ТАБЛЕТКА):
Темір - 100%

ҰСЫНЫЛАТЫН ҚАБЫЛДАУ КУРСЫ: 1 ай (4 апта). 1-2 айлық аралықпен жылына 3-4 рет қайталаңыз.

ҚАПТАМАДАҒЫ ТАБЛЕТКА САНЫ: 20 дана.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Темір тапшылығынан туындамаған анемия.
2. Темірдің артық жиналу белгілері (гемосидероз, гемохроматоз).
3. Темірді пайдалану процесінің бұзылуы.
4. Жүктіліктің I триместрі.
5. Белсенді затқа жоғары сезімталдық.

Элемент түрі: минерал.

Өзара толықтыратын элементтер: А, В3, С дәрумендері, мыс, фолий қышқылы.

Үйлеспейтін элементтер: мырыш, магний, хром, кальций, Е дәрумені.

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ: 2 жыл.



IRON CHELATE BISGLYCINATE

ХЕЛАТТЫ ТЕМІР (HPMC КАПСУЛАЛАРЫ, 450 mg)

Шаршауды азайтып, жұмыс қабілетін арттырады

Иммундық жүйенің белсенділігін қолдайды

Темір, ферритин және гемоглобиннің қалыпты деңгейін сақтайды

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: әлсіздік, ұйқышылдық, шаршаудың артуы, тәбеттің төмендеуі.

ҚҰРАМЫ: Микрокристалды целлюлоза (тасымалдағыш), Темір бисглицинаты, Желатин, Аскорбин қышқылы (С дәрумені), Мыс глюконаты, Кремний диоксиді (жабысып қалуға қарсы агент), Цианокобаламин (В12 дәрумені).

1 КАПСУЛАДАҒЫ БЕЛСЕНДІ ЗАТ МӨЛШЕРІ:
• Темір - 14 mg
• Мыс - 1.5 mg
• С дәрумені - 60 mg
В12 дәрумені - 4.5 mcg

ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ: таңертең.

ҰСЫНЫЛАТЫН МӨЛШЕРІ: Ерлерге күніне 1 капсула, әйелдерге күніне 2 капсула.

ҰСЫНЫЛҒАН ТӘУЛІКТІК МӨЛШЕРДЕГІ ТӘУЛІКТІК ТҰТЫНУ НОРМАСЫНЫҢ ПАЙЫЗЫ
(1 КАПСУЛА):
1 капсула
• Темір - 143%
• Мыс - 150%
• С дәрумені - 100%
В12 дәрумені - 450%. 2 капсула
• Темір - 286%
• Мыс - 300%
С дәрумені - 200%
В12 дәрумені - 900%

ҰСЫНЫЛАТЫН ҚАБЫЛДАУ КУРСЫ: 1 ай (4 апта). 1-2 айлық аралықпен жылына 3-4 рет қайталаңыз.

ҚАПТАМАДАҒЫ КАПСУЛА САНЫ: 60.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Темір тапшылығынан туындамаған анемия.
2. Темірдің артық жиналу белгілері (гемосидероз, гемохроматоз).
3. Темірді пайдалану процесінің бұзылуы.
4. Жүктіліктің I триместрі.
5. Белсенді затқа жоғары сезімталдық.

Элемент түрі: дәрумендер мен минералдар.

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ: 3 жыл.



KELP SEA IODINE

ТЕҢІЗ ЛАМИНАРИЯСЫНАН АЛЫНҒАН ЙОД (ТАБЛЕТКАЛАР, 700 mg)

Тері майының түзілуін реттейді

Антиоксиданттық әсер

Тіндердің қалпына келуін қолдайды

Жыныс гормондарының түзілуін қолдайды

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: жасқа байланысты өзгерістер, иммунитеттің төмендеуі, гормондық бұзылыстар.

ҚҰРАМЫ: L-тирозин, Кептірілген ламинария (ұнтақ), Микрокристалды целлюлоза (E460i, тасымалдағыш), Селенометионин.

1 ТАБЛЕТКАДАҒЫ БЕЛСЕНДІ ЗАТ МӨЛШЕРІ:
• Йод - 400 μg
• Тирозин - 330-380 mg
• Селен - 65 μg

ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ: Күніне 2 рет 1 таблетка тамақтану кезінде.

ҰСЫНЫЛАТЫН МӨЛШЕРІ: Күніне 2 рет 1 таблетка.

ҰСЫНЫЛҒАН ТӘУЛІКТІК МӨЛШЕРДЕГІ ТӘУЛІКТІК ТҰТЫНУ НОРМАСЫНЫҢ ПАЙЫЗЫ **(2 ТАБЛЕТКА):**
• Йод - 533%
• Тирозин - 15.7-17.3%
Селен - ерлерге 173%, әйелдерге 236%

ҰСЫНЫЛАТЫН ҚАБЫЛДАУ КУРСЫ: 1 ай (4 апта), қажет болса жалғастыруға болады.

ҚАПТАМАДАҒЫ ТАБЛЕТКА САНЫ: 60.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Өнім құрамдастарына жоғары сезімталдық.
2. Жүктілік, бала емізу кезеңі.
3. Йод препараттарын қолдануға қарсы көрсетілім болатын жағдайлар.
4. Гипертиреоз.
5. Жеделдеу тиреоидит.
6. Бүйрек және бауыр жеткіліксіздігі.

Элемент түрі: микроэлемент.

Өзара толықтыратын элементтер: В тобы дәрумендері, магний, мырыш.

Үйлеспейтін элементтер: антиоксиданттар.

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ: 2 жыл.



KRILL OIL

КРИЛЬ МАЙЫ (ЖҰМСАҚ КАПСУЛАЛАР, 700 mg)

Сау тері, тырнақ пен шаш

Ми қызметін қолдайды

Жүрек пен тамырлар саулығы

Иммунитетті қолдайды

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: тырнақ пен шаш сынғыштығы, өңсіз тері, шаршау, иммунитеттің төмендеуі, зейін мен есте сақтаудың нашарлауы.

ҚҰРАМЫ: Атлант крилінің майы, қабық (сиыр желатині, ылғал сақтағыш глицерин, тазартылған су).

1 КАПСУЛАДАҒЫ БЕЛСЕНДІ ЗАТ МӨЛШЕРІ:
• Криль майы - 500 mg
• EPA - 60 mg
• DHA - 30 mg
• Астаксантин - 150 μg
• Фосфолипидтер - 100 mg

ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ: Күніне 3 рет 1 капсула тамақтану кезінде.

ҰСЫНЫЛАТЫН МӨЛШЕРІ: Күніне 3 рет 1 капсула.

ҰСЫНЫЛҒАН ТӘУЛІКТІК МӨЛШЕРДЕГІ ТӘУЛІКТІК ТҰТЫНУ НОРМАСЫНЫҢ ПАЙЫЗЫ **(3 КАПСУЛА):**
Криль майы - норма белгіленбеген
• EPA - 30%
• DHA - 12.9%
• Астаксантин - 22.5%
• Фосфолипидтер - 4.3%

ҰСЫНЫЛАТЫН ҚАБЫЛДАУ КУРСЫ: 1 ай (4 апта), қажет болса қайталауға болады.

ҚАПТАМАДАҒЫ КАПСУЛА САНЫ: 90 дана.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Теңіз өнімдеріне аллергиялық реакциялар.
2. 3 жасқа толмаған балалар.
3. Өнім құрамындағы заттарды жеке көтере алмау.
4. Қан кету немесе қан ұюының бұзылуы.
5. Бронх демікпесі.

6. Бауыр аурулары.
7. Асқазан-ішек жолының жедел немесе созылмалы кезеңдегі әртүрлі патологиялары.
8. Операциядан кейінгі кезең.
9. Операциядан кейін оңалтудан өтіп жүрген немесе әртүрлі себепті жарақаттары бар адамдарға криль майын қабылдауды бастар не қайта жалғастырар алдында дәрігермен кеңесу ұсынылады.

ЭЛЕМЕНТ ТҮРІ: полиқанықпаған май қышқылдары.

Өзара толықтыратын элементтер: коллаген, кальций, магний, Q10 коэнзимі, лецитин, A, E, B, C, D дәрумендері.

Үйлеспейтін элементтер: темір, мыс және мырыштың биожетімділігін азайтады; 2-3 сағат аралықпен қабылдаңыз.

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ: 2 жыл.



L-CARNITINE

L-КАРНИТИН (ҚАТТЫ ЖЕЛАТИН КАПСУЛАЛАРЫ, 840 mg)

Шаршауды азайтады

Зат алмасуды жақсартады

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: тез шаршау, жұмыс қабілетінің төмендеуі, артық салмақ, дене жүктемесінен кейін қиын қалпына келу.

ҚҰРАМЫ: L-карнитин тартраты, Қабық (желатин, тағамдық бояғыш (титан диоксиді)), Магний стеараты (жабысып қалуға қарсы агент).

1 КАПСУЛАДАҒЫ БЕЛСЕНДІ ЗАТ МӨЛШЕРІ:
L-карнитин - 540 mg

ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ: таңертең аш қарынға, жылы немесе салқын сумен ішіңіз.

ҰСЫНЫЛАТЫН МӨЛШЕРІ: Күніне 1 рет 1 капсула.

ҰСЫНЫЛҒАН ТӘУЛІКТІК МӨЛШЕРДЕГІ ТӘУЛІКТІК ТҰТЫНУ НОРМАСЫНЫҢ ПАЙЫЗЫ (1 КАПСУЛА):
L-карнитин - 180%

ҰСЫНЫЛАТЫН ҚАБЫЛДАУ КУРСЫ: 4-6 апта. 2-8 апта үзілістен кейін курсты қайталауға болады.

ҚАПТАМАДАҒЫ КАПСУЛА САНЫ: 60.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Өнім құрамдастарына жоғары сезімталдық.
2. Жүктілік, бала емізу кезеңі.
3. Гипотиреоз.

Элемент түрі: аминқышқылы.

Өзара толықтыратын элементтер: омега-3.

Үйлеспейтін элементтер: антикоагулянттар, жоғары дозалы кальций мен темір.

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ: 3 жыл.



LIPOSOMAL VITAMIN C

ЛИПОСОМАЛЫҚ С ДӘРУМЕНІ (ҚАТТЫ ЖЕЛАТИН КАПСУЛАЛАРЫ, 700 mg)

Иммунитетті қолдайды

Антиоксиданттық әсер

Қалыпты тотығу процестерін қолдайды

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: жұмыс қабілетінің төмендеуі, енжарлық, әлсіздік, ұйқышылдық, инфекцияларға төзімділіктің азаюы, әртүрлі ауруларда қалпына келудің баяулауы.

ҚҰРАМЫ: Натрий аскорбаты (Е301), Микрокристалды целлюлоза (Е460i, тасымалдағыш), Рутин (жапон софорасының сығындысы (лат. Sophorae Japonica)), кальций стеараты (Е470a, тұрақтандырғыш), липосомалық С дәруменінің ұнтағы, капсула (гидроксипропилметилцеллюлоза (Е464, қоюландырғыш) немесе желатин).

1 КАПСУЛАДАҒЫ БЕЛСЕНДІ ЗАТ МӨЛШЕРІ:
- **С дәрумені - 500 mg**
- **Рутин - 25 mg**

ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ: Күніне 1 рет 1 капсула тамақтану кезінде.

ҰСЫНЫЛАТЫН МӨЛШЕРІ: Күніне 1 рет 1 капсула.

ҰСЫНЫЛҒАН ТӘУЛІКТІК МӨЛШЕРДЕГІ ТӘУЛІКТІК ТҰТЫНУ НОРМАСЫНЫҢ ПАЙЫЗЫ (1 КАПСУЛА):
- **С дәрумені - 833%**
- **Рутин - 83%**

ҰСЫНЫЛАТЫН ҚАБЫЛДАУ КУРСЫ: 1 ай (4 апта), қажет болса жалғастыруға болады.

ҚАПТАМАДАҒЫ КАПСУЛА САНЫ: 60.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Өнім құрамдастарына жоғары сезімталдық.
2. Нефролитиаз.
3. Гемохроматоз (темірдің артық болуы).
4. Қан ұюы жоғары, тромбофлебиті немесе тромбозға бейімділігі бар адамдарға, сондай-ақ қант диабеті және қандағы қант жоғарылайтын жағдайларда үлкен дозаларды тағайындауға болмайды.

Элемент түрі: суда ериді.

Өзара толықтыратын элементтер: A, E, B5, B9 дәрумендері.

Үйлеспейтін элементтер: B1, B12 дәрумендері, мыс.

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ: 2 жыл.



MAGNESIUM CHELATE + B6

ХЕЛАТТЫ МАГНИЙ + B6 (ҚАТТЫ ЖЕЛАТИН КАПСУЛАЛАРЫ, 870 mg)

Жүйке жүйесінің қозғыштығын азайтады

Бұлшықет түйілуінің алдын алуға көмектеседі

Жүрек-тамыр жүйесінің қалыпты қызметін қолдайды

Төзімділік пен жұмыс қабілетін арттырады

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: ашушаңдықтың артуы, есте сақтаудың нашарлауы, ұйқы бұзылысы, құрысу, бұлшықет әлсіздігі, жүрек ырғағының бұзылуы, бас айналу.

ҚҰРАМЫ: Магний бисглицинаты (хелат), Микрокристалды целлюлоза (тасымалдағыш), Желатин капсуласы, Пиридоксин гидрохлориді (B6 дәрумені).

1 КАПСУЛАДАҒЫ БЕЛСЕНДІ ЗАТ МӨЛШЕРІ:
- **Магний - 104 mg**
- **B6 - 1.5 mg**

ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ: Күніне 2 рет 2 капсула тамақтану кезінде.

ҰСЫНЫЛАТЫН МӨЛШЕРІ: Күніне 4 капсула.

ҰСЫНЫЛҒАН ТӘУЛІКТІК МӨЛШЕРДЕГІ ТӘУЛІКТІК ТҰТЫНУ НОРМАСЫНЫҢ ПАЙЫЗЫ (4 КАПСУЛА):
Магний - 104%
- **B6 - 300%**

ҰСЫНЫЛАТЫН ҚАБЫЛДАУ КУРСЫ: 1 ай (4 апта), қажет болса қайталауға болады.

ҚАПТАМАДАҒЫ КАПСУЛА САНЫ: 80.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Белсенді заттарға жоғары сезімталдық.
2. Жүктілік және бала емізу кезеңі.
3. Ауыр бүйрек жеткіліксіздігі (креатинин клиренсі 30 ml/min-тан төмен).
4. 6 жасқа толмаған балалар (тиімділігі мен қауіпсіздігі анықталмаған).
5. Тұқым қуалайтын галактоземия, глюкоза мен галактозаның сіңбеу синдромы немесе лактаза жеткіліксіздігі (өнім құрамында лактоза болғандықтан).
6. Леводопаны қатар қабылдау.

ЭЛЕМЕНТ ТҮРІ:
Магний - минерал.
• B6 - суда еритін дәрумен.

Өзара толықтыратын элементтер: B2-B12, D дәрумендері.

ҮЙЛЕСПЕЙТІН ЭЛЕМЕНТТЕР: B1, E дәрумендері, темір, фосфор, жоғары дозалы кальций, кейбір антибиотиктер (тетрациклин).

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ: 2 жыл.



MAGNESIUM 4.0

МАГНИЙ КЕШЕНІ (НРМС КАПСУЛАЛАРЫ, 876 mg)

Терең босаңсыту және күйзеліске қарсы қолдау

Энергия және бұлшықет қызметі

Жүрек пен тамырларды қолдайды

Ас қорыту саулығы және жұмсақ тазалау

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: ашушаңдықтың артуы, есте сақтаудың нашарлауы, ұйқы бұзылысы, құрысу, бұлшықет әлсіздігі, жүрек ырғағының бұзылуы, бас айналу.

ҚҰРАМЫ: Магний цитраты, Магний бисглицинаты, Өсімдік капсуласы (тасымалдағыш - гидроксипропилметилцеллюлоза), Магний малаты, Магний таураты, Қызанақ жемісінің ұнтағы, Стеарин қышқылының магний тұзы (жабысып қалуға қарсы агент), Пиридоксаль-5-фосфат.

1 КАПСУЛАДАҒЫ БЕЛСЕНДІ ЗАТ МӨЛШЕРІ:
- **Магний - 100 mg**
- **B6 - 0.25 mg**

1 КАПСУЛАДАҒЫ ҚҰРАМДАС МӨЛШЕРІ, mg	
Магний цитраты 365	
Магний бисглицинаты 146	
Магний малаты 110	
Магний таураты 110	

ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ: Күніне 2 рет 1 капсула тамақтану кезінде.

ҰСЫНЫЛАТЫН МӨЛШЕРІ: Күніне 2 капсула.

ҰСЫНЫЛҒАН ТӘУЛІКТІК МӨЛШЕРДЕГІ ТӘУЛІКТІК ТҰТЫНУ НОРМАСЫНЫҢ ПАЙЫЗЫ (2 КАПСУЛА):
- **Магний - 50%**
- **B6 - 30%**

ҰСЫНЫЛАТЫН ҚАБЫЛДАУ КУРСЫ: 1 ай (4 апта), қажет болса қайталауға болады.

ҚАПТАМАДАҒЫ КАПСУЛА САНЫ: 60.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Құрамдастарды жеке көтере алмау.
2. Жүкті және бала емізетін әйелдер дәрігердің ұсынымымен және бақылауымен қабылдауы тиіс.

ЭЛЕМЕНТ ТҮРІ:
Магний - минерал.
• B6 - суда еритін дәрумен.

Өзара толықтыратын элементтер: B2-B12, D дәрумендері.

ҮЙЛЕСПЕЙТІН ЭЛЕМЕНТТЕР: B1, E дәрумендері, темір, фосфор, жоғары дозалы кальций, кейбір антибиотиктер (тетрациклин).

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ: 3 жыл.



MEN’S FORMULA

ЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН МУЛЬТИДӘРУМЕНДІ КЕШЕН (НРМС КАПСУЛАЛАРЫ, 580 mg)

Дәрумендер мен минералдарды толықтырады

Сергектік пен энергияны қолдайды

Жүйке жүйесі мен танымдық қызметті қолдайды

Ерлер саулығын қолдайды

Антиоксиданттық қорғаныс және иммунитетті қолдау

Сүйек пен тістерді нығайтады

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: иммунитеттің төмендеуі, жалпы әлсіздік, ашушаңдықтың артуы, есте сақтаудың нашарлауы, ұйқы бұзылыстары.

ҚҰРАМЫ: Магний цитраты, L-аскорбин қышқылы (С дәрумені), Гидроксипропилметилцеллюлоза (капсула), Кальций карбонаты, Инозитол, Цитрус биофлавоноидтары, Калий цитраты, Женьшень сығындысы, Соя изофлавондары, Кремний диоксиді (жабысып қалуға қарсы агент), Мырыш цитраты, Никотинамид (ниацин), Магний стеараты (жабысып қалуға қарсы агент), DL-альфа-токоферол (Е дәрумені), Рибофлавин (В2 дәрумені), Тиамин гидрохлориді (В1 дәрумені), Пиридоксин гидрохлориді (В6 дәрумені), D-кальций пантотенаты (пантотен қышқылы), Марганец глюконаты, Мыс глюконаты, Ликопин, Кальций L-метилфолаты (фолий қышқылы), Хром пиколинаты, D-биотин (В7 дәрумені), Ретинол (А дәрумені), Калий йодиді, Молибден глицинаты, L-селенометионин, Метилкобаламин (В12 дәрумені), Холекальциферол (D3 дәрумені).

1 КАПСУЛАДАҒЫ БЕЛСЕНДІ ЗАТ МӨЛШЕРІ:

- А дәрумені - 0.055 mg
- С дәрумені - 100 mg
- D3 дәрумені - 0.0035 mg
- Е дәрумені - 3.33 mg
- В1 дәрумені - 2.5 mg
- В2 дәрумені - 3.0 mg

В3 дәрумені - 6.67 mg

- В6 дәрумені - 2.0 mg
- Фолий қышқылы - 0.3 mg
- В12 дәрумені - 0.0045 mg
- Биотин - 0.075 mg
- Пантотен қышқылы - 2.0 mg
- Кальций - 100 mg
- Магний - 133.3 mg
- Мырыш - 6.67 mg
- Селен - 0.02 mg
- Мыс - 0.5 mg
- Марганец - 0.67 mg
- Хром - 0.125 mg

• Молибден - 0.02 mg
• Инозитол - 33.3 mg
• Соя изофлавондары - 8.35 mg
• Ликопин - 0.33 mg

Қабылдау тәртібі: күннің бірінші жартысында күніне 2 рет 1 капсуладан.

ҰСЫНЫЛАТЫН МӨЛШЕРІ: Күніне 2 капсула.

ҰСЫНЫЛҒАН ТӘУЛІКТІК МӨЛШЕРДЕГІ ТӘУЛІКТІК ТҰТЫНУ НОРМАСЫНЫҢ ПАЙЫЗЫ
(2 КАПСУЛА):
• А дәрумені - 14%
С дәрумені - 33%
D3 дәрумені - 140%
Е дәрумені - 66%
В1 дәрумені - 357%
В2 дәрумені - 375%
В3 дәрумені - 74%
В6 дәрумені - 200%
Фолий қышқылы - 300%
В12 дәрумені - 900%
• Биотин - 300%
• Пантотен қышқылы - 67%
• Кальций - 20%
• Магний - 67%
• Мырыш - 89%
• Селен - 57%
• Мыс - 100%
• Марганец - 67%
• Хром - 500%
• Молибден - 57%
• Инозитол - 13%
• Соя изофлавондары - 33%
• Ликопин - 13%

ҰСЫНЫЛАТЫН ҚАБЫЛДАУ КУРСЫ: 1 ай (4 апта), қажет болса қайталауға болады.

ҚАПТАМАДАҒЫ КАПСУЛА САНЫ: 60.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Биологиялық белсенді қоспа құрамдастарын жеке көтере алмау.
2. Жүйке қозғыштығының жоғарылауы, ұйқысыздық.
3. Жоғары қан қысымы, жүрек ырғағының бұзылуы, ауыр атеросклероз.
4. Кешкі уақытта қабылдау.

Элемент түрі: дәрумендер мен минералдар.

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ: 3 жыл.



NMN

NMN (НРМС КАПСУЛАЛАРЫ, 550 mg)

Жасартатын күтім

Жасушалардың қалпына келуін қолдайды

Энергия түзілуін ынталандырады

Зат алмасуды күшейтеді

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: жасқа байланысты өзгерістер, энергия мен жұмыс қабілетінің жеткіліксіздігі, баяу зат алмасу.

ҚҰРАМЫ: Никотинамидмононуклеотид (NMN), Гидроксипропилметилцеллюлоза (капсула қабығы), Микрокристалды целлюлоза (тасымалдағыш), Кверцетин, Ресвератрол, Магний стеараты (жабысып қалуға қарсы агент), B12 дәрумені (метилкобаламин).

1 КАПСУЛАДАҒЫ БЕЛСЕНДІ ЗАТ МӨЛШЕРІ:
NMN (никотинамидмононуклеотид) - 250 mg
• Кверцетин - 50 mg
• Ресвератрол - 50 mg
• B12 дәрумені (метилкобаламин) - 8 μg

ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ: таңертең аш қарынға қабылдаған жөн. Қоспа орталық жүйке жүйесін қоздырып, энергия түзілуін ынталандыратындықтан, бұл ұйқы мәселелерінің алдын алуға көмектеседі.

ҰСЫНЫЛАТЫН МӨЛШЕРІ: Күніне 1 рет 1 капсула.

ҰСЫНЫЛҒАН ТӘУЛІКТІК МӨЛШЕРДЕГІ ТӘУЛІКТІК ТҰТЫНУ НОРМАСЫНЫҢ ПАЙЫЗЫ
(1 КАПСУЛА):
NMN (никотинамидмононуклеотид) - норма белгіленбеген
• Кверцетин - 167%
• Ресвератрол - 167%
B12 дәрумені (метилкобаламин) - 800%

ҰСЫНЫЛАТЫН ҚАБЫЛДАУ КУРСЫ: 1 ай (4 апта), қажет болса қайталауға болады.

ҚАПТАМАДАҒЫ КАПСУЛА САНЫ: 60.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Құрамдастарды жеке көтере алмау.
2. Жүктілік, бала емізу кезеңі.
3. Кешкі уақытта қабылдау.

ЖАС БОЙЫНША ҰСЫНЫМДАР: Қоспаны 18 жастан бастап қабылдауға болады, бірақ 35-40 жаста ағза үшін ерекше маңызды болады.

КАПСУЛА ТҮРІ: HPMC капсулалары.

Өзара толықтыратын элементтер: ресвератрол, кверцетин, В тобы дәрумендері және Q10 коэнзимімен біріктіріледі.

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ: 3 жыл.



OMEGA-3 + VITAMIN D3

ОМЕГА-3 + D3 (ЖҰМСАҚ КАПСУЛАЛАР, 700 mg)

Тірек-қимыл жүйесінің саулығын қолдайды

Иммунитетті қолдайды

Жұмыс қабілетін жақсартады

Холестериннің қалыпты деңгейін сақтайды

Жүрек-тамыр жүйесінің қалыпты қызметін қолдайды

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: тері мен көздің құрғақтығы, тұрақты шаршау, жұмыс қабілетінің төмендеуі, иммунитет мәселелері, сүйек сынғыштығы, әлсіздік.

ҚҰРАМЫ: Мұхит балығының майы, Қабық (желатин, қоюландырғыш глицерин, су), D3 дәрумені (холекальциферол), Токоферолдар қоспасы (антиоксидант).

1 КАПСУЛАДАҒЫ БЕЛСЕНДІ ЗАТ МӨЛШЕРІ:
• Омега 3 полиқанықпаған май қышқылдары - 450 mg
Омега 3 - 350 mg (EPA мен DHA қосындысы)
• EPA - 250 mg
DHA - 100 mg
• D3 дәрумені - 0.025 mg

ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ: күннің бірінші жартысында, аш қарынға немесе тамақтан жарты сағаттан кейін, жылы не салқын сумен ішіңіз.

ҰСЫНЫЛАТЫН МӨЛШЕРІ: Күніне 1-2 рет 1 капсула.

ҰСЫНЫЛҒАН ТӘУЛІКТІК МӨЛШЕРДЕГІ ТӘУЛІКТІК ТҰТЫНУ НОРМАСЫНЫҢ ПАЙЫЗЫ **(1 КАПСУЛА):**
• Омега-3 полиқанықпаған май қышқылдары - 22.5%
• EPA - 42%
• DHA - 14.3%
D3 дәрумені - 250%

ҰСЫНЫЛАТЫН ҚАБЫЛДАУ КУРСЫ: 1 ай (4 апта). 1-2 айлық аралықпен жылына 3-4 рет қайталаңыз.

ҚАПТАМАДАҒЫ КАПСУЛА САНЫ: 60.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Теңіз өнімдеріне аллергиялық реакциялар.
2. 3 жасқа толмаған балалар.
3. Өнім құрамындағы заттарды жеке көтере алмау.

4. Қан кету немесе қан ұюының бұзылуы.
5. Бронх демікпесі.
6. Бауыр аурулары.
7. Асқазан-ішек жолының жедел немесе созылмалы кезеңдегі әртүрлі патологиялары.
8. Операциядан кейінгі кезең.
9. Операциядан кейін оңалтудан өтіп жүрген немесе әртүрлі себепті жарақаттары бар адамдарға қабылдауды бастар не қайта жалғастырар алдында дәрігермен кеңесу ұсынылады.
10. D дәруменінің гипервитаминозы.
11. Гиперкальциурия.
12. Несеп-тас ауруы.
13. Саркоидоз.
14. Бауыр мен бүйректің жедел және созылмалы аурулары, бүйрек жеткіліксіздігі.
15. Өкпе туберкулезінің белсенді түрі.

Элемент түрі: полиқанықпаған май қышқылдары + майда еритін дәрумен.

Өзара толықтыратын элементтер: коллаген, кальций, магний, фосфор, Q10 коэнзимі, лецитин, B, C, K2 дәрумендері.

Үйлеспейтін элементтер: омега-3 темір, мыс пен мырыштың биожетімділігін азайтады - 2-3 сағат аралықпен қабылдаңыз; D3 дәрумені A, E дәрумендерімен үйлеспейді.

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ: 2 жыл.



OMEGA-3 90%

ОМЕГА-3 90% (ЖҰМСАҚ КАПСУЛАЛАР, 700 mg)

Холестериннің қалыпты деңгейін сақтайды

Жұмыс қабілетін жақсартады

Жүрек-тамыр жүйесінің қалыпты қызметін қолдайды

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: тері мен көздің құрғақтығы, тұрақты шаршау, жұмыс қабілетінің төмендеуі, иммунитет мәселелері, әлсіздік.

ҚҰРАМЫ: Балық майы, Қабық (желатин, қоюландырғыш глицерин, су), Токоферолдардың антиоксиданттық қоспасы (антиоксидант).

1 КАПСУЛАДАҒЫ БЕЛСЕНДІ ЗАТ МӨЛШЕРІ:
• Омега 3 полиқанықпаған май қышқылдары - 450 mg
Омега 3 - 350 mg (EPA мен DHA қосындысы)
• EPA - 250 mg
DHA - 100 mg

ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ: күннің бірінші жартысында, аш қарынға немесе тамақтан жарты сағаттан кейін, жылы не салқын сумен ішіңіз.

ҰСЫНЫЛАТЫН МӨЛШЕРІ: Күніне 1-3 рет 1 капсула.

ҰСЫНЫЛҒАН ТӘУЛІКТІК МӨЛШЕРДЕГІ ТӘУЛІКТІК ТҰТЫНУ НОРМАСЫНЫҢ ПАЙЫЗЫ (3 КАПСУЛА):
• Омега-3 полиқанықпаған май қышқылдары - 1350%
• EPA - 750%
DHA - 300%

ҰСЫНЫЛАТЫН ҚАБЫЛДАУ КУРСЫ: 1 ай (4 апта). 1-2 айлық аралықпен жылына 3-4 рет қайталаңыз.

ҚАПТАМАДАҒЫ КАПСУЛА САНЫ: 60.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Теңіз өнімдеріне аллергиялық реакциялар.
2. 3 жасқа толмаған балалар.
3. Өнім құрамындағы заттарды жеке көтере алмау.
4. Қан кету немесе қан ұюының бұзылуы.
5. Бронх демікпесі.
6. Бауыр аурулары.

7. Асқазан-ішек жолының жедел немесе созылмалы кезеңдегі әртүрлі патологиялары.
8. Операциядан кейінгі кезең.
9. Операциядан кейін оңалтудан өтіп жүрген немесе әртүрлі себепті жарақаттары бар адамдарға омега-3 қабылдауды бастар не қайта жалғастырар алдында дәрігермен кеңесу ұсынылады.

ЭЛЕМЕНТ ТҮРІ: полиқанықпаған май қышқылдары.

Өзара толықтыратын элементтер: коллаген, кальций, магний, Q10 коэнзимі, лецитин, A, E, B, C, D дәрумендері.

Үйлеспейтін элементтер: темір, мыс және мырыштың биожетімділігін азайтады; 2-3 сағат аралықпен қабылдаңыз.

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ: 2 жыл.



OMEGA-3 60% MINI

ОМЕГА-3 60% (ЖҰМСАҚ КАПСУЛАЛАР, 300 mg)

Күйзеліс гормондарын басады

Холестериннің қалыпты деңгейін сақтайды

Жүректің қалыпты қызметін қолдайды

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: тері мен көздің құрғақтығы, тұрақты шаршау мен әлсіздік, жұмыс қабілетінің төмендеуі, иммунитет мәселелері.

ҚҰРАМЫ: Балық майы, Қабық (желатин, қоюландырғыш глицерин, су), Токоферолдар қоспасы (антиоксидант).

1 КАПСУЛАДАҒЫ БЕЛСЕНДІ ЗАТ МӨЛШЕРІ:
• Омега 3 полиқанықпаған май қышқылдары - 300 mg
Омега 3 - 275 mg (EPA мен DHA қосындысы)
• EPA - 165 mg
DHA - 110 mg

ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ: күннің бірінші жартысында, аш қарынға немесе тамақтан жарты сағаттан кейін, жылы не салқын сумен ішіңіз.

ҰСЫНЫЛАТЫН МӨЛШЕРІ: Күніне 1-3 рет 2 капсула.

ҰСЫНЫЛҒАН ТӘУЛІКТІК МӨЛШЕРДЕГІ ТӘУЛІКТІК ТҰТЫНУ НОРМАСЫНЫҢ ПАЙЫЗЫ (2 КАПСУЛА):
• Омега-3 полиқанықпаған май қышқылдары - 30%
• EPA - 55%
DHA - 31%

ҰСЫНЫЛАТЫН ҚАБЫЛДАУ КУРСЫ: 1 ай (4 апта). 1-2 айлық аралықпен жылына 3-4 рет қайталаңыз.

ҚАПТАМАДАҒЫ КАПСУЛА САНЫ: 60.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Теңіз өнімдеріне аллергиялық реакциялар.
2. 3 жасқа толмаған балалар.
3. Өнім құрамындағы заттарды жеке көтере алмау.
4. Қан кету немесе қан ұюының бұзылуы.
5. Бронх демікпесі.
6. Бауыр аурулары.

7. Асқазан-ішек жолының жедел немесе созылмалы кезеңдегі әртүрлі патологиялары.
8. Операциядан кейінгі кезең.
9. Операциядан кейін оңалтудан өтіп жүрген немесе әртүрлі себепті жарақаттары бар адамдарға омега-3 қабылдауды бастар не қайта жалғастырар алдында дәрігермен кеңесу ұсынылады.

ЭЛЕМЕНТ ТҮРІ: полиқанықпаған май қышқылдары.

Өзара толықтыратын элементтер: коллаген, кальций, магний, Q10 коэнзимі, лецитин, A, E, B, C, D дәрумендері.

Үйлеспейтін элементтер: темір, мыс және мырыштың биожетімділігін азайтады; 2-3 сағат аралықпен қабылдаңыз.

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ: 2 жыл.



PROBIOTIC COMPLEX

ДӘРУМЕНДЕР ҚОСЫЛҒАН ПРОБИОТИКТЕР КЕШЕНІ (ҚАТТЫ ЖЕЛАТИН КАПСУЛАЛАРЫ, 788 mg)

Зат алмасу мен энергия түзілуін қолдайды

Иммундық жүйені қолдайды

Антиоксиданттық қорғаныс

Сау ішек микрофлорасын қолдап, қалпына келтіреді

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: ас қорыту бұзылыстары, әлсіреген иммунитет, күйзеліс пен жоғары жүктеме, теңгерімсіз тамақтану.

ҚҰРАМЫ: Мальтодекстрин, Желатин капсуласы (желатин), L-аскорбин қышқылы, Мырыш бисглицинаты, Құрғақ токоферил ацетаты 50%, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum subsp. Longum, Bifidobacterium animalis subsp. Lactis, Никотинамид, Стеарин қышқылының магний тұзы (жабысып қалуға қарсы агент), Кальций пантотенаты, Пиридоксин гидрохлориді, Рибофлавин.

1 КАПСУЛАДАҒЫ БЕЛСЕНДІ ЗАТ МӨЛШЕРІ:
Lactobacillus acidophilus - 2*10⁹ CFU
Bifidobacterium longum subsp. longum - 2*10⁹ CFU
Bifidobacterium animalis subsp. lactis - 2*10⁹ CFU
• C дәрумені - 45 mg
• Мырыш - 12.3 mg
• E дәрумені - 10 mg
• B3 дәрумені - 18 mg
• B5 дәрумені - 5 mg
• B6 дәрумені - 2 mg
• B2 дәрумені - 1.6 mg

ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ: Күніне 1 рет 1 капсула тамақпен бірге.

ҰСЫНЫЛАТЫН МӨЛШЕРІ: Күніне 1 рет 1 капсула.

ҰСЫНЫЛҒАН ТӘУЛІКТІК МӨЛШЕРДЕГІ ТӘУЛІКТІК ТҰТЫНУ НОРМАСЫНЫҢ ПАЙЫЗЫ **(1 КАПСУЛА):**
• Lactobacillus acidophilus - 4000%
• Bifidobacterium longum subsp. longum - 400%
• Bifidobacterium animalis subsp. lactis - 400%
• C дәрумені - 75%
• Мырыш - 82%
• E дәрумені - 100%
B3 дәрумені - 100%
B5 дәрумені - 83%
B6 дәрумені - 100%
B2 дәрумені - 100%

ҰСЫНЫЛАТЫН ҚАБЫЛДАУ КУРСЫ: 1 ай (4 апта), қажет болса қайталауға болады.

ҚАПТАМАДАҒЫ КАПСУЛА САНЫ: 60.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Құрамдастарды жеке көтере алмау.
2. Жүктілік, бала емізу.

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ: 3 жыл.



VITAMIN C

С ДӘРУМЕНІ (ТҮТІКШЕДЕ 20 КӨПІРШИТІН ТАБЛЕТКА, 3.8 g)

Иммунитетті қолдайды

Антиоксиданттық әсер

Қалыпты тотығу процестерін қолдайды

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: жұмыс қабілетінің төмендеуі, енжарлық, әлсіздік, ұйқышылдық, инфекцияларға төзімділіктің азаюы, әртүрлі ауруларда қалпына келудің баяулауы.

ҚҰРАМЫ: Глюкоза, С дәрумені (L-аскорбин қышқылы), Қышқылдықты реттегіштер: натрий бикарбонаты, Сусыз лимон қышқылы, Тұрақтандырғыш полиэтиленгликоль, Табиғи «Апельсин» хош иістендіргіші, Тәттілендіргіш аспартам, Табиғи бояғыш: рибофлавин. Құрамында қант пен тәттілендіргіш бар. Құрамында фенилаланин көзі бар.

1 ТАБЛЕТКАДАҒЫ БЕЛСЕНДІ ЗАТ МӨЛШЕРІ:
С дәрумені - 900 mg

ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ: таңертең таңғы астан 30 минут бұрын, сумен ішіңіз.

ҰСЫНЫЛАТЫН МӨЛШЕРІ: Күніне 1 рет 1 таблетка.

ҰСЫНЫЛҒАН ТӘУЛІКТІК МӨЛШЕРДЕГІ ТӘУЛІКТІК ТҰТЫНУ НОРМАСЫНЫҢ ПАЙЫЗЫ (1 ТАБЛЕТКА):
С дәрумені - 1500%

ҰСЫНЫЛАТЫН ҚАБЫЛДАУ КУРСЫ: 1 ай (4 апта). 1-2 айлық аралықпен жылына 3-4 рет қайталаңыз.

ҚАПТАМАДАҒЫ ТАБЛЕТКА САНЫ: 20 дана.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Өнім құрамдастарына жоғары сезімталдық.
2. Нефролитиаз.
3. Гемохроматоз (темірдің артық болуы).
4. Қан ұюы жоғары, тромбофлебиті немесе тромбозға бейімділігі бар адамдарға, сондай-ақ қант диабеті және қандағы қант жоғарылайтын жағдайларда үлкен дозаларды тағайындауға болмайды.

Элемент түрі: суда ериді.

Өзара толықтыратын элементтер: А, Е, В5, В9 дәрумендері.

Үйлеспейтін элементтер: В1, В12 дәрумендері, мыс.

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ: 2 жыл.



VITAMIN D3

D3 ДӘРУМЕНІ 2000 IU (ЖҰМСАҚ КАПСУЛАЛАР, 700 mg)

Иммунитетті қолдайды

Тірек-қимыл жүйесінің саулығын қолдайды

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: сүйек сынғыштығы, остеопороз, иммунитеттің төмендеуі.

ҚҰРАМЫ: Өсімдік майы (зәйтүн), Қабық (желатин, глицерин (қоюландырғыш), су), D3 дәрумені (холекальциферол), Токоферолдар қоспасы (антиоксидант).

1 КАПСУЛАДАҒЫ БЕЛСЕНДІ ЗАТ МӨЛШЕРІ:
D3 дәрумені - 50 mcg

ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ: таңертең тамақпен бірге, жылы немесе салқын сумен ішкен жөн.

ҰСЫНЫЛАТЫН МӨЛШЕРІ: Күніне 1 капсула.

ҰСЫНЫЛҒАН ТӘУЛІКТІК МӨЛШЕРДЕГІ ТӘУЛІКТІК ТҰТЫНУ НОРМАСЫНЫҢ ПАЙЫЗЫ (1 КАПСУЛА):
D3 дәрумені - 500%

ҰСЫНЫЛАТЫН ҚАБЫЛДАУ КУРСЫ: 2-3 ай (8-12 апта). 6-12 айлық аралықпен қайталаңыз.

ҚАПТАМАДАҒЫ КАПСУЛА САНЫ: 90 дана.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Өнім құрамдастарына жоғары сезімталдық.
2. D дәруменінің гипервитаминозы.
3. Гиперкальциурия.
4. Несеп жолдарындағы тастар.
5. Саркоидоз.
6. Бауыр мен бүйректің жедел және созылмалы аурулары, бүйрек жеткіліксіздігі.
7. Өкпе туберкулезінің белсенді түрі.

Элемент түрі: майда ериді.

Өзара толықтыратын элементтер: кальций (D3-пен кемінде 2 сағат аралықпен қабылдаңыз), фосфор, магний, омега-3, K2 дәрумені.

Үйлеспейтін элементтер: темір, A, E дәрумендері.

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ: 3 жыл.



VITAMIN D3 SPRAY

D3 ДӘРУМЕНІ 2000 IU (СПРЕЙ, 30 ml)

Иммунитетті қолдайды

Тірек-қимыл жүйесінің саулығын қолдайды

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: сүйек сынғыштығы, остеопороз, иммунитеттің төмендеуі.

ҚҰРАМЫ: Тазартылған өсімдік майы, Табиғи хош иістендіргіш, Холекальциферол (D3 дәрумені).

1 РЕТ БАСҚАНДАҒЫ БЕЛСЕНДІ ЗАТ МӨЛШЕРІ:
D3 дәрумені - 50 mcg

ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ: қолданар алдында құтыны шайқаңыз. Күніне 1 доза (доза - бүріккіш қақпағын 1 рет басу) тамақтану кезінде тіл астына. Таңертең қабылдаған жөн.

ҰСЫНЫЛАТЫН МӨЛШЕРІ: Күніне 1 рет басу.

ҰСЫНЫЛҒАН ТӘУЛІКТІК МӨЛШЕРДЕГІ ТӘУЛІКТІК ТҰТЫНУ НОРМАСЫНЫҢ ПАЙЫЗЫ (ДОЗАТОРДЫ 1 РЕТ БАСУ):
D3 дәрумені - 1000%

ҰСЫНЫЛАТЫН ҚАБЫЛДАУ КУРСЫ: 1-2 ай (4-8 апта), қажет болса қабылдауды қайталауға болады.

КӨЛЕМІ: 30 ml.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Өнім құрамдастарына жоғары сезімталдық.
2. D дәруменінің гипервитаминозы.
3. Гиперкальциурия.
4. Несеп жолдарындағы тастар.
5. Саркоидоз.
6. Бауыр мен бүйректің жедел және созылмалы аурулары, бүйрек жеткіліксіздігі.
7. Өкпе туберкулезінің белсенді түрі.
8. Құрамдастарды жеке көтере алмау.

Элемент түрі: майда ериді.

Өзара толықтыратын элементтер: кальций (D3-пен кемінде 2 сағат аралықпен қабылдаңыз), фосфор, магний, омега-3, K2 дәрумені.

Үйлеспейтін элементтер: темір, A, E дәрумендері.

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ: 2 жыл.



WOMEN’S FORMULA

ӘЙЕЛДЕРГЕ АРНАЛҒАН МУЛЬТИДӘРУМЕНДІ КЕШЕН (НРМС КАПСУЛАЛАРЫ, 580 mg)

Дәрумендер мен минералдарды толықтырады

Зат алмасуды жақсартады

Гормондық теңгерім мен әйелдер саулығын қолдайды

Сүйек пен тістерді нығайтады

Тері, шаш пен тырнақ саулығын сақтайды

Жүйке жүйесін қолдап, күйзелісті азайтады

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: иммунитеттің төмендеуі, жалпы әлсіздік, ашушаңдықтың артуы, есте сақтаудың нашарлауы, ұйқы бұзылыстары.

ҚҰРАМЫ: Кальций карбонаты, Капсула құрамы: гидроксипропилметилцеллюлоза (қабық), Магний цитраты, L-аскорбин қышқылы (С дәрумені), Калий цитраты, Инозитол, Цитрус биофлавоноидтары, Холин битартраты (холин), Американдық женьшень сығындысы, Сүтті ошаған сығындысы, Ангелика тамырының сығындысы, Аюжидек сығындысы, Кремний диоксиді (жабысып қалуға қарсы агент), Никотинамид (ниацин), Темір бисглицинаты, Мырыш цитраты, Магний стеараты (жабысып қалуға қарсы агент), DL-альфа-токоферол (Е дәрумені), D-кальций пантотенаты (пантотен қышқылы), Тиамин гидрохлориді (В1 дәрумені), Рибофлавин (В2 дәрумені), Пиридоксин гидрохлориді (В6 дәрумені), Марганец глюконаты, Мыс глюконаты, Ретинол (А дәрумені), Хром пиколинаты, Кальций L-метилфолаты (фолий қышқылы), Калий йодиді, L-селенометионин, D-биотин (биотин), Молибден глицинаты, Менахинон (К2 дәрумені), Холекальциферол (D3 дәрумені), Метилкобаламин (В12 дәрумені).

1 КАПСУЛАДАҒЫ БЕЛСЕНДІ ЗАТ МӨЛШЕРІ:

- А дәрумені - 0.1 mg
- С дәрумені - 80 mg
- D3 дәрумені - 0.003 mg
- Е дәрумені - 3.33 mg

В1 дәрумені - 1.0 mg
В2 дәрумені - 1.0 mg

- В3 дәрумені - 6.5 mg
- В6 дәрумені - 1.0 mg
- Фолий қышқылы - 0.05 mg
- В12 дәрумені - 0.003 mg
- Биотин - 0.015 mg
- Пантотен қышқылы - 2.0 mg
- Холин - 30.0 mg
- Кальций - 100.0 mg
- Темір - 6.0 mg
- Йод - 0.05 mg
- Магний - 100.0 mg

• Мырыш - 5.0 mg
• Селен - 0.02 mg
• Мыс - 0.5 mg
• Марганец - 0.65 mg
• Хром - 0.05 mg
• Молибден - 0.015 mg
• Инозитол - 30.0 mg

Қабылдау тәртібі: күннің бірінші жартысында күніне 2 рет 1 капсуладан.

ҰСЫНЫЛАТЫН МӨЛШЕРІ: Күніне 2 капсула.

ҰСЫНЫЛҒАН ТӘУЛІКТІК МӨЛШЕРДЕГІ ТӘУЛІКТІК ТҰТЫНУ НОРМАСЫНЫҢ ПАЙЫЗЫ
(2 КАПСУЛА):
• А дәрумені - 25%
С дәрумені - 267%
D3 дәрумені - 120%
Е дәрумені - 67%
В1 дәрумені - 143%
В2 дәрумені - 125%
В3 дәрумені - 72%
В6 дәрумені - 100%
• Фолий қышқылы - 50%
В12 дәрумені - 600%
• Биотин - 60%
• Пантотен қышқылы - 67%
• Холин - 12%
• Кальций - 20%
• Темір - 86%
• Йод - 67%
• Магний - 50%
• Мырыш - 67%
• Селен - 57%
• Мыс - 100%
• Марганец - 65%
• Хром - 200%
• Молибден - 43%
• Инозитол - 12%

ҰСЫНЫЛАТЫН ҚАБЫЛДАУ КУРСЫ: 1 ай (4 апта), қажет болса қайталауға болады.

ҚАПТАМАДАҒЫ КАПСУЛА САНЫ: 60.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Биологиялық белсенді қоспа құрамдастарын жеке көтере алмау.
2. Жүйке қозғыштығының жоғарылауы, ұйқысыздық.
3. Жоғары қан қысымы, жүрек ырғағының бұзылуы, ауыр атеросклероз.
4. Кешкі уақытта қабылдау.
5. Жүкті және бала емізетін әйелдер дәрігердің ұсынымымен және бақылауымен қабылдауы тиіс.

Элемент түрі: дәрумендер мен минералдар.

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ: 3 жыл.



ZINC PICOLINATE

МЫРЫШ ПИКОЛИНАТЫ (ҚАТТЫ ЖЕЛАТИН КАПСУЛАЛАРЫ, 350 mg)

Тері майының түзілуін реттейді

Жыныс гормондарының түзілуін қолдайды

Жүрек-тамыр жүйесін нығайтады

Тіндердің қалпына келуін қолдайды

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: иммунитеттің төмендеуі, терінің майлы жылтыры мен қабынуы, ерлер саулығының нашарлауы.

ҚҰРАМЫ: Микрокристалды целлюлоза (Е460i, тасымалдағыш), Мырыш пиколинаты, Капсула (гидроксипропилметилцеллюлоза (Е464, қоюландырғыш) немесе желатин).

1 КАПСУЛАДАҒЫ БЕЛСЕНДІ ЗАТ МӨЛШЕРІ:
Мырыш - 21.9 mg

ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ: Күніне 1 капсула аш қарынға.

ҰСЫНЫЛАТЫН МӨЛШЕРІ: Күніне 1 капсула.

ҰСЫНЫЛҒАН ТӘУЛІКТІК МӨЛШЕРДЕГІ ТӘУЛІКТІК ТҰТЫНУ НОРМАСЫНЫҢ ПАЙЫЗЫ (1 КАПСУЛА):
Мырыш - 146%

ҰСЫНЫЛАТЫН ҚАБЫЛДАУ КУРСЫ: 1 ай (4 апта), қажет болса қайталауға болады.

ҚАПТАМАДАҒЫ КАПСУЛА САНЫ: 60.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Құрамдастарды жеке көтере алмау.
2. Жүктілік, бала емізу кезеңі.
3. Бүйрек жеткіліксіздігі.

Элемент түрі: минерал.

Өзара толықтыратын элементтер: В тобы және С дәрумендері, магний.

Үйлеспейтін элементтер: жоғары дозалы темір мен кальций.

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ: 2 жыл.



COLLAGEN

АНАР ДӘМІ БАР КОЛЛАГЕН ЖЕЛЕСІ (ӘРҚАЙСЫСЫ 20 g БОЛАТЫН 30 СТИК)

Дәнекер тінді нығайтады

Сау тері, шаш пен тырнақ

Қартаюды баяулатады

Тері тонусы мен серпімділігін жақсартады

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ: терінің құрғақтығы мен сусыздануы, түсуге және ұшы айырылуға бейім сынғыш құрғақ шаш, бұлшықет пен буын ауырсынуы, әжімдер.

ҚҰРАМЫ: Анар шырынының концентраты, Су, Балық коллагені, Тағамдық гель (қараған ағашының камеді, ксантан камеді, глюкоза, агар-агар, тамаринд камеді), Аскорбин қышқылы, Жасанды анар хош иістендіргіші, Гиалурон қышқылы.

1 СТИКТЕГІ БЕЛСЕНДІ ЗАТ МӨЛШЕРІ:
• Балық коллагені - 2000 mg
• С дәрумені - 100 mg
• Гиалурон қышқылы - 15.2 mg

ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ: тамақ пен тәулік уақытына тәуелсіз.

ҰСЫНЫЛАТЫН МӨЛШЕРІ: Күніне 1-2 стик.

ҰСЫНЫЛҒАН ТӘУЛІКТІК МӨЛШЕРДЕГІ ТӘУЛІКТІК ТҰТЫНУ НОРМАСЫНЫҢ ПАЙЫЗЫ (2 САШЕ):
Коллаген - норма белгіленбеген

ҰСЫНЫЛАТЫН ҚАБЫЛДАУ КУРСЫ: 1 ай (4 апта). 1 айлық аралықпен қайталаңыз.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:
1. Өнім құрамдастарына аллергия немесе жоғары сезімталдық.
2. Жүктілік, бала емізу кезеңі.

Элемент түрі: суда ериді.

Өзара толықтыратын элементтер: С дәрумені, Q10 коэнзимі, омега-3.

Үйлеспейтін элементтер: ұсынымдар жоқ.

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ: 2 жыл.